平成２８年度（第２５回）

臨床検査精度管理調査結果報告書

平成２９年７月

（公社）全国労働衛生団体連合会
総 合 精 度 管 理 委 員 会
臨 床 検 査 専 門 委 員 会

はじめに

労働者の健康診断は、労働安全衛生法の規定により事業者にその実施が義務づけられているが、多くの場合、企業外の健康診断機関によって行われている。

健康診断には、問診、診察、採血・採尿や各種生理機能検査等の実施、検体の運搬、保存、測定、健康診断結果の総合判定、さらには健康診断結果の事業場への報告および受診者個人への報告と多くのステップがあり、これらの各ステップで、医師、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、医療事務担当者等多くの職種の人たちがかかわっている。

そして健康診断の品質を良質なものとするためには、生産における品質管理と同様に健康診断の各ステップにおいて精緻な管理が求められる。このためひとつひとつの検査が十分な精度管理のもとで実施されることが重要である。

公益社団法人全国労働衛生団体連合会では、労働衛生検査（生物学的モニタリング検査）、臨床検査、胸部エックス線検査および腹部超音波検査に係る精度管理調査を実施しているが、本報告書は、平成28年度臨床検査に関する精度管理調査の実施結果をまとめたものである。

なお、臨床検査精度管理調査の実施細目は巻末に掲載の「平成28年度臨床検査精度管理調査実施要領」を参照されたい。

また、各精度管理調査を企画・運営・管理するために設置されている総合精度管理委員会、臨床検査精度管理調査ための臨床検査専門委員会及び評価部会の委員は次ページのとおりである。

【総合精度管理委員会委員】

委 員 長　　清水　英佑　中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター 所長

委　　員　　伊藤　春海　国立大学法人福井大学 名誉教授 特命教授

同　　圓藤　吟史　中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 所長

同　　岡庭　信司　飯田市立病院 消化器内科部長

同　　櫻井　治彦　（公財）産業医学振興財団 理事長

同　　高木　　康　昭和大学医学部 教授

同　　福田　崇典　（社福）聖隷福祉事業団 常務理事

同　　松本　吉郎　（公社）日本医師会 常任理事

同　　森　　雄一　（公財）神奈川県予防医学協会 専門委員

【臨床検査専門委員会委員】

委 員 長　　高木　　康　昭和大学医学部 教授

委　　員　　大久保滋夫　文京学院大学 教授

同　　金森きよ子　文京学院大学 准教授

同　　川合　陽子　国際医療福祉大学 教授

同　　久保野勝男　新潟医療福祉大学 教授

同　　近藤　　弘　関西医療大学 教授

同　　佐藤　尚武　順天堂東京江東高齢者医療センター臨床検査科

同　　杉山　　弘　昭和大学藤が丘病院　臨床病理検査部

同　　関　　顯　労働衛生検査精度向上研究会 代表

同　　森　　雄一　(公財)神奈川県予防医学協会 専門委員

同　　山舘 周恒　人間総合科学大学　特任教授

目　　次

第２５回臨床検査精度管理調査結果報告 …… 1
Ⅰ　調査結果の概要 …… 3
1. 調査の目的 …… 3
2. 調査対象施設 …… 3
3. 調査の対象項目 …… 3
4. 調査の実施方法 …… 3
5. 調査参加施設数及び調査状況 …… 4
Ⅱ　調査に使用した試料 …… 6
1. 調査項目別試料 …… 6
2. 調査試料のランダム化 …… 7
3. 配付試料に関する問題 …… 7
Ⅲ　評価基準等 …… 7
1. 評価規準 …… 8
2. 生理的変動を基本とした評価規準 …… 9
3. 生理的変動を基本とした評価規準の一般的解釈 …… 10
4. 全衛連調査における評価規準としての考え方 …… 11
Ⅳ　評価方法 …… 15
1. 平均値評価 …… 15
2. 解析値評価 …… 16
3. 総合点評価 …… 20
Ⅴ　各論的考察 …… 21
【臨床化学検査】 …… 21
はじめに …… 21
1. 総コレステロール …… 23
2. 中性脂肪 …… 24
3. 尿酸 …… 25
4. クレアチニン …… 26
5. AST、ALT …… 27
6. γ-GT …… 29
7. 血糖 …… 30
8. HDLコレステロール …… 32
9. LDLコレステロール …… 34
10. HbA1c …… 35
【血液学検査】 …… 37
はじめに …… 37
1. 血液学検査評価方法 …… 37
2. 測定試料 …… 37
3. 調査項目 …… 37
まとめ …… 39
【参考調査（新鮮血液試料についての調査）】 …… 39

【尿検査】 …… 41
はじめに …… 41
1. 評価方法 …… 42
2. 結果及び考察 …… 42
３．まとめ …… 47
第25回臨床検査精度管理調査試料測定結果（１） …… 49
1. 表17 調査項目の測定法別標準偏差・平均値一覧 …… 53
2. 表18 調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準 …… 59
3. 表19 調査項目別・測定方法別・実施施設数 …… 63
第25回臨床検査精度管理調査試料測定結果（２） …… 65
調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比
付表 1-1（全施設） …… 67
付表 1-2（自施設） …… 68
付表 1-3（外部施設） …… 69
測定法別の評価点ランク別施設数、構成比
付表 2-1（全施設） …… 70
付表 2-2（自施設） …… 73
付表 2-3（外部施設） …… 76
尿検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比
付表 3-1（尿糖） …… 79
付表 3-2（尿蛋白） …… 80
付表 3-3（尿潜血） …… 81
第25回臨床検査精度管理調査調査項目総合評価点一覧 …… 83
付表4 評価結果一覧 …… 85
第25回臨床検査精度管理調査自施設測定施設評価結果 …… 97
［ 1］総コレステロール …… 99
［ 2］中性脂肪 …… 102
［ 3］尿酸 …… 105
［ 4］クレアチニン …… 108
［ 5］AST（GOT） …… 111
［ 6］ALT（GPT） …… 114
［ 7］γ-GT …… 117
［ 8］血糖 …… 120
［ 9］HDLコレステロール …… 123
［10］LDLコレステロール …… 126
［11］HbA1c …… 129
［12］尿糖 …… 132
［13］尿蛋白 …… 138
［14］尿潜血 …… 144
［15］ヘモグロビン …… 150
［16］赤血球 …… 153
［17］白血球 …… 156
［18］ヘマトクリット …… 159

［19］血小板 …… 162
［20］平均赤血球容積 …… 165
第25回臨床検査精度管理調査外部施設測定施設評価結果 …… 169
［ 1］総コレステロール …… 171
［ 2］中性脂肪 …… 175
［ 3］尿酸 …… 179
［ 4］クレアチニン …… 183
［ 5］AST（GOT） …… 187
［ 6］ALT（GPT） …… 191
［ 7］γ-GT …… 195
［ 8］血糖 …… 199
［ 9］HDLコレステロール …… 203
［10］LDLコレステロール …… 207
［11］HbA1c …… 211
［12］尿糖 …… 215
［13］尿蛋白 …… 216
［14］尿潜血 …… 217
［15］ヘモグロビン …… 218
［16］赤血球 …… 222
［17］白血球 …… 226
［18］ヘマトクリット …… 230
［19］血小板 …… 234
［20］平均赤血球容積 …… 238
第25回臨床検査精度管理調査補助調査・臨床検査の基準範囲に関する調査集計結果 …… 243
調査の概要 …… 245
平成28年度（第25回）臨床検査精度管理調査補助調査票集計結果 …… 247
平成28年度（第25回）臨床検査精度管理調査基準範囲調査票集計結果 …… 253
参考資料 …… 273
１．第25回 精度管理調査参加施設一覧 …… 275
２．第25回 精度管理調査外部測定施設一覧 …… 284
３．第25回 全衛連臨床検査精度管理調査回答票 …… 286
４．平成28年度全衛連臨床検査精度管理調査票 【控用】 …… 288
５．平成28年度 臨床検査精度管理調査実施要領 …… 342
６．平成28年度（第25回）臨床検査精度管理調査 補助調査票 …… 344
７．臨床検査の基準範囲に関する調査票（平成28年度） …… 346

第25回臨床検査精度管理調査結果報告

Ⅰ．調査結果の概要

１　調査の目的

健康診断施設及び測定依頼を受ける登録衛生検査所が実施する臨床検査の検査精度を確認するとともに、必要な指導を行うことにより、信頼性の高い優良な健康診断施設及び登録衛生検査所を育成することを目的とした。

２　調査対象施設

健康診断施設及び登録衛生検査所

３　調査の対象項目（20項目）

1.総コレステロール　2.中性脂肪　3.尿酸　4.クレアチニン　5.AST　6.ALT
7.γ-GT　8.血糖　9.HDLコレステロール 10.LDLコレステロール
11.HbA1c
12.尿糖（半定量）13.尿蛋白（半定量）　14.尿潜血（半定量）
15.ヘモグロビン　16.赤血球数 17.白血球数　18.ヘマトクリット　19.血小板数
20.平均赤血球容積

４　調査の実施方法

精度管理試料をすべての精度管理参加施設に送付して、測定結果を回答してもらい、測定値の精度を評価した。

(1)　調査項目及び送付試料数

① 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖測定用	5試料
② HDLコレステロール、LDLコレステロール測定用（1試料生血清）	3試料
③ HbA1c測定用	2試料
④ 尿糖、尿蛋白、尿潜血半定量測定用	5試料
⑤ ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積測定用（2試料新鮮血液）	4試料

注 1）平均赤血球容積は参考調査（仮評価）とした。

注 2）生血清試料による HDL コレステロールおよび LDL コレステロールの調査は参考調査（仮評価）とした。

注 3）生血液試料によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数および平均赤血球容積までの調査は参考調査（仮評価）とした。

注 4）ヘモグロビン～平均赤血球容積を測定した後の残余の血液により、HbA1c の測定をお願いした。この調査も参考調査（仮評価）とした。

(2)　調査実施時期

試料送付　平成29年　2月　7日（火）

報告期限　平成29年　2月17日（金）

(3)　測定を委託している場合の送付試料の取り扱い

生化学関係の項目について全部あるいは一部を自施設では測定しないで登録衛生検査所に委託している施設については、全衛連より送付した試料のうち、外部委託する項目の試料を通常委託している登録衛生検査所に送付して測定させ、その上でその数値を回答していただいた。

５　調査参加施設数及び調査状況

平成28年度（第25回）全衛連臨床検査精度管理調査の参加施設数は356で昨年より8施設減少した。

また、外注を受けた登録衛生検査所は59施設で昨年より1施設減少した。

調査項目別の参加施設数、自施設測定数、外部施設測定数とそれぞれの比率および受託登録衛生検査所数は表1に示すとおりである。

調査対象とした項目は、従来通り総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖、HDLコレステロール、LDLコレステロール、HbA1c、尿糖（半定量）、尿蛋白（半定量）、尿潜血（半定量）、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板、平均赤血球容積の合計20項目であった。これらの項目中、臨床化学検査では、HDLコレステロールおよびLDLコレステロールについて、前回同様に新鮮血清1種類を参考調査試料として加え、各施設では、凍結乾燥品2種類のほかに新鮮血清1種類を測定していただいた。

血液学検査では、平成18年度(第15回)調査よりヒト生血液を参考調査試料として加えているが、今回も2種類のヒト生血液を参考調査試料として、全施設でこの試料2種類を測定していただいた。なお、平成23年度（第20回）から血液学検査用生血液2試料の残余試料について、HbA1cの測定をしていただいているが、今回も同様に測定いただいた。

全衛連精度管理調査では、試料の凍結、破損等で測定不可能な場合に限って試料を再送付しているが、今回、試料を再送付した施設はなかった。

血液学検査用試料については、測定前の試料溶血の程度を4段階に分けて回答票により報告していただいているが、今回新鮮血液試料での溶血強度4または3以上の報告（溶血強度またはコメントの記入）のあった施設が4施設あり、2施設は不参加となった。試料到着時には、ミクロヘマトクリット管を用いて遠心を行い、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が必要である。強溶血を認めた場合はコメント欄に記入するだけでなく、試料再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。また生血試料でのフィブリン析出、凝集などの報告数については「血液学」の

項を参照されたい。

尿検査については、355施設が参加しているが、このうち23施設が尿検査を登録衛生検査所に外部委託していた。尿検査は経時変化が大きいため、精度維持の観点から外部委託しないよう求めているので十分留意していただきたい。

表1　項目別参加施設数および委託状況

項　　目	参加 施設数	自施設 測定数	構成比 （%）	外部施設 測定数	構成比 （%）	受託 施設数
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	356	151	42.4%	205	57.6%	59
中性脂肪	356	151	42.4%	205	57.6%	59
尿酸	356	151	42.4%	205	57.6%	59
クレアチニン	356	151	42.4%	205	57.6%	59
AST	356	151	42.4%	205	57.6%	59
ALT	356	151	42.4%	205	57.6%	59
γ-GT	356	151	42.4%	205	57.6%	59
血糖	356	151	42.4%	205	57.6%	59
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	356	151	42.4%	205	57.6%	59
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	356	151	42.4%	205	57.6%	59
HbA1c	355	149	42.0%	206	58.0%	58
尿糖	355	332	93.5%	23	6.5%	17
尿蛋白	355	332	93.5%	23	6.5%	17
尿潜血	355	332	93.5%	23	6.5%	17
ヘモグロビン	353	151	42.8%	202	57.2%	59
赤血球	353	151	42.8%	202	57.2%	59
白血球	353	151	42.8%	202	57.2%	59
ヘマトクリット	353	151	42.8%	202	57.2%	59
血小板	353	151	42.8%	202	57.2%	59
平均赤血球容積	353	151	42.8%	202	57.2%	59

※生血だけの参加も参加施設数に含んでいます。

Ⅱ．調査に使用した試料

全衛連では本調査開始当初（平成元年）からヒトプール血清を無菌処理したものを凍結試料としてきたが、ヒトプール血清の入手が極めて困難となったことなどから、平成24年度（第21回）よりこれまで使用してきたプール血清の代用としてオフクロット血清（Serum Off the Clot）を使用している。

この変更に関し、従来の精度管理調査試料と同等な評価が可能となるかどうか、事前に診断薬企業と大学病院の計6施設により、あらたに調整した試料の反応性を評価した。その結果、従来の試料と同等な反応性が確認できたことで、精度管理調査試料として使用することを決めた。

1　調査項目別試料

(1)　総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖測定用試料

上述の通り、試料はオフクロット血清をベースに用いたが、脂質含量が少ないため、静注用脂肪乳剤より精製した中性脂肪分画を添加し、8濃度の試料が適切な解析値評価ができる濃度勾配となるようにした。また、酵素活性レベルを高くするために、ヒト型のリコンビナント酵素を添加している。尿酸クレアチニンおよびグルコースも前回同様に添加した。調整した8濃度試料のうち、参加施設には5試料を配布した。

(2)　HDL コレステロールおよび LDL コレステロール測定用試料

3 試料は凍結乾燥試料、さらに今回も 2 種類の新鮮血清を参考調査試料として加えて合計 5 試料準備したが、参加施設には 5 試料のうち、凍結乾燥試料 2 試料、新鮮血清 1 試料、合計 3 試料を配布した。

(3)　HbA1c 測定用試料

今回も前回と同様調査用に作製された凍結乾燥したヒトヘモグロビン試料を用いた。

(4)　尿糖、尿蛋白、尿潜血半定量用試料

従来通り調査用に作製された凍結乾燥品である。

(5) 血液学検査用試料

従来通り各血球を個々の方法で固定し安定剤を加えた加工血液（低、中、高値）を用いた。ただし、過去に配布した試料で、白血球数低値試料において測定機器の関係もあって施設間差が大きかったことから、今回も白血球数が著しく低い試料は選択から除外している。また今回も参考調査として2種類の生血液を加えて、参加施設には、コントロール血球 1 試料を全施設で測定していただき、残りの2試料をランダム化、生血液2試料は、全施設で測定していただくことにして、各施設には、合計4試料を配布した。

2　調査試料のランダム化

全衛連精度管理調査の最大の特徴は調査試料のランダム化である。

今回も調査試料を8濃度（または8活性値）準備し、直線性の評価が可能なように最低濃度（または最低活性値）と次に低い濃度（または活性値）の試料のいずれか1試料、および最高濃度（または最高活性値）と次に高い濃度（または活性値）の試料のいずれか1試料、が必ず入る条件を設定し、選択された試料を除く残りの6試料をランダム化して3試料、合計5試料を参加施設に送付した。

HDL、LDLコレステロール測定用試料は、凍結乾燥品3試料をランダム化して2試料、新鮮血清2試料をランダム化して1試料、合計3試料を参加施設に送付した。

HbA1c測定用試料は、3試料をそれぞれランダム化して、2試料を参加施設に送付した。また、血液学検査用試料の生血液2試料の残血を利用して、HbA1cの測定をお願いした。

血液学検査用試料は、3種類のコントロール血球のうち、1試料を全参加施設で測定することとし、残りの2試料をランダム化して合計2試料、2種類の生血液はランダム化を行わず全参加施設で測定することにして、合計4試料を参加施設に配布した。

3　配付試料に関する問題

一昨年度の「総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖測定用試料」において、融解直後からAST値の上昇が見られ、集計値において、CV値が大きくなる事象が報告された。このことを受けて昨年度の全衛連精度管理試料を調製するにあたり、ASTの安定性に関して事前確認を行った結果、活性値が変動する事象は見られなかったため、これまで通りの試料の準備を開始した経緯がある。

本年度においては、試料配付直前に一昨年度と同様に、試料融解直後からAST値の上昇が1時間で7%程度みられることが判明した。そのため、試料送付時に参加施設に試料融解から測定までの経過時間の報告をいただくこととした。

参加施設の報告では、試料融解後1時間以内に測定を完了してしまう施設がほとんどであった。そのため、AST項目のみ融解後1時間以内の測定値が安定しない状況の中でこれを評価することは公正な評価とは言えないことから、本委員会は今回ASTの評価を行わないことを決定した。

参加施設各位にお詫びするとともに、今後の試料事前確認の実施時期も含めて、万全の体制で対処することとした。

Ⅲ．評価基準等

臨床検査精度管理調査における参加施設の報告値評価は、従来、一般的には報告値を同一測定法群（peer group）に分類した後、平均値、標準偏差を計算して平均

値±3SD（または平均値±2SD*）を越えるデータを極端値として棄却し、棄却後のデータから求めた平均値、標準偏差を基準として評価してきた。

しかし、このようにして求めた平均値が真の値（true value）を代表する目標値（target value）として適切であるか否かについては長らく論議の的になってきた。この問いに答える目的で、全衛連総合精度管理委員会・臨床検査専門委員会は、参考値検討委員会を組織して検討を行った。

第1回（平成4年度）臨床検査精度管理調査においては、総コレステロール、AST（JSCC標準化対応法）、ALT（JSCC標準化対応法）、ヘモグロビンの４項目について参考値を求めた。第2回（平成5年度）からは、日本臨床化学会（JSCC）から中性脂肪測定の勧告法が発表されたことから、中性脂肪の参考値を加えた。第3回（平成6年度）からは、γ-GTの勧告法が発表されたことから、γ-GT（JSCC標準化対応法）の参考値を加えた。血糖は第8回（平成11年度）から参考値を求めた。

そして、第9回（平成12年度）から上記7項目全ての測定法について、参考値を基準濃度として評価することにした。いずれの項目も最初に参考値を求めた年度は参考に止め、次年度から評価の基準濃度（または基準活性値）として用いた。

参考値による評価で現在までに判明したことは、参加機関の平均値と参考値が経年的に近接しており、ここ数年は極めてよく一致していることである。この結果は日常検査の精密さ、正確さが年々向上しており、極端値棄却後の参加機関の平均値を真の値を代表する目標値として用いてもほぼ問題がないことを示している。

以上のことから、平成19年度（第16回）から参考値評価を廃止し、全ての項目について同一測定法群の極端値棄却後の平均値を基準濃度（基準活性値）として用いて評価している。

なお、従来と同様に測定法分類で同一測定法群のn数が6未満の測定法で測定原理上他の平均値を用いて評価できない測定法については、計算された同一測定法群の統計量の統計的意義が乏しいことから「評価せず」としている。

* 日医調査のようにn数が著しく多い場合には、極端値を平均値±3SDで棄却するが、本調査のようにn数が比較的小さい場合には、シミュレーションの結果から平均値±2SDで棄却する方が適切であることが判明している。

1　評価規準

臨床検査領域における測定法、測定試薬、測定技術を含む測定装置等の進歩により、精度管理調査における報告値の施設間差は、いずれの施設で実施されている調査結果を見ても近年著しく縮小している。その結果、報告値の評価法として一般的に用いられてきた同一測定法群のSD（標準偏差）を基本とした統計学的評価法は、測定値の施設間差が縮小しても、常に同一比率でA、B、C、Dが出現し、項目により必要以上に厳しい評価となることから、評価法に限界があることが問題となってきている。

近年、欧米において個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準が測定法の性能評価の主流となりつつある。そこで、全衛連臨床検査専門委員会では、個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準の利用の可能性について検討を進めてきた。

その結果、この許容誤差規準を全衛連調査における評価規準として採用できることが判明したので、平成18年度（第15回）全衛連調査から従来の評価規準を個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更して評価することにした。この評価規準を採用して平成28年度で11年目になるが、この評価規準は全衛連の精度管理調査のみで使用されているため、評価規準設定の根拠および評価法の概要について今回も引き続いて解説する。

2　生理的変動を基本とした評価規準

(1)　生理的変動の性能評価への活用

個体の生理的変動は、個体内生理的変動と個体間生理的変動に分類されるが、その活用は、1996年、わが国の北村[1)]が個体内生理的変動の標準偏差の1/2を測定誤差の許容範囲とする考え方を提唱したことに端を発している。現在では、その考え方が測定の“精密さ”の許容誤差として国際的にも広く認識されている。その後、測定の“精密さ”だけでなく、個体内生理的変動および個体間生理的変動から計算された測定値の“かたより”および精密さとかたよりを統合した“総誤差”の許容誤差が加わっている[2, 3)]。以下にそれぞれの許容誤差に関する基本的な計算式とその解釈について示す。

① 精密さの許容誤差　$CV_A < 0.50CV_I$

分析の変動係数（CV_A）が、個体内生理的変動（CV_I）の1/2以下であるべきことを示す計算式となっている。

② かたよりの許容誤差　$B_A < 0.25（CV_I^2 + CV_G^2）^{1/2}$

分析のかたより（B_A）が、個体内生理的変動と個体間生理的変動（CV_G）から求めた総変動〔$（CV_I^2 + CV_G^2）^{1/2}$〕の1/4以下であるべきことを示す計算式となっている。

③ 許容総誤差　$TEa < 1.65（0.50CV_I + 0.25（CV_I^2 + CV_G^2）^{1/2}$

許容総誤差（TEa）が、精密さの許容誤差の1.65倍（測定値の分布の片側95%信頼区間に対する係数）とかたよりの許容誤差を加算した合計値以下であるべきことを示す計算式となっている。

(2)　生理的変動のデータベース

現在、個体内生理的変動および個体間生理的変動に関する基礎データについては国内外において多くの報告が見られるが、国際的にはRicosらのデータ[4)]が広く知られている。Fraser[3)]は、生理的変動は人種、年齢、地域等に関係なくほぼ一定であるという十分な証拠があるので、このRicosらのデータベースを国際的に共

通に活用することを提唱している。このデータベースは、米国においてもWestgardマルチルール管理法で著名なDr.Westgardにより管理法の設計の基礎データとしても利用されている[5)]。

そこで、全衛連臨床検査専門委員会では基礎データの国際的互換性の観点から、評価規準の計算にRicosらのデータベースを使用することとした。

(3) Fraserによる性能評価段階

Fraserは欧州グループによる勧告論文[2)]の主筆者であり、1980年代初頭以来、臨床化学検査の分析上の目標に関する多くの論文を発表しており、引用文献[3)]は、彼の研究の集大成でもある。彼は上記①～③の許容誤差を、基本的な“望ましい性能”として位置づけ、この“望ましい性能”を中心として、さらにその1/2を“最適性能”、最適性能の3倍を“最低限の性能”とする3段階の評価段階を、上記①～③のそれぞれの許容誤差に設けている。彼は、これら3段階の許容誤差について以下のように述べている。すなわち、日常検査の実際の性能を考慮したとき、生理的変動から計算された“望ましい性能”を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用いる必要があり、一方、“望ましい性能”を満たすことが困難な成分については“最低限の性能”を評価規準として用いる必要があると述べており、普遍性のある生理的変動という明確な根拠を基本とした、性能規準の活用を推奨しながらも、現在の技術水準を考慮した許容誤差段階の選択という柔軟性のある対応をすることを勧めている。このFraserの3段階の評価段階は、従来用いられてきた統計学的評価法の評価段階である1SD、2SD、3SDの3段階と類似した形式になっているため、利用しやすい特長がある。

3 生理的変動を基本とした評価規準の一般的解釈

以上の①精密さの許容誤差、②かたよりの許容誤差、③許容総誤差の3種類の許容誤差の適用範囲を考えると、一般的に①の精密さの許容誤差は、測定値の精密さの管理を目的とする内部精度管理用の規準として、②のかたよりの許容誤差は、主として測定値の正確さの評価を目的とする場合の規準として、③の許容総誤差は検査室認定等の規準として適切であると考えることができる。そのような観点から、全衛連臨床検査専門委員会では、評価規準の基本をかたより％の”望ましい性能”とすることとし、この性能を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用い、また日常の性能がかたより％の望ましい性能を満たさない場合は、許容総誤差の望ましい性能を基本とすることにした。日本臨床化学会のクオリティマネジメント専門員会[6)]においても、臨床化学成分の外部精度評価（精度管理調査）における許容誤差限界としてかたよりの許容誤差（BA）を用いることが適切であると述べている。

4　全衛連調査における評価規準としての考え方

(1)　評価規準の比較および検討

平成17年度（第14回）全衛連調査結果をもとに、調査対象項目のうち臨床化学項目については比較的施設数の多い代表的な測定法の参考値（又は平均値）、標準偏差およびそのデータから計算したCV%、2CV%、3CV%、血液学検査項目については従来の段階的評価規準（%）を用い、一方、各項目に対応する生理的変動のデータベースからかたよりの許容誤差、許容総誤差およびFraserの提唱する“最適性能”、“望ましい性能”、“最低限の性能”の3段階について計算し、平成18年度（第15回）の評価規準の基礎データとした。さらに臨床化学項目については平成18年度(第15回)全衛連の調査結果および平成18年度（第40回）日本医師会臨床検査精度管理調査（日医調査）結果報告書から、全衛連調査対象項目について同様の計算を行った。

これらの比較データについて検討を行った結果、臨床化学項目についてはかたより%の“望ましい性能”を基本的な評価規準として、精度管理調査からの日常の性能がそれよりも良好な場合には、“最適性能”を評価規準（A）とした。ただし、総コレステロールおよび血糖については、平成18年度（第15回）はいずれも“最適性能”を評価規準（A）としたが、全衛連調査結果のCV%に比較して日医調査結果のCV%が大きいため、日医調査結果との整合性を考慮して平成19年度（第16回）から“望ましい性能”を評価規準とすることとした。HbA1cについては日常の性能（CV%）が計算されたかたより%のいずれの性能規準をも超えることから、この項目に限って総誤差%の基本的な評価規準である”望ましい性能“を評価規準（A）とした。

血液学検査項目については新評価規準の初年度である平成18年度（第15回）に設定したように、赤血球数、ヘマトクリット値の2項目で従来の評価規準%がかたより%の“望ましい性能”を満たさないことから、“最低限の性能”を評価規準（A）として選択すると、その%が総誤差%の“最適性能”を超えることから、血液学検査項目間でかたより%と総誤差%の混在を避けるため、血液学検査項目全てについて総誤差%の“望ましい性能”を基本としていずれの項目も従来の評価規準%がそれよりも小さいことから、総誤差%の“最適性能”を評価規準（A）とすることにした。しかし、ここ数年の調査結果について検討を行ったところ、総誤差%の“最適性能”では、項目によりなお厳しい結果となることが判明してきたので、今回、総誤差%の“望ましい性能”の妥当性について検討した。その結果を踏まえて、評価規準の改訂を検討している。

(2)　報告最小単位による評価規準

従来の評価で、調査結果の標準偏差が、報告最小単位以下となる項目があり、必要以上に厳しい評価となっていた問題については、この評価規準でも、同様に

報告最小単位から計算された%が、最小評価%（A）を超える項目が発生するため、主として米国で行われている例にならい、そのような項目については±報告最小単位による評価規準を別途設けて%評価といずれか大きい方を評価規準とする方式をとった。今回も対象となった項目は、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、HbA1c、白血球数の7項目となった。

(3) 平成28年度（第25回）全衛連精度管理調査の評価規準

(1)の評価規準の検討結果を踏まえて、A、B、C、Dの4段階の評価規準を設定し、平成19年度（第16回）全衛連調査用の評価規準を作成し、平成28年度（第25回）も、引き続き同じ評価規準を用いた。その評価規準を表2-1（臨床化学項目）、表2-2（血液学検査項目）に示した。

(4) ドライケミストリー法使用機器の評価について

これまで全衛連精度管理調査において、ドライケミストリー法（ビトロスJ）での参加は1施設のみの参加であったため、毎回評価対象外「評価せず」となっていた。今回本調査参加以外の施設に協力をいただき、計5機器での統計処理を行った。その結果、ドライケミストリー法を用いた施設の測定精度が確保されていることが確認できた。ドライケミストリー法機器を使用している施設は潜在的に多いと見込まれるため、メーカーへの投げかけも含めて、ドライケミストリー法機器使用施設へ全衛連精度管理調査参加を勧めるよう、事務局から進言することとした。

参考文献

1) 北村元仕：精度管理の方法と問題点.臨床化学検査.医学の歩み、59分冊：383-394,1966.
2) Fraser CG, Hyltoft Petersen P, Ricos C, Haeckel R: Quality specifications for the imprecision and inaccuracy of analytical systems for clinical chemistry.Eur J Clin Chem Clin Biochem30:311-317,1992. .
3) Fraser CG著(中 甫訳):検査データの生理的変動 ―原理から実践へ―. 医歯薬出版(東京),2004.
4) Ricos C, Alverez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez a, Jimenez ＣＶ, Minchinela J, Perich c, simon M, :Current databases on biologi Ｃ Ｖ ariation:p;ros,cons and progress. Scand J Clin Lab Invest 59:491-500,1999.
5) Westgard JO: Six Sigma Quality Design & Control. Westgard Inc.(Madison WI53717,USA),2006.
6) 日本臨床化学会クオリティマネジメント専門委員会:プロジェクト報告 生理的変動に基づいた臨床化学検査36項目における測定の許容誤差限界 臨床化学35：144-.153,2006.

表２－１　生理的変動を基本とした測定値の評価規準（臨床化学検査）

項　目	参考値	評価規準		評価点	評価
総コレステロール	試料番号1～8		±0～4.0%	3	A
			±4.1～8.0%	2	B
			±8.1～12.0%	1	C
			±12.1%～	0	D
中性脂肪	試料番号1～8		±0～5.3%	3	A
			±5.4～10.7%	2	B
			±10.8～16.0%	1	C
			±16.1%～	0	D

項　目	参考値	評価規準（いずれか大きい方）		評価点	評価
尿酸	試料番号1～8	±0.1 mg/dL	±0～2.4%	3	A
			±2.5～4.8%	2	B
			±4.9～7.2%	1	C
			±7.3%～	0	D
クレアチニン	試料番号1～8	±0.05 mg/dL	±0～3.4%	3	A
			±3.5～6.8%	2	B
			±6.9～10.2%	1	C
			±10.3%～	0	D
AST	試料番号1～8	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D
ALT	試料番号1～8	±1 U/L	±0～6.0%	3	A
			±6.1～12.1%	2	B
			±12.2～18.1%	1	C
			±18.2%～	0	D
γ-GT	試料番号1～8	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D

項　目	参考値	評価規準		評価点	評価
血糖	試料番号1～8		±0～2.2%	3	A
			±2.3～4.4%	2	B
			±4.5～6.6%	1	C
			±6.7%～	0	D

項　目	平均値	評価規準		評価点	評価
HDLコレステロール	試料番号1～3		±0～2.6%	7	A
			±2.7～3.5%	6	B
			±3.6～4.4%	5	
			±4.5～5.2%	4	
			±5.3～6.5%	3	C
			±6.6～7.8%	2	
			±7.9～9.1%	1	D
			±9.2%～	0	
LDLコレステロール	試料番号1～3		±0～3.4%	7	A
			±3.5～4.5%	6	B
			±4.6～5.6%	5	
			±5.7～6.8%	4	
			±6.9～8.7%	3	C
			±8.8～10.2%	2	
			±10.3～12.0%	1	D
			±12.1%～	0	

項　目	平均値	評価規準（いずれか大きい方）		評価点	評価
ＨｂA1c	試料番号1～3	±0.1%(結果)	±0～2.7%	7	A
			±2.8～3.6%	6	B
			±3.7～4.5%	5	
			±4.6～5.4%	4	
			±5.5～6.8%	3	C
			±6.9～8.1%	2	
			±8.2～9.5%	1	D
			±9.6%～	0	

表２−２　生理的変動を基本とした測定値の評価規準（血液学検査）

項　目	平均値	評価規準		評価点	評価
ヘモグロビン	試料番号1～3		±0～2.1%	7	A
			±2.2～2.6%	6	B
			±2.7～3.3%	5	
			±3.4%～4.1%	4	
			±4.2～5.5%	3	C
			±5.6～6.2%	2	
			±6.3～7.6%	1	D
			±7.7%～	0	
赤血球数	試料番号1～3		±0～2.2%	7	A
			±2.3～2.8%	6	B
			±2.9～3.6%	5	
			±3.7%～4.4%	4	
			±4.5～5.9%	3	C
			±6.0～6.6%	2	
			±6.7～8.1%	1	D
			±8.2%～	0	

項　目	平均値	評価規準(いずれか大きい方)		評価点	評価
白血球数	試料番号1～3	$\pm 1\times10^{2}$	±0～7.3%	7	A
			±7.4～9.1%	6	B
			±9.2～11.7%	5	
			±11.8%～14.6%	4	
			±14.7～19.5%	3	C
			±19.6～21.9%	2	
			±22.0～26.8%	1	D
			±26.9%～	0	

項　目	平均値	評価規準		評価点	評価
ヘマトクリット値	試料番号1～3		±0～4.1%	7	A
			±4.2～5.2%	6	B
			±5.3～6.7%	5	
			±6.8%～8.2%	4	
			±8.3～11.0%	3	C
			±11.1～12.3%	2	
			±12.4～15.2%	1	D
			±15.3%～	0	
血小板数	試料番号1～3		±0～6.7%	7	A
			±6.8～8.4%	6	B
			±8.5～10.8%	5	
			±10.9%～13.4%	4	
			±13.5～17.9%	3	C
			±18.0～20.1%	2	
			±20.2～24.6%	1	D
			±24.7%～	0	

Ⅳ. 評価方法

1　平均値評価

前述のとおり、全ての項目で同一測定法群（peer group）の極端値棄却後の平均値を基準濃度とし、評価範囲は生理的変動を基本とした測定値の評価規準に示した評価規準で評価した。ただし、測定原理上同一平均値が得られると判断できる測定法群は、まとめて平均値を計算してその平均値を基準濃度とした。

1）各試料の評価点および評価

各試料の評価点および評価は、生理的変動を基本とした測定値の評価規準を前ページ（表2-1、表2-2）に示した。

2）複数試料の評価点

（1）8試料（各施設への送付は5試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した点数をその施設の評価点とした。

5試料の評価点の例：各試料の評価点が3点（A）であった場合は、3×5＝15点で100点満点となる。

評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表3のとおりである。

表3　15点満点の評価点と100点満点換算点対比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	6.7	13.3	20.0	26.7	33.3	40.0	46.7	53.3	60.0
評価点合計	10	11	12	13	14	15			
換算点合計	66.7	73.3	80.0	86.7	93.3	100			

（2）3試料（各施設への送付は2試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した換算点をその施設の評価点とした（3試料の評価点の例：各試料の評価点が7点（A）であった場合は、7×2=14点で100点満点となる。）。

評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表4のとおりである。

表4　14点満点の評価点と100点満点換算点対比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	7.1	14.3	21.4	28.6	35.7	42.9	50.0	57.1	64.3
評価点合計	10	11	12	13	14				
換算点合計	71.4	78.6	85.7	92.9	100				

（3）尿検査の評価

尿糖半定量、尿蛋白半定量および参考項目である尿潜血半定量の評価方法は従来どおりであるが、その内容は「Ⅴ．各論的考察の3．尿検査」の項を参照されたい。

2　解析値評価

段階的に混合した試料5試料を送付している項目については、従来通り測定値評価に加えて、試料濃度に対する直線性、各試料間の関係、精密度などの解析値による評価を行った。

ただし、送付した試料数が5試料未満では解析値評価ができないため、HDLコレステロール、LDL コレステロール、HbA1c、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数は、解析値評価は行わず、測定値評価のみとした。

1）解析値評価の種類と計算

各施設の全測定結果（5試料）について、施設別、項目別に以下の5種類の計算を行った。

1. 方向係数　$Y=a+bX$　のb（以下これを回収率という）
2. ばらつきの程度(再現性)　（$\sqrt{V_E}$）
3. 測定値を含む確率楕円の長軸の傾きの正切（tanθ）
4. パフォーマンス・インデックス1　（PI-1）
5. パフォーマンス・インデックス2　（PI-2）

2）解析値評価の解説

（1）回帰分析

試料濃度をX_i、測定値をY_iとすると、試料数から5組の変数ができる。

いまXを指定変数、Yを従属変数とすると、

回帰直線　　$Y=a+bX$

を求めることができる。測定値が全て平均値と一致した場合には

回帰式は　　$Y=1.00X$

となるが、実際には平均値と測定値の間に差があるため、

$Y=a+bX$という形になる。

したがって、この方向係数、すなわちbによって比例系統誤差（濃度に関係なく一定比率で生じている誤差）を推定できる。そこで、bを回収率として評価すると、bが1.00に近いほど評価点が高くなる。

一方、回帰直線がY軸と交わる切片aによって一定系統誤差（濃度に関係なく一定の大きさで生じる誤差）が推定でき、aの値が0から大きくずれていると、測定値に一定の大きさでかたよりが生じていることになるので、aでも評価できる。しかし、測定値に対する評価を試料ごとに行っているので、aについては評価項目としてとりあげていない。

また、回帰分析に対する分散分析を行って、再現性（$\sqrt{V_E}$）を求めると、この

値が小さいほど評価点が高くなる。

(2) 方向係数（回収率） b

回帰分析の手順にしたがって、次式により、方向係数 b を求め、これを回収率とした。

$$b=\frac{n\sum \mathrm{X}i\mathrm{Y}i-\sum \mathrm{X}i\sum \mathrm{Y}i}{n\sum \mathrm{X}i^2-\left(\sum \mathrm{X}i\right)^2}$$

(3) 再現性 $\sqrt{V_E}$

測定値 Y_i の変動（全変動SO）は、指定変動である平均値の変動（回帰による変動ＳＲ ）と、測定誤差による変動（回帰からの変動SE）とを含んでいる。測定誤差による変動は直接求めることはできないが、全変動SOから、回帰によるSRを差し引いたものとして求めることができる。

$$\text{全　　変　　動　－－－－　SO　}=\Sigma\left(Y_i-\overline{Y}\right)^2$$

$$\text{回帰による変動　－－－－　SR　}=b^2\,\Sigma\left(X_i-\overline{X}\right)^2$$

であるので、

$$\text{回帰からの変動　－－－－　SE　}=\text{SO}-\text{SR}$$

となり、これによって測定誤差による変動を求めることができる。

このSEを自由度（n-2）で割ったものの平方根 $\sqrt{V_E}$ を再現性としたが、これはσｙｘとして表されたり、回帰直線に関する標準偏差ともいわれているものである。

$\sqrt{V_E}$ の値が小さければ小さいほど評価点はよくなる。この値は平均値の値によっても変わることから、できるだけ同じ条件で評価できるように、$\sqrt{V_E}$ の評価に当っては　$\sqrt{\frac{1}{n}\sum \chi_i^{\,2}}$

に定数を掛けた数値を区切り値とした。

(4) tanθ（確率楕円の長軸の傾き角の正切）

回帰直線は、測定値群から最小2乗法によって求められるものである。測定値をグラフ上にプロットしてみると、それらの点は当然回帰直線の両側にばらついてる。それから、それらの測定値を含む確率楕円を求めることができる。理想的な場合には、この確率楕円のふくらみはなくなり、回帰直線と一致するはずである。しかし、測定値のばらつきが大きくなると、このふくらみが大きくなり、さらに楕円の長軸の方向も回帰直線の方向から離れてくる。

したがって、この確率楕円の長軸の傾き角によって測定のばらつきを知ること

ができる。実際には次式を用いて、長軸の傾き角の正切（tanθ）によってばらつきを調べている。

tanθは、次式により求めた（土屋、杉田、桜井　産業医学、247, 20　1978）。

$$\tan\theta = \frac{-\left(\sigma^2\chi - \sigma^2 y\right) + \sqrt{\left(\sigma^2\chi - \sigma^2 y\right)^2 + 4\sigma^2\chi y}}{2\sigma\chi y}$$

σ^2X、σ^2ｙ は平均値X_i、測定値Y_iの分散、Χｙは共分散で、X_i、Y_iの変動（平均からの差の平方和）を自由度（n-1）で割ったものであるが、上式で明らかなように、変動そのもので計算しても同じ結果が得られるので、変動そのもので計算した。

tanθによる評価：

実際には測定結果一覧表から、tanθの値を求めると、ほとんどの場合回収率 b の値に一致しているか、それと近い値であるが、$\sqrt{V_E}$ の値が大きくなればなるほど、2つの間の差が大きくなる。そこで回収率は、方向係数 b とこのtanθの値とを合わせて総合評価することとした。

(5) パフォーマンス・インデックス

Performance Index（PI）は、誤差（測定値と平均値の差）の絶対値と、平均値の比で表したもので、次の2つの計算式から求める。

$$\mathrm{PI}-1 = \frac{\sum\left|Y_i - X_i\right|}{\sum X_i}$$

$$\mathrm{PI}-2 = \frac{1}{n}\sum\frac{\left|Y_i - X_i\right|}{X_i}$$

PI-1は、各調査項目の5試料全部の、各平均値と測定値との間の差の絶対値の合計と、平均値の合計との比であり、PI-2はそれぞれの試料ごとの平均値と測定値との間の差の絶対値と、平均値との比を求め、5試料についての平均を求めたものである。

以上から、測定項目ごとの平均値が同程度であれば、いずれのPIも、ほぼ同じ値になるが、平均値が低濃度から高濃度までの広い範囲にわたっている場合には、PI-1とPI-2の間には、差が生じることがある。

PIは測定誤差の絶対値と、平均値との間の比を表す値であるので、当然PI値が小さければ小さい程、評価点は高くなり、PIの値が0.1以下であれば、信頼度が非常に高いと考えてよい。

3）評価点

5 種類の解析値評価法のそれぞれについて全施設の解析値の 2SD 以内を A、3SD 以内を B、4SD 以内を C、これを超えるものを D とした。なお、配点は平均値評価と同じである。

5 種類の解析評価法全てが評価 A であれば、合計 15 点となる。これを 100 点満点に換算して解析値評価点とする。

評価基準を表 5 に、各解析パラメータを表 6 に示す。

表 5 評価規準（1～6）の評価点と評価

			評価点	評価
範囲 1	平均+4×標準偏差	範囲 4 以上範囲 3 以下	3	A
範囲 2	平均+3×標準偏差	範囲 3 より大きく範囲 2 以下	2	B
範囲 3	平均+2×標準偏差	範囲 5 以上範囲 4 より小さい	2	
範囲 4	平均-2×標準偏差	範囲 2 より大きく範囲 1 以下	1	C
範囲 5	平均-3×標準偏差	範囲 6 以上範囲 5 より小さい	1	
範囲 6	平均-4×標準偏差	範囲 1 より大きいもしくは範囲 6 より小さい	0	D

表 6 解析値平均と標準偏差

	調査項目	測定法	区分	y 切片	回収率	再現性	t a n θ	P I 1	P I 2
1	総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法･脱水素酵素法	平均値	-0.04575215	1.00050761	0.55287816	1.00060869	0.00640049	0.00646591
			標準偏差	1.07655659	0.01040662	0.2741873	0.00929392	0.00394723	0.00364517
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	-6.5192E-14	1	0.86870564	1.00014501	0.00947565	0.00865599
			標準偏差	2.16550039	0.02245254	0.4058905	0.02236487	0.00547715	0.00515643
2	中性脂肪	酵素UV法･比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	平均値	0.32341454	0.99777595	0.42143646	0.99787868	0.0084792	0.00863119
			標準偏差	1.1627687	0.01574115	0.1880701	0.01574139	0.00483033	0.00486618
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	3.6411E-13	1	0.61881315	1.00008474	0.00461361	0.00484596
			標準偏差	1.38555745	0.00911542	0.23167992	0.00915858	0.00081558	0.00102847
3	AST	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	-0.07617272	1.00118356	0.84168548	1.00098528	0.02377838	0.02419852
			標準偏差	0.70314646	0.02885198	0.38193221	0.02923217	0.01693662	0.01719943
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	-2.5624E-14	1	0.87472814	1.00016988	0.01361097	0.0184283
			標準偏差	1.86239025	0.02355495	0.30293784	0.02354882	0.0034951	0.00696072
4	ALT	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	-0.02211653	0.99877437	0.61656873	0.99886931	0.01085593	0.01233584
			標準偏差	0.63629746	0.01353178	0.40175138	0.01375077	0.005605	0.00545624
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	-5.7931E-14	1	0.90037733	1.00022014	0.00919134	0.00900101
			標準偏差	0.55260465	0.01277432	0.23052959	0.01279878	0.00252149	0.00226352
5	γ-GT	JSCC標準化対応法	平均値	0.01481798	0.999735	0.43819442	0.9997782	0.0072596	0.00811043
			標準偏差	0.51123597	0.00847495	0.15750206	0.0084758	0.00426124	0.00425129
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	4.3132E-14	1	0.5352412	1.00007875	0.01195559	0.01220006
			標準偏差	0.80983805	0.01588033	0.12216959	0.01588615	0.00720581	0.00754744
6	血糖	ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素比色法･電極法/ ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ･UV法/ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	平均値	-0.0390766	1.0023804	0.47869251	1.00247055	0.00579463	0.00598809
			標準偏差	0.98327731	0.00798265	0.30768037	0.00794881	0.00276098	0.00281442
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	3.8058E-14	1	0.53979491	1.00005481	0.0045755	0.0046296
			標準偏差	1.12934369	0.00856037	0.14788114	0.00858484	0.00217481	0.00229193
7	尿酸	ｳﾘｶｰｾﾞ･ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	平均値	0.02372073	0.99784722	0.03189134	0.99827951	0.00559797	0.00569857
			標準偏差	0.09882121	0.01658582	0.01322501	0.01662607	0.00378449	0.00389343
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	-8.3523E-15	1	0.02477759	1.0002452	0.0023571	0.00233802
			標準偏差	0.07503108	0.011523	0.00997652	0.01155867	0.0009129	0.00102724
8	クレアチニン	酵素法	平均値	-0.0003854	1.00014472	0.01002076	1.00011083	0.00666939	0.00735565
			標準偏差	0.01918952	0.00838962	0.00470707	0.00833224	0.00415586	0.00470567
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	-0.00228397	1.00097645	0.01293804	1.00099893	0.00863229	0.00816525
			標準偏差	0.0137216	0.01083653	0.00373031	0.01084214	0.00333697	0.00335823

３．総合点評価

項目別に各施設の測定値評価点、解析値評価点を合計し、100点満点換算して総合評価点とした。

各施設に送付された評価点一覧票には、調査項目、項目ごとの測定方法（コード番号）、試料ごとの評価に用いた基準濃度である平均値、その施設の測定値、試料No．別測定評価（A～D）、測定値評価点（換算点合計）、解析値評価点（換算点合計）、総合評価点(換算点合計)、過去3回の総合評価点を記入している。

Ⅴ．各論的考察

【臨床化学検査】

はじめに

臨床化学検査（参考調査項目も含めて）は、日本医師会臨床検査精度管理調査にあわせて、例年通り各調査項目について検量用試料（キャリブレータ）の種類（ただし酵素項目は検量法、HbA1c については標準液および検量方法の種類）の調査、およびトレーサビリティの確認に利用した標準品（ただし HbA1c は除く）の調査を行った。

さらに本調査では、データ解析の参考とするため使用したキットの正式名称を省略しないで記入していただいている。

図 1 は酵素を除く 7 項目の検量用試料（キャリブレータ）の使用比率を第 23 回から第 25 回の 3 年間について 100%積み上げグラフで示し、同様に図 2 は酵素項目における検量法の使用比率を同 3 年間について施設数で示した。

図 3 は酵素を含む 8 項目のトレーサビリティ確認における標準品使用比率を同 3 年間の推移について 100%積み上げグラフで示した。

表 7 は HbA1c の標準液および検量方法の種類ついて同様に過去 3 年間について施設数で示した。今回より HDL コレステロールおよび LDL コレステロールについても示している。

なお、各外部機関は複数の施設から受託している場合が多いが、それぞれ独立したデータとして扱っている。

結果の詳細については各項目の各論においてそれぞれ述べることにする。

図1 検量用(キャリブレータ)の種類（3年間推移）

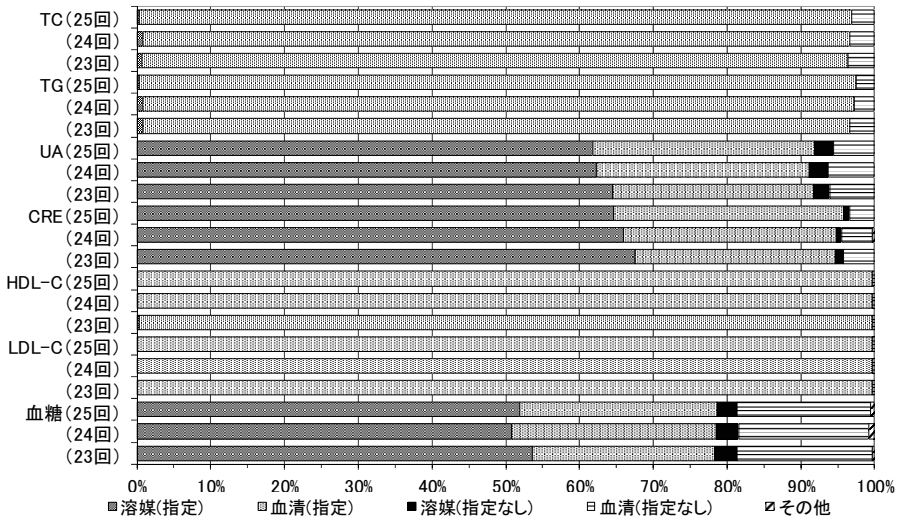


図2　酵素項目における検量法の使用比率の推移（3年間推移）

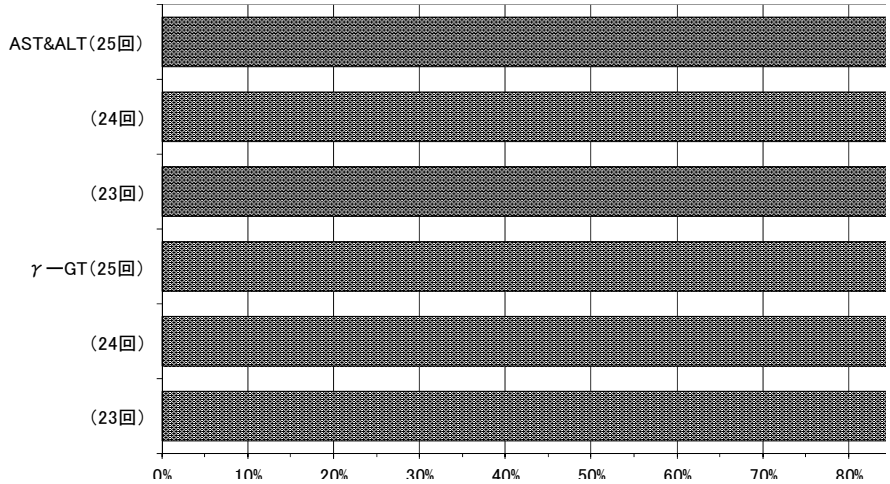


図3トレーサビリティの確認における標準品の使用比率の3年間推移

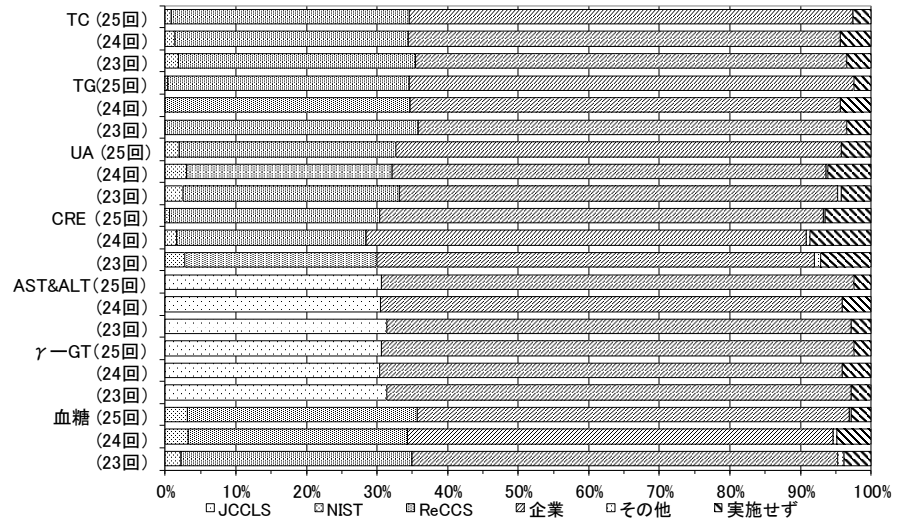


表 7　HbA1c標準液、検量方法の種類（機関数）

	HPLC法（不安定分画除去）			免疫学的方法			酵素法		
標準液、検量方法の種類	第25回調査	第24回調査	第23回調査	第25回調査	第24回調査	第23回調査	第25回調査	第24回調査	第23回調査
指定表示値（そのまま使用）	97	100	99	146	151	150	112	111	107
指定表示値（変更して使用）	0	0	1	0	0	0	0	0	1
指定以外表示値（そのまま使用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定以外表示値（変更して使用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自家製標準液	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装置の係数（そのまま使用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装置の係数（補正して使用）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機関数合計	97	100	100	146	151	150	112	111	108

第24回調査における図表に関する説明

1. 外部機関は複数の機関から受注している例があるが、すべての参加機関をそれぞれ独立した数として集計している。
2. 今年度よりHDLコレステロールおよびLDLコレステロールのトレーサビリティの確認における標準品の使用比率を記載した（図3参照）。
3. HbA1cはHPLC法、免疫学的方法、酵素法別の機関数で表現した。

１．総コレステロール

総コレスロールの測定には356施設が参加した。昨年より7施設減少したが、例年の平均的な参加施設数であった。参加施設の内訳は自施設測定数が151件（42.4 %）、外部施設測定数が205件（57.6%）である。

測定方法の分類はコレステロール酸化酵素法が自施設測定で140施設（39.3 %）、外部施設測定では183施設（51.4 %）、コレステロール脱水素酵素法が自施設測定で10施設（2.8%）、外部施設測定では22施設（6.2 %）であった。その他にドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が1施設（0.3 %）あった。コレステロール酸化酵素法が全体の90.7 %を占め、測定方法の分類もこれまでとほぼ同様で変化はみられなかった。

測定値の濃度範囲は試料1が平均値で77.50 mg/dL、試料8では205.47 mg/dLで昨年の濃度範囲（117.98 mg/dL～203.90 mg/dL）、一昨年の濃度範囲（91.16～202.36 mg/dL）に比べ、低濃度域が昨年、一昨年と違い、低い測定値についても確認ができた。総コレステロール測定では低濃度域から約20 mg/dLの間隔で濃度が分布して、低濃度域からの直線性が確認できた。できれば、高濃度域について、もう少し高値についての基準範囲を網羅する濃度範囲の試料の提供が望まれた。

試料1～8の標準偏差は0.76～1.69 mg/dLでその変動係数は0.71～1.01（%）であり、昨年に比べるとバラツキが少なかった。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は製造販売元指定の血清ベースのものが344施設（96.6 %）で最も多く使用され、その他に溶媒ベースのものが1施設（0.3 %）、製造販売元指定以外の血清ベースのものが11施設（3.1 %）であった。昨年に比べて、製造販売元指定の血清ベースのものを使用している施設が4施設減少し、また、製造販売元指定以外の血清ベースを使用している施設は僅かではあるが1施設減少した。

トレーサビリティの確認はNISTの標準品を利用しているのが3施設（0.8 %）、ReCCSの標準品が120施設（33.7 %）、企業の標準品が224施設（62.9 %）、実施していない施設が9 施設（2.7 %）であった。企業の標準品を用いる施設が昨年〔222施設（61.2 %）〕、一昨年〔220施設（61.1 %）〕に比べてわずかだが年々増加していて、トレーサビリティを確認していない施設が昨年〔16施設（4.4 %）〕より7施設減少、一昨年〔12施設（3.3 %）〕より3施設減少した。

トレーサビリティの確認作業は、関連学会の指導や精度管理調査報告会の繰り返しての説明などによって、現在では多くの施設の精度管理業務として実施されてきている。やはりすべての施設において、年間に1から2回程度、“企業の標準品”以上で確認されることが望まれる。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は90点以上が334施設（構成比：93.8%、昨年96.1%、一昨年94.7%）、80点以上～90点未満が12施設（3.4%、昨年2.2%、一昨年3.3%）、70点以上～80点未満は6施設（1.7 %、昨年0 %、一昨年1.4 %）、60点以上～70点未満は2施設（0.6 %、昨年0 %、一昨年0.3 %）、60点未満が2施設（0.6 % 昨年1.7 %、一昨年0.3 %）であった。参加数が7施設減少したが、90点以上の評価点

を得た施設数が15施設減少し、よって構成比も減少している。60点以上の他の点数の分布はほぼ例年の施設数と思われた。60点未満の施設数が昨年の6施設から2施設に減少した。今回は、不注意な測定試料の取り扱い、測定結果の登録などの間違いが低減したと判断された。

日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられた施設には改善を求め、なお一層の努力が求められる。

２．中性脂肪

中性脂肪の測定には総コレステロールと同様に356施設の参加で、昨年より7施設ほど減少した。参加施設数の内訳は自施設測定が156施設（42.4 %）、外部施設測定が201施設（57.6 %）でる。

測定方法の分類は酵素UV法（グリセロールを消去する方法）が自施設測定で7施設（2.0%）、外部施設測定では2施設（0.6 %）で、酵素比色法（グリセロールを消去する方法）は自施設測定で143施設（40.2 %）、外部施設測定では203施設（57.0 %）で、ドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が自施設測定で1施設（0.3 %）であった。酵素比色法（グリセロールを消去する方法）が自施設測定と外部施設測定を合わせて97.2 %を占め、これまでと同様に日常検査での中性脂肪の主要な測定方法に採用されていた。測定方法の分類もこれまでとほぼ同様であり変化は無かった。

測定値の濃度範囲は試料1が平均値で53.06 mg/dL、試料8では135.11 mg/dLで、総コレステロールと同様に昨年の濃度範囲（46.65～115.06 mg/dL）、一昨年の濃度範囲（46.37～120.87 mg/dL ）に比べ、低濃度域で約6 mg/dLほど高値となり、高濃度域についても高値になった。試料は低濃度域から約12 mg/dLの間隔で濃度が分布して、測定の直線性も確認できた。下限濃度域が上昇したことは残念であるが、高濃度域が15～20 mg/dL上昇したことは、基準範囲の上限濃度域に近づくことができ、良好に思われた。

試料1～8の標準偏差は0.61～1.42 mg/dLで、その変動係数は1.03～1.18（%）であり、昨年に比べ、バラツキが少なかった。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は製造販売元指定の血清ベースを使用しているのが346施設（97.2 %）で最も多く、溶媒ベースが1施設（0.3 %）で、製造販売元指定以外の血清ベースは9施設（2.5 %）で、昨年と大きく変わらなかった。これまでと同様にすべての施設において測定試薬で最適な関係にある製造販売元指定の血清ベースの検量用試料を使用することが望まれる。

トレーサビリティの確認はNISTの標準品を利用しているのが1施設（0.3 %）、ReCCSの標準品を使用しているのが122施設（34.3 %）、企業の標準品は224施設（62.9 %）、実施していない施設が9施設（2.5 %）であった。トレーサビリティの確認はNIST、ReCCSの標準品と企業の標準品を合わせて、97.5 %の施設で実施されて

いて、昨年〔347施設（95.6 %）〕よりも約2 %上昇した。

トレーサビリティの確認を実施していない施設が、昨年〔16施設（4.4 %）〕より7施設、一昨年〔12施設（3.3 %）〕と比べて3施設も減少した。総コレステロールと同様、トレーサビリティの確認作業は施設の精度管理業務として実施が当然となってきている。すべての施設において、年間に1から2回程度、“企業の標準品”以上で確認することが望まれる。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は90点以上が328施設（構成比：92.1 %、昨年95.9 %、一昨年91.1 %、その前95.2 %）、80点以上～90点未満が14 施設（3.9 %、昨年1.7 %、一昨年2.8 %、その前2.5 %）、70点以上～80点未満が10施設（2.8%、昨年0.6 %、一昨年4.2 %、その前1.1%）、60点以上～70点未満が4施設（1.1 %、昨年0.8 %、一昨年1.7 %、その前0.6 %）、60点未満が0施設（0 %、昨年1.1 %、一昨年0.3 %、その前0.6 %）であった。

90点以上の評価点の施設が20施設（348→328）減少し、80点以上～90点未満が8施設（6→14）増加し、70点以上～80点未満が8施設（2→10）増加し、60点以上～70点未満の施設が1施設（3→4）増加し、60点未満の施設は0施設（4→0）に減少した。これらの結果から、90点以上の施設は減少したが、全体的には良好な方向に向かっていることが判断できた。また、60点未満が0施設であったことから、測定試料の取り扱い、測定結果の登録などの間違いが無かったと判断される。

日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられる施設には改善を求め、なお一層の努力が求められる。

３．尿酸

尿酸測定には356施設が参加した。昨年に比べ7施設減少した。内訳は自施設測定が151、外部施設測定が205施設であった。全体での測定法別の分類は、ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法が99.7%（355施設）を占め、内訳は、自施設測定では99.3%（150施設）、外部施設測定では100%（205施設）がこの方法で検査を実施していた。その他の測定法としてドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が自施設測定で1施設あった。

ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法による試料1から8までの平均値は、5.09～8.01 mg/dLの濃度範囲で、平均0.44 mg/ dL程度の濃度勾配から測定の直線性が確認できた。

各試料の標準偏差は、0.05～0.07 mg/dLの範囲であり、また、全濃度域の変動係数も0.75～1.09%と昨年（0.77～1.36%）と同様に極めて良好な評価結果であった。

各施設が用いる検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定の溶媒ベースが61.8%（220施設）と最も多く、製造販売元指定の血清ベース使用が30.1%（107施設）、製造販売元指定以外の血清ベース使用が5.6%（20施設）、製造販売元指定以外の溶媒ベース使用施設が2.5%（9施設）の順であった。キャリブレータ使用

比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品の比率は91.9%（327施設）となった。昨年の90.3%より増加した。製造販売元指定の血清ベースの検量用試料の使用が望まれる。

トレーサビリティの確認は、企業の標準品が63.2%（225施設）で最多であり、次にReCCSの標準品が30.6%（109施設）、NISTの標準品が2.0%（7施設）の順で参加施設の95.8%（341施設）がトレーサビリティの確認を実施していた。日本医師会主催精度管理調査の87.7%に比べ高い実施率である。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが一層浸透した結果と考えられる。各施設は精度保証の確立にむけてさらに努力していただきたい。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、自施設測定で90点以上は134施設（88.7%、昨年92.9%）、60点以上90点未満は17施設（11.2%、昨年6.4%）、60点未満の施設はなかった。総合評価点が60点未満の自施設測定は、昨年の1施設から減少した。昨年60点未満の1施設は、今回80点以上の評価点が得られたことを確認した。

外部施設測定で90点以上は195施設（95.1%、昨年96.6%）、60点以上90点未満は10施設（4.9%、昨年3.4%）、60点未満の施設はなかった。総合評価点が60点未満の外部施設測定施設は、昨年の2施設から今回は減少した。なお、昨年60点未満の2外部施設測定施設は、外部委託の管理が有効に機能して改善が図られたことを確認した。

尿酸測定の調査試料の濃度範囲も適切であった。今回の「総合評価点」は、90点以上を有した施設が全体の92.4%を占め、昨年の95.0%より減少した。また、トレーサビリティの確認を341施設（95.8%）が実施している。未実施の15施設は早急にトレーサビリティを確認する必要がある。測定体系のトレーサビリティ確認に注意を払い、日常検査において適正なキャリブレーションを実行していることが検査精度を維持・向上させるために重要である。

４．クレアチニン

クレアチニンには356施設が参加した。昨年に比べ8施設減少した。内訳は自施設測定が151、外部施設測定が205施設であった。全体での測定法別の分類は酵素法が99.7%（355施設）を占め、内訳は、自施設測定では99.3%（150施設）、外部施設測定では100%（205施設）がこの方法で実施していた。その他の測定法としてドライケミストリー法ビトロス（オーソ）が自施設測定で1施設あった。

酵素法による試料1から8までの平均値は、1.01～5.04mg/dLの濃度範囲で、平均0.61mg/dL程度の濃度勾配から測定の直線性が確認できた。

各試料の標準偏差は、0.02～0.04mg/dLの範囲であり、調査項目の中でも低値を取る項目である。また、全濃度域のCVも0.78～1.98%と前回（0.81～1.81%）と同様に良好な評価結果であった。

各施設で用いた検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定溶媒

ベース使用が64.6%（230施設）と最も多く、製造販売元指定の血清ベース使用が31.2%（111施設）、製造販売元指定以外の血清ベース使用が3.4%（12施設）、製造販売元指定以外の溶媒使用施設が0.8%（3施設）の順であった。キャリブレータの使用比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品の比率は95.8%（341施設）となった。昨年の98.4%より減少した。製造販売元指定の血清ベースの検量用試料の使用が望まれる。

トレーサビリティの確認を実施している施設は93.5%（333施設）で、その内訳は企業の標準品が62.9%（224施設）であり、次にReCCSの標準品が29.8%（106施設）、NISTの標準品が0.6%（2施設）、その他の標準品が0.3%（1施設）であった。なお、トレーサビリティを確認している施設数は、18年度（37.8%）、19年度（65.2%）、20年度（78.7%）、21年度（80.6%）、22年度（85.7%）、23年度（86.4%）と経年的に着実に増えていた。24年度は81.5%と減少したが25年度以降は着実に増加している。日本医師会主催精度管理調査の86.7%に比べ高い実施率である。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが一層浸透した結果と考えられる。引き続き各施設は精度保証の確立にむけて努力していただきたい。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、自施設測定で90点以上の施設は130施設（86.1%、昨年96.2%）、60点以上90点未満は20施設（13.3%、昨年3.2%）、60点未満は1施設（0.7%、昨年0.6%）であった。総合評価点が60点未満の自施設測定施設は、昨年と同様に今回も1施設であった。昨年60未満の1施設は、改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた1施設は、誤差原因の究明と改善を図っていただきたい。

外部施設測定で90点以上は202施設（98.5%、昨年97.6%）、60点以上90点未満は3施設（1.5%、昨年1.5%）、60点未満の施設はなかった。総合評価点が60点未満の自施設測定施設は、昨年の2施設から減少した。なお、昨年60未満の2施設は、外部委託先の管理が有効に機能して改善が図られたことを確認した。今回、誤差が見受けられた施設は、誤差原因の究明と改善を図っていただきたい。

クレアチニン測定の試料については、昨年と同じく各試料間の濃度勾配が一定に保たれており、調査試料の濃度範囲も適切であった。今回の「総合評価点」は、90点以上を有した施設が全体の93.3%を占め、昨年の97.0%と比べ減少した。また、トレーサビリティの確認を333施設（93.5%）が実施している。未実施の23施設は早急にトレーサビリティを確認する必要がある。

５．AST、ALT

最初に、今回の試料でASTのみ融解後１時間以内は測定値が安定しないことが判明し「ASTは評価しない」こととなった。今回はASTデータに関することについてはコ

メントを割愛することとした。

JSCC標準化対応法を使用している施設はAST、ALT共に全参加356施設中355施設（99.7%）で、それ以外はドライケミストリー法ビトロスJ 1施設のみであった。これは日本医師会臨床検査精度管理調査における94.5%をはるかに上回っている。

今回のALTの試料活性は20~138U/Lで前回と比較して低活性試料の活性値がやや高く、高活性試料で高くなっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を前回と比較すると、やや縮小している結果であった。また日本医師会臨床検査精度管理調査における近似した活性試料の１回棄却後の標準偏差と比較すると本調査の標準偏差はやや小さい結果であった。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、図2から明らかなように企業の酵素キャリブレータを用いている施設は第23回では100.0%、第24回は99.7%、今回の第25回は100.0%と高い利用率が保たれており、日本医師会臨床検査精度管理調査におけるJSCC標準化対応法での製造業者製品校正物質（製造販売元指定以外を含む）の利用率（99.3%）より上回っていた。

トレーサビリティの確認については図3に示すように、第23回は97.5%、第24回では95.9%、そして今回の第25回では97.7%の施設で行われていた。第24回は第23回より1.6%減少したが、今回は第23回と同程度に戻った。

今回のALTの結果で80点以上の施設は自施設測定で98.0%（前回96.8%）、外部施設測定で98.5%（前回99.5%）であった。自施設測定は前回より多くなり、外部施設測定では少なくなった。

一方、60点未満だった施設は自施設測定で1施設（前回2施設）、外部施設測定で1施設（前回1施設）であり、自施設測定は前回と比較して1施設減少し、外部施設測定は同じだった。60点未満だった施設の詳細を確認すると、共に5試料のうち1試料のデータが明らかに外れた値であった。今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回ALTで60点未満だったのは自施設測定で2施設、外部施設測定で1施設だった。このうち、自施設測定の1施設と外部施設測定の1施設は前回検体の取り違いがあった施設であり、今回は90.0点と96.7点であった。また、残りの自施設測定1施設も今回100点と改善がみられた。

次に解析値評価点に対しての解析では、今回ALTが60点未満だったのは自施設測定で2施設（前回3施設）、外部施設測定で2施設（前回1施設）あり、自施設測定で1施設減少し、外部施設測定では1施設増加した。このうち、1試料ずつ明らかに外れた自施設測定の1施設と外部施設測定の1施設は共に解析値評価点は0点だった。残りの2施設は共に前回100点と好成績であり、トレーサビリティの確認を行っている。解析値評価点が60点未満となる要因は、比例系統誤差によるものが多く占められているが、偶発誤差が発生した場合も考えられる。比例系統誤差がみられる要因は概してキャリブレーションの問題だが、偶発誤差はメンテナンス不良が主な要因となる。各施設の測

定値と調査試料測定結果に掲載の平均値を比較し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回解析値評価点がALTで60点未満だったのは自施設測定では3施設、外部施設測定は1施設だった。このうち、自施設測定の1施設と外部施設測定の1施設は前回検体の取り違いがあった施設であり、今回は80.0点と93.3点であった。また、自施設測定1施設は今回100点と改善がみられ、残りの自施設測定1施設は今回外部施設測定に変更となっており、当該施設で改善がなされたかは確認できなかった。

以上の問題点を除き全体的にみると本調査に参加した施設のALT測定の技術水準は高いといえるが、総合評価点成績が良くても解析値評価点が低い施設はさらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

６．γ-GT

JSCC標準化対応法を使用している施設は参加356施設中355施設（99.7%）、それ以外はドライケミストリー法ビトロスJの1施設のみであった。これは日本医師会臨床検査精度管理調査における95.8%を大きく上回っている。

今回の試料活性は30~152U/Lで前回と比較して低活性試料はほぼ同じ、高活性試料で高値となっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を前回と比較すると、やや縮小している結果であった。また日本医師会臨床検査精度管理調査における近似した活性試料の評価用標準偏差１回棄却後の標準偏差と比較すると本調査の標準偏差がやや小さい結果であった。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、図2から明らかなように企業の酵素キャリブレータを用いている施設は第23回では100.0%、第24回は100.0%、今回の第25回も100.0%と高い利用率が保たれており、日本医師会臨床検査精度管理調査におけるJSCC標準化対応法での製造業者製品校正物質（製造販売元指定以外を含む）の利用率（98.0%）より上回っていた。

トレーサビリティの確認については図3に示すように、第23回は97.5%、第24回では95.9%、そして今回の第25回では97.7%の施設で行われていた。第24回は第23回より1.6%減少したが、今回は第23回と同程度に戻った。

今回の結果で80点以上の施設は自施設測定で93.3%（前回96.1%）、外部施設測定で99.0%（前回99.0%）と、自施設測定は前回より少なく、外部施設測定は前回と同じであった。

一方、60点未満だった施設は自施設測定で1施設（前回3施設）、外部施設測定で0施設（前回1設）であり、自施設測定は前回と比較して2施設減少、外部施設測定では1施設減少した。この自施設測定施設はトレーサビリティの確認を行っているようだが、γ-GTのみの結果が大きく外れていた。施設の測定値と表17の平均値を比較し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回60点未満だったのは自施設測定で3施設、外部施設測定で1施設だった。このう

ち、自施設測定の1施設と外部施設測定の1施設は前回検体の取り違いがあった施設であり、今回は共に100点であった。また、自施設測定の1施設は今回90点と改善がみられ、残りの自施設測定1施設は今回外部施設測定に変更となっており、当該施設で改善がなされたかは確認できなかった。

次に解析値評価点に対しての解析では、今回60点未満だったのは自施設測定で9施設（前回5施設）、外部施設測定は1施設（前回2施設）であり、自施設測定で4施設増加、外部施設測定で1施設減少した。このうち、自施設測定の5施設と外部施設測定の1施設は前回100点と好成績であった。また、自施設測定1施設の前回の評価点は60点と低く、前回の測定値が高値傾向だったのに対し、今回は低値傾向と大きな差が生じていた。全施設でトレーサビリティの確認を行っているようだが、大部分の施設で比例系統誤差がみられており、また偶発誤差がみられた施設もあった。今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

また、この中の2施設は製造販売元指定以外の酵素キャリブレータを用いていると回答していた。同じメーカーの試薬を使用し、共に高値傾向のデータであったので、製造販売元指定以外の酵素キャリブレータを用いたことが原因でズレが生じたのではないかと推測した。さらに調査を進めると、今回使用された試薬メーカーでは酵素キャリブレータを販売しておらず、別のメーカーの酵素キャリブレータを指定していることが確認できた。実際にはこの2施設は試薬製造販売元が指定したメーカーの酵素キャリブレータを使用しており、検量法の回答が誤っていたことになる。よって、今回使用した酵素キャリブレータのメーカーが問題だったのではなく、別の原因でデータ不良となったと思われる。酵素キャリブレータを販売していない試薬製造販売元は他にもあるので、検量法を回答する際は十分注意していただきたい。

前回解析値評価点が60点未満だったのは自施設測定で5施設、外部施設測定で2施設だった。前回検体の取り違いがあった施設を含めて今回80点～100点と改善がみられた。

以上の問題点を除き全体的にみると本調査に参加した施設のγ-GT測定の技術水準は高いと言えるが、総合評価点成績が良くても解析値評価点が低い施設はさらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

７．血糖

血糖測定の参加機関数は356施設（前年364施設）であり、内訳は自施設測定が151施設（前年157施設）、外部施設測定が205施設（前年207施設）であった。全体での測定法別分類は、JSCC勧告法と同一測定原理のヘキソキナーゼ･UV法が88.5%（前年89.3%）であり、前年と比較し僅かに減少した。測定法別分類は自施設測定と外部施設測定で異なり、表8のように自施設測定ではヘキソキナーゼ･UV法が76.2%、ブドウ糖酸化酵素電極法が19.9%であり、その他にブドウ糖脱水素酵素法、ブドウ糖酸化酵素比色法、ドライケミストリー法がわずかに用いられていた。外部施設測定ではヘキ

ソキナーゼ･UV法が97.6％と大部分を占めており、この傾向は前年と同様であった。また測定機器は、日本電子JCA-BMシリーズ53.4％（前年54.7％）、日立ハイテクノロジーズ21.3％（前年20.6％）、東芝6.5％（前年6.0％）、エイアンドティー6.2％（前年5.2％）、ベックマン・コールター5.9％（前年6.0％）、アークレイマーケッティング 3.7％（前年3.6％）、協和メデックス2.8％（前年3.3％）、オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス0.3％（前年0.3％）でありこの傾向は前年と同様であった。

1試料につき測定施設数が5未満の測定法（または測定試薬）については計算値の統計学的意義が乏しいことから「評価せず」となる。「評価せず」を除き、極端値（平均値±3SD）棄却後の試料1~8の平均濃度は91.52～204.26mg/dLであり、前年の平均値とほぼ同じ範囲であった。また測定値標準偏差も前年とほぼ同じであった。糖尿病診断基準の126 mg/dLに近い試料3で平均値は125.38mg/dL、標準偏差は1.03 mg/dLであった。特定健康診査・特定保健指導の階層化判定基準の100mg/dLに近い試料2で平均値は108.42mg/dL、標準偏差は0.80 mg/dLであった。平均値±2SDの範囲は、試料3で123.32～127.44mg/dL、試料2で106.82～110.02mg /dLとなり、測定方法、試薬、機器等による差は小さく、測定値は収束していることが伺われる結果であった。

各施設が採用している測定値の正確さに影響を与える検量用試料(キャリブレータ)の種類は、製造販売元指定の溶媒ベースが52.0％（前年50.8％）と最も多く、次いで製造販売元指定の血清ベースが26.7％（前年27.7％）、製造販売元指定以外の血清ベースが18.0％（前年17.6％）、製造販売元指定以外の溶媒ベースが2.8％（前年3.0％）、その他が0.6％（前年0.5％）であった。トレーサビリティの確認については、企業の標準品が61.2％（前年60.2％）、ReCCSの標準品が32.6％（前年31.0％）、NISTの標準品が3.1％（前年3.3％）、その他が0.3％（前年0.5％）であり、トレーサビリティの確認を実施していない施設は10施設（2.8％）であり、前年の18施設（4.9％）より減少しているが全ての施設で適切なトレーサビリティの確認を実施していただきたい。

血糖測定値の評価は、同一測定法群の極端値（平均値±3SD）棄却後の平均値による測定値評価点と解析値による解析値評価点の平均値を総合評価点としている。測定値評価点は、平均値を基準濃度とし評価規準は生理的変動を基本とした許容誤差規準を用いる方法で行っている。測定値の正確さの評価を目的とする“望ましい性能”2.2％を評価規準とし、平均値±0～2.2％をA、±2.3～4.4％をB、±4.5～6.6％をC、±6.7％～をD評価としている。自施設測定では総合評価点100点は68.9％（前年84.5％）、80点以上100点未満が20.5％（前年12.9％）、60点以上80点未満が7.9％（前年0.6％）、60点未満は2.6％（前年1.9％）であり前年と比較して総合評価点100点の割合が20ポイント近く大きく減少し、全体に成績が悪かった。また外部施設測定でも総合評価点100点は84.9％（前年91.3％）、80点以上100点未満が13.7％（前年7.7％）、60点以上80点未満が1.0％（前年0.5％）、60点未満が0.5％（前年0.5％）と昨年と比較して成績が悪かった。しかし、本年の結果は過去数年の結果と比較すると

ほぼ同じであった。今年度全体で総合評価点60点未満の5施設の前年度の結果は、3施設は100点、あとは80点、90点であったので機器のメンテナンス、試薬や標準液管理等を十分に確認していただきたい。昨年度総合評価点が60点未満であった4施設は全て100点になり大きく改善がみられた。

以上、本調査参加施設の血糖測定の技術水準は高く、概ね良好であると考えられる。

表８測定法別分類

測定法コード	測定法	自施設測定施設数	割合%	外部施設測定施設数	割合%
11	GOD比色法	1	0.7%	0	0.0%
12	GOD電極法	30	19.9%	5	2.4%
21	HK・UV法	115	76.2%	200	97.6%
31	GDH法	4	2.6%	0	0.0%
81	ドライケミストリー法	1	0.7%	0	0.0%
	合計	151	100%	205	100%

８．HDLコレステロール

HDLコレステロールは、生活習慣病健診として重要な脂質の検査項目の一つであり、測定にあたっては高い精密度・正確度が要求される。

今回の精度管理調査では、HDLコレステロール項目への全参加数は356施設で、昨年より8施設減り、過去3年間の増加傾向が減少に転じた。内訳としては、自施設での測定が151施設（42.4%）、外部施設への委託測定が205施設（57.6%）であり、昨年より外部施設への委託施設の比率が0.5%増加しており、外部委託比率の微増傾向が続いている。参加施設の測定方法は1施設のみがドライケミストリー法で、他の354施設は沈殿操作を行わない方法（いわゆる直接法）であった。

直接法の内訳は、協和メデックス（メタボリードHDL-C）が179施設（50.3%、うち外部委託101施設）と最も多く、続いて積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL）165施設（46.3%、うち外部委託102施設）、和光純薬（Lタイプワコー HDL-CM2、同ＣＭ3）10施設（2.8%、うち外部委託2施設）、デンカ生研（HDL-EX N）1施設（自施設測定のみ）、オーソ（ドライケミストリー法ビトロス）1施設（自施設測定のみ）であった。本調査におけるHDLコレステロールの評価は、直接法において試薬別平均値に差が存在することから、試薬別平均値を基準濃度として、それに個人の生理的変動を基本とした評価基準を用いてきた経緯があり、今回も同様な評価法とした。従来、同一メーカーから複数の製品が販売されていたが、1社1製品化が進み、協和メデックス（メタボリードHDL-C)と積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL エクセライザHDL)の2試薬の合計が344施設（96.6%）となっている。

今回の精度管理試料（凍結乾燥品）の測定試薬別平均値では、メーカー間差が前年と同様に認められたことから、新鮮血清以外の試料を用いた外部精度管理調査において正確度の確認の困難さは従来と変わらない。日本医師会の精度管理調査報告書でもこの点に配慮して、変動の小さい同一測定試薬群内での評価が行われている。全衛連の精度管理調査においても測定試薬別評価を行ってきており、今回も同様の評価を行った。例年通り生血清を参考試料として測定し、凍結乾燥試料と試薬別測定値の差を比較した。その結果、積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL）と協和メデックス（メタボリードHDL-C）の平均値を比較すると、凍結乾燥品3種類の平均値の差(mg/dl)は4.50、 7.68、 6.28で、生血清2種類の0.93、3.04より明らかに大きな差が認められた。特に、凍結乾燥品では一昨年より3種類とも徐々に差が拡大傾向にあるが、これが試薬か試料のどちらに起因するかは明らかではない。

試薬別の変動係数（CV）は積水メディカル（コレステストN-HDL、クオリジェントHDL）が1.22～1.48%、協和メデックス（メタボリードHDL-C）が1.33～1.49%で、両者とも良好な結果であった。参加各施設で使用している検量用試料（キャリブレーター）をみると、全施設において血清ベースキャリブレーターが使用されており、1施設以外は試薬製造販売元指定のキャリブレータであった。

また、HDLコレステロールでのトレーサビリティの確認は、企業の標準品を使用している施設が最も多く220施設（61.8%）、次いでReCCSの標準品を使用している施設が122施設（34.3%）、実施していない施設が12施設（3.4%）であった。トレーサビリティの確認を行っている施設の比率は、過去3年間では94.4%、96.4%、95.6%で、今回は96.6%であることから、現場におけるトレーサビリティの認識度は年々高くなってきていることが現われている。

今回の総合評価点で85点以上は336施設（94.4%）であり、その内訳は自施設測定が144施設（95.4%）、外部施設測定が192施設（93.7%）であった。また、60点以下が14施設（3.9%）で、その全ての報告値が各試料ともLDLコレステロールの平均値に近似していた。この外部施設測定の12施設は全て同一の外部施設に委託しており、自施設測定の1施設は12施設が利用した登録衛生検査所であった。なお、この0点の施設は、他の施設の評価に影響を与えないよう平均値や標準偏差の統計数値算出から除外して処理されている。

全体的には、85点以上が336施設（94.1%）で、外部施設の誤報告と思われる0点の施設数の影響で昨年より全体で2%ほど低下した。トレーサビリティの実施施設が年々上昇し、今年は96.6%まで上昇しているが、試料の取り扱いや測定値の報告上のトラブルはトレーサビリティの確認では発見できない要因である。年々、外部施設測定施設が増えていることも併せて考えると、分析前後の管理も含めたクオリティマネジメントが重要と思われる。特に、今回の誤報告を疑う事例では項目間チェックで検知できる可能性が高いことから、外部委託している施設においても届いた報告値を自施設のコンピュータに取り込んだ際に自動的にチェックを行うシステム機能が望まれる。

９．LDLコレステロール

LDLコレスエロールは、特定健診・特定保健指導に重要な役割を担う項目であり、その精確さの管理は非常に重要である。本精度管理調査では、第17回の調査から評価に組み入れられ、今回で9年目となる。

今回の参加施設数は356施設で、昨年より8施設減少している。その内訳は自施設での測定が151施設（42.4％）で昨年より5施設減少し、外部施設への委託測定が205施設（57.6％）で昨年より3施設減少している。参加施設の測定方法は1施設がドライケミストリー法で、他の355施設は全て直接法であった。

直接法の内訳は、 協和メデックス（メタボリード LDL-C）が179施設（50.3％、うち外部委託101施設）で最も多く、続いて積水メディカル（コレステストN-LDL、クオリジェントLDL）163施設（45.8％、うち外部委託102施設）、続いて和光純薬（LタイプワコーLDL-C M）11施設（3.1％、外部委託2施設）、デンカ生研（LDL-EX N）1施設（自施設のみ）、デンカ生研（デュアルCHO T&L）1施設（自施設のみ）となっている。

試薬間差を確認するため5施設以上で使用している試薬について測定値の平均値で比較すると、例年と同様に和光純薬（LタイプワコーLDL-CM）＞積水メディカル（コレステストN-LDL、クオリジェントLDL）＞協和メデックス（メタボリードLDL-C）の傾向を示した。平均値の最大と最少の差(mg/dl)は試料3種類で（11.2、16.0、13.7）となり、従来の差と比較して若干大きい数値であった。同様に同時に配布測定した生血清試料2種類の平均値の差（mg/dl）は（2.7、2.3）であり、明らかに凍結乾燥試料より小さかった。

試薬別測定値の標準偏差とＣＶ（％）は前回同様に良好であった。検量用試料（キャリブレーター）は、1施設が試薬製造販売元指定以外のものを用いているが、これを含めて全てが血清ベースキャリブレーターの使用であった。今回よりトレーサビリティの実施についての記入を追加したが、その集計では実施施設が346施設（97.2％）で、その内訳は企業の標準品の使用が223施設、ReCCSの標準品121施設、NISTの標準品2施設であった。

今回の結果で、総合評価点85点以上は339施設（95.2％）で、前回より4.3％低下した。その内訳は、自施設測定が146施設（96.7％）、外部施設測定が192施設（93.7％）となり、外部測定施設で比率の低下が大きかった。この原因としては、HDLコレステロールの項に記載したように測定値の取り違いが強く疑われ、HDLコレステロールの平均値に近似する値の報告が14施設（3.9％）あり、その全てが0点であったことに起因する。さらに、自施設測定で70点以上85点未満が3施設（0.8％）あった。

平成20年から開始された厚生労働省の特定健診・特定保健指導では、一律の基準で保健指導対象者の選定・階層化を行うため、測定値の共有化が必須である。この点を十分認識して、試薬間差のないLDLコレステロール測定値を目指す必要がある。特に、

参加施設数が少ないため評価対象外となっている施設は全体の測定値から自己評価を行って頂きたい。さらに、HDLコレステロールの項に記載したようにクオリティマネジメントを重視して総合的な精度管理に努める必要がある。

１０．HbA1c

HbA1c測定の参加施設数は355施設（前年362施設）であり、内訳は自施設測定が149施設（前年155施設）、外部施設測定が206施設（前回207施設）となり、前年とほぼ同様であった。全施設では免疫学的方法が41.1％（前回41.7％）、酵素法が31.5％（前回30.7％）、HPLC法が27.3％（前年27.6％）であった。自施設、外部施設別にみると、自施設ではHPLC法が57.7％（前年58.1％）、免疫学的方法が24.8％（前年26.5％）、酵素法が17.4％（前年15.5％）であった。外部施設では免疫学的方法が52.9％（前年53.1％）、酵素法が41.7％（前年42.0％）、HPLC法が5.3％（前年4.8％）であり、自施設、外部施設において前年とほぼ同じであった。

測定法コード02-0401と02-0403（免疫学的方法協和メデックス汎用自動分析装置凍乾品、液状品）を同一群として免疫学的協和（汎用）とし、02-0402と02-0404（免疫学的方法協和メデックスDM-JACKシリーズ凍乾品、液状品）を同一群として免疫学的協和（DM）として評価した。1試料につき測定施設数が5未満の測定法（または測定試薬）については計算値の統計学的意義が乏しいことから「評価せず」となる。「評価せず」を除き、極端値（平均値±3SD）棄却後の測定方法別平均値を表9に示した。

試料1、2、3は凍結乾燥品であり、試料4、5は生血液試料である。測定法の違いによるHbA1c平均値の分布は、試料1で5.37~5.70％、試料2で6.38~6.84％、試料3は7.39~7.99％、試料4で5.24～5.38％、試料5で5.92～6.10％となり、最大値と最小値の差は試料1で0.33％、試料2で0.46％、試料3で0.60％、試料4で0.14％、試料5で0.18％であった。前年の値は試料1で0.33％、試料2で0.45％、試料3で0.60％、試料4で0.10％、試料5で0.17％であったのと比較するとほぼ同じ値であった。生血液試料である試料4、5は測定方法間差が少なく、凍結乾燥品である試料1、2、3の測定方法間差が大きいことから、凍結乾燥品中の安定化剤が測定方法によっては反応に影響することが要因の一つであるのではないかと考えられる。

測定方法別にみると、試料1、2、3ともHPLC法アークレイ、酵素法アークレイが低値傾向、免疫学的協和（汎用）が高値傾向であったことは前年と同様であった。各測定法の平均値評価規準は試料1が0.14～0.15％、試料2が0.17～0.18％、試料3が0.20～0.22％であり、同一測定法内におけるHbA1c値は収束していることは前年と同様であった。

標準液（キャリブレータ）及び検量方法の種類は、1施設で製造販売元指定の標準液の表示値を変更して使用していたが、総合評価点は100点であった。その他の施設では、全て製造販売元指定の標準液の表示値をそのまま使用していた。

HbA1cの評価規準は、第16回調査から個体の生理的変動を基本とした評価規準で評価し、日常の性能（CV%）が計算されたかたより%のいずれの性能規準をも超えることから、許容総誤差%の基本的な評価規準である“望ましい性能”を評価規準としている。各測定法の平均値±0～2.7%をA、±2.8～5.4%をB、±5.5～8.1%をC、±8.2%～をD評価としている。HbA1cは解析値評価を行わず、測定値評価のみで総合点評価をしている。凍結乾燥品の問題点はあるが、全施設において総合評価点が100点の施設は94.3%（前年95.8%）であり参加施設のHbA1cの測定技術水準は高いと考えられる。しかし、60点未満は自施設測定施設で2施設みられた。また総合評価点が60点以上であっても評価規準と比較してかたより、ばらつきのみられた施設は、分析装置のメンテナンス状況、試薬・校正物質・精度管理物質等の内部精度管理状況を確認し、さらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。前年度総合評価点が60点未満であった6施設は、今回全ての施設で総合評価点100点となり良好な改善がみられた。

表 9 測定方法別平均値

方法	試薬メーカー	試料 1	試料 2	試料 3	試料 4	試料 5
HPLC 法	アークレイ	5.51	6.43	7.44	5.38	6.10
	東ソー	5.55	6.57	7.59	5.36	6.08
免疫学方法	協和（汎用）	5.58	6.84	7.99	5.29	5.98
	協和（DM）	5.56	6.77	7.89	5.31	5.92
	富士レビオ	5.50	6.68	7.78	5.24	5.94
酵素法	協和メデックス	5.70	6.67	7.70	5.31	6.00
	積水メディカル	5.53	6.49	7.56	5.28	5.98
	アークレイ	5.37	6.38	7.39	5.33	5.99

【血液学検査】

はじめに

第25回血液学検査の精度管理調査は、ヘモグロビン量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、平均赤血球容積（MCV）について実施した。

参加施設数は、ヘモグロビン量、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、MCVは353施設（昨年361施設）であり、昨年よりも8施設減少した。内訳は、自施設測定151施設（42.8%）で、昨年よりも6施設減少し、外部施設測定は202施設（57.2%）で昨年よりも2施設減少した。受託施設数は59であった。

なお、加工血液によるMCV、生血液試料によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、MCVの調査は参考調査（仮評価）とした。

１．血液学検査評価方法

血液学検査の評価方法は、平成12年度（第9回）調査から従来のSD評価を測定値にもとづく％評価（渡辺　清明　他、臨床病理42:764～766,1994）に変更して評価を行い、第15回からは、個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更した。この評価規準の概要および従来の評価基準との比較は第16回報告書の表2-2、表2-3に示した。なお、今回送付した試料に関する具体的な平均値および平均値評価規準は本報告書の調査項目の測定方法別平均値および評価基準一覧に示した（表17）。

２．測定試料

測定試料として、昨年と同様に血液精度管理用に調製された試料3種を用意し、それらのうち2試料をランダムに組み合わせて各施設に送付した。報告された測定結果は、測定法別、測定機種別、自施設測定、外部施設測定別に集計した。

３．調査項目

(1)　ヘモグロビン量

各施設からの自己申告の結果から、ヘモグロビン量の測定方法は、①シアンメトヘモグロビン法 9施設（昨年16施設）、②非シアン界面活性剤法 338施設（昨年340施設)、③その他6施設（昨年5施設)であった。なお、③その他の6施設の測定方法を確認したところ、すべてノンシアン系（測定機器：JAB517が2施設、JAB514、JAJ012、JAJ702、JAR409、）であった。

過去の調査結果から、ヘモグロビン量の平均値を測定法別に比較したところ、非シアン界面活性剤法と、シアンメトヘモグロビン法との間に統計学に有意な差は認められなかった。さらに、ヘモグロビン測定値の変動係数は、非シアン界面活性剤法、シアンメトヘモグロビン法ともに1～2％と、良好だったことから、臨床検査専門委員会で検討した結果、第12回からは測定法別ではなく全施設をまとめて評価することにな

った。その結果、評価点ランク別の構成比をみると、全施設（345施設）において90点以上が97.7％(345/353)(前回：97.2％(351/361))、80点以上が97.7％(345/353)（前回：98.0％(354/361))であった。また、60点未満の低い評価を受けた施設が0.8％（3/353）(前回：0.3％(1/359))であった。

(2) 赤血球数

赤血球数測定法の原理は、電気抵抗方式と光散乱方式とに大別される。赤血球数は、過去の調査結果で電気抵抗方式においても機種間差が認められたので機種別に評価している。参加全施設数は353だったが、機種別に評価するためユーザー数が少ない（n≦5）機種は、評価せずとした。したがって評価対象施設数は331施設であった。赤血球数の機種別の評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が99.7％（330/331）（前回：100％(340/340))であった。60点未満の低い評価を受けた施設は前回と同様に皆無であった。

(3) 白血球数

施設数n≦5の機種を除く評価対象は331施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が前回と同様に100％（331/331）（前回：100％(340/340))であった。60点未満の低い評価を受けた施設は前回と同様に皆無であった。

(4) ヘマトクリット値

施設数n≦5の機種を除く評価対象は331施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が前回と同様に100％（331/331）（前回：100％(340/340))であった。60点未満の低い評価を受けた施設は前回と同様に皆無であった。

第20回から、ヘマトクリット値の評価基準は、以前に採用されていた臨床的許容限界に基づく評価基準との整合性、およびヘマトクリット値は自動血球分析装置の測定原理上、赤血球数の影響も受けることから、評価基準を「生理的変動（総誤差%）最適」から「生理的変動（総誤差%）望ましい」に変更した。

(5) 血小板数

施設数n≦5の機種を除く評価対象は331施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が99.4％（329/331）(前回：98.5％(335/340))、60点以上が99.4％（329/331）（前回：99.7％（339/340））であった。60点未満の低い評価を受けた施設は0.6％（2/331）（前回：0.3％（1/340））であった。

(6) MCV

施設数n≦5の機種を除く評価対象は331施設であった。機種別の分類は赤血球と同じで、評価点ランク別構成比をみると、全施設測定で80点以上が98.2％（325/331）（前回：99.1％（337/340））、60点以上が99.4％（329/331）（前回：99.7％（339/340））であった。60点未満の低い評価を受けた施設は0.6％（2/331）（前回：0.3％（1/340））であった。

まとめ

赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、MCVは、調査試料に起因する機種間差が存在し、加工血液を用いている本調査の成績評価は機種別に行っている。機種別施設数がｎ≦5の場合は評価ができないため、全衛連では測定原理の影響を受けない生血液を用いた参考調査を実施して導入を検討してきた。しかし、全衛連参加施設における検体検査の外部委託率は高く、これにともなう搬送および経時的な測定値への影響を無視できない調査項目（白血球数）があるため、本調査用試料を変更するまでには至っていない。ただし、新鮮血液試料は、HbA1cとの共用、異常値が報告された際の検証などにおける有用性は高く、参考調査試料として採用している。第9回からは白血球数・ヘマトクリット値・血小板数の評価が加わった。

血球計数項目の配布試料については、試料到着後、全衛連に何らかの連絡があった施設には個別に対応した。加工血調査試料（試料16,17）において強溶血を認めたとの報告（2施設）があり、不参加となった。これら以外に試料16,17び中等度溶血を認めたとの報告（2施設）があったが、血球計数全項目の評価点は100点であった。加工血調査試料において、血小板凝集、フィブリン析出などに関する自動血球分析装置のフラッギングメッセージ出現に関する記載はなかった。

参加施設で確認される溶血の原因には、試料運送中の冷凍・振動などが疑われる。試料到着時にミクロヘマトクリット管を用いて遠心を行ない、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が必要である。強溶血を認めた場合は、コメント欄に記入するだけでなく、試料再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。

【参考調査（新鮮血液試料についての調査）】

本調査では血球計数項目の精度管理本調査試料に加工血液を使用している。加工血液は各血球を種々の程度で固定、また安定化剤の添加などを行っているため、新鮮抗凝固血液に比べて保存安定性は優れている。しかし血球固定時の細胞変性や添加薬剤などの影響により、調査試料に起因する機種間差が生じることがある。そこで第15回調査から新鮮抗凝固血液（生血液）を用いて、参考調査を実施している。

本年度も昨年と同様に、2種類の新鮮血液試料を準備して各施設に配布した。調査用

試料は輸血用保存液CPD（citrate phosphate dextrose）入り採血バッグに静脈血を採取し、さらにEDTA-2Kを終濃度1.5mg/mlになるように添加して調製した。第16回、第17回の参考調査結果では、赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数は、採血3日後まで白血球数が低値化傾向を示すものの平均値±3SDの範囲内に分布した。測定時刻は発送2日後の定時間内に指定した。

生血液試料に関する報告書へのコメント記入内容は、フィブリン析出（8施設）、凝集（2施設）、フィブリン析出と血小板凝集（2施設）、フィブリン析出と細胞崩壊（2施設）、血小板凝集と細胞崩壊（2施設）、細胞崩壊（1施設）であった。また、全衛連への連絡内容は、強溶血（4施設うち2施設は不参加となった）、強溶血と凝固（1施設）、凝固（1施設）、送付漏れ（1施設）、試料不足（3施設）であった。

強溶血を認めた1施設からは、送付した試料の受け取り時には溶血を認めず、その後、外注先から溶血の報告を受けたとの連絡があった。この原因としては、施設から外注先への搬送時に強溶血が生じた可能性があるため、原因の究明と対策を検討する必要がある。送付漏れ、試料の不足については、対策を講じなければならない。

各施設における試料受領日は、発送（採血）1日後までに到着したのは259施設（73.0%）、2日後は89施設（25.1%）、3日後は3施設（0.8%）、受領日未記入等が4施設（1.1%）であった。また、測定日は、2日後amまでに測定したのは223施設（62.8%）、pm測定は121施設（34.1%）、3日後am測定は9施設（2.5%）、測定日未記入等が2施設（0.6%）であった。

2日後pmまでに測定したのは344施設（96.9%）、3日後に測定したのは9施設（2.5%）であったが、試料は2日後までにこれら全施設に到着していた。新鮮血試料による調査方法については、搬送時間、測定時刻などと集計値の関連性などについて慎重に検討し、本調査への導入の可否を検討する必要がある。

【尿検査】

はじめに

第25回の尿精度管理調査の参加施設数は355施設であり、前年より8施設減少した。今回、尿検査を外部委託した施設は23施設あり、17の登録衛生検査所が受託していた。

表10は本調査開始以来の尿検査の外部委託状況をまとめたものである。

表10 尿検査の「外部委託検査」

回数	年　度	対象施設数	外部委託施設数(%)		受託検査機関数
1	平成4年	213	37	17.4	—
2	平成5年	218	48	22.0	—
3	平成6年	257	不明	—	—
4	平成7年	273	40	14.7	—
5	平成8年	283	20	7.1	16
6	平成9年	296	14	4.7	12
7	平成10年	296	16	5.4	14
8	平成11年	316	14	4.4	14
9	平成12年	318	19	6.0	14
10	平成13年	325	8	2.5	8
11	平成14年	337	7	2.1	4
12	平成15年	335	13	3.9	10
13	平成16年	333	0	0.0	0
14	平成17年	337	0	0.0	0
15	平成18年	334	0	0.0	0
16	平成19年	361	0	0.0	0
17	平成20年	358	0	0.0	0
18	平成21年	355	0	0.0	0
19	平成22年	361	0	0.0	0
20	平成23年	359	16	4.5	14
21	平成24年	365	22	6.0	17
22	平成25年	357	20	5.6	14
23	平成26年	359	24	6.7	17
24	平成27年	363	22	6.1	15
25	平成28年	355	23	6.5	17

調査開始後しばらくは、尿検査を外部委託している施設が相当数あったが、尿検査は経時変化が多いので望ましくないと声高に述べてきたところ、平成16年（13回調査）から平成22年（19回調査）までは、ゼロ回答が続いた。当時、この調査結果が本当に外部委託検査ゼロならばよいが・・・と述べてきたが、平成23年（20回調査）から再び外部委託検査の回答が見られるようになった。一時期ゼロ報告されたことは、一体何だったのだろうか。

ドック健診という比較的数少ない検体数と、クリニックの近隣に検査所があり、検体収集の搬送等が毎日8便あり、2時間以内に全ての検査データが判定医に届くという惜しみない労力と費用をかけた施設を訪問したことがある。しかし、これは例外中の例外なのかもしれない。通常の一般健診や特殊健診を巡回健診として実施している場合、このような外部委託の方法は先ず不可能であろう。それにも関わらず尿検査の外部委託は、今回23施設（受託検査機関17）に増えていた。

１．評価方法

尿検査の評価は、例年のごとく各試料について下記のように評点している。

基準値と一致したものを　［A］：5点
1 ランク異なったものを　［B］：4点
2 ランク以上離れたものを［Z］：0点

各項目とも配布した5試料が全てA評価の場合、合計25点になる。得られた点数を機械的に4倍し100点満点に換算したのが評価点である。

２．結果及び考察

(1) 尿検査の方法

検査項目別・測定法別の結果を 表11に示す。

尿糖・蛋白・潜血検査とも、全ての施設で試験紙法を採用。試験紙法は、その色調変化を肉眼で判定する「目視判定法」と、専用機器で比色判定する「機器判定法」がある。

今回も何故か検査項目によって目視判定法（以下、目視判定）と機器判定法（以下、機器判定）が異なっている施設があった。その結果、目視判定は尿糖検査163施設（45.9%）、尿蛋白・潜血検査が162施設(45.6%)であり、機器判定が尿糖検査192施設（54.1%）、尿蛋白・潜血検査が193施設（54.4%）であった。

全体的には、機器判定法が漸増している。

表11 項目別･測定法別尿検査の方法

	尿糖検査		尿蛋白検査		尿潜血検査	
試験紙･目視判定法	163	45.9%	162	45.6%	162	45.6%
〃 ･機器判定法	192	54.1%	193	54.4%	193	54.4%
合 計	355	100.0%	355	100.0%	355	100.0%

(2) 項目別・測定法別検査結果

表12は、検査項目別・測定法別検査結果である。

「90点以上」の良好な施設は、尿糖検査で目視判定が75.5%、機器判定では4.8%、同様に尿蛋白検査では94.4%・100.0%、尿潜血検査では87.0%・91.2%であり、何れの項目でも機器判定の方が良好な結果を示した。

一方、「60点未満」の低得点施設は、尿糖検査で2施設（目視判定：2、機器判

定：0）、尿蛋白検査は1施設（目視判定：1、機器判定：0）、尿潜血検査では2施設（目視判定：0、機器判定：2）であった。

目視判定の場合、検査台上の照度が800～1000ＬＵＸ程度確保されていないと誤判定する。直射日光が当たる明るすぎる検査台では陽性率が減少し、逆に暗すぎると陽性率が増加する。廊下やトイレの片隅などは200～300ＬＵＸ程度であり、通常の事務室でも300～400ＬＵＸ程度の照度しか得られないことが多い。巡回健診では、不特定な会場で目視判定する場合が多いので、補助照明や標準試料の使用等、適正な検査条件を選択しなくてはならない。

表12　項目別・測定法別検査結果（得点別施設数及びその比率）

項目	測　定　法	90点以上	80～89点	70～79点	60～69点	60点未満	合計
尿糖	試験紙・目視判定法	123	37	1	0	2	163
		75.5%	22.7%	0.6%	0.0%	1.2%	100.0%
	〃　・機器判定法	182	10	0	0	0	192
		94.8%	5.2%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	合　計	305	47	1	0	2	355
		85.9%	13.2%	0.3%	0.0%	0.6%	100.0%
尿蛋白	試験紙・目視判定法	153	6	2	0	1	162
		94.4%	3.7%	1.2%	0.0%	0.6%	100.0%
	〃　・機器判定法	193	0	0	0	0	193
		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	合　計	346	6	2	0	1	355
		97.5%	1.7%	0.6%	0.0%	0.3%	100.0%
尿潜血	試験紙・目視判定法	141	20	1	0	0	162
		87.0%	12.3%	0.6%	0.0%	0.0%	100.0%
	〃　・機器判定法	176	13	2	0	2	193
		91.2%	6.7%	1.0%	0.0%	1.0%	100.0%
	合　計	317	33	3	0	2	355
		89.3%	9.3%	0.8%	0.0%	0.6%	100.0%

（3）メーカー別にみた尿半定量値

日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の「尿試験紙検討委員会」が中心となって、学会・関係団体・メーカーで試験紙の判定表示値の統一化を進めてきた合意点は、下記の通りである。

① 尿蛋白・尿ブドウ糖試験部分は半定量値（mg/dL）で表示する
定性値（－，±，１＋…)を付記するか否かは各メーカーの判断に委ねる。ただし、付記する場合、蛋白は30 mg/dL、ブドウ糖は100 mg/dLを（１＋）とする。

② 尿潜血試験部分は原則として比色表に定性値（－，±，１＋…)のみを表示し、添付文書に定性値とヘモグロビン濃度（mg/dL）、または赤血球数（個/μL）の関係を記載する。
（１＋）に相当するヘモグロビン濃度は、0.06 mg/dLとし、赤血球数に換算すると約20個/μLとなる。

これを受けて各メーカーの試験紙は、表13に示したように（１＋）レベルでの判定基準が揃えられている。健診の場合、多くは（１＋）以上を「要精検・要２次検査」と判定するので、試験紙の相違によるスクリーニング結果に判定誤差が生じることはないと思われる。

本サーベィでは、従来から（－）、（±）、（１＋）、（２＋）、（３＋） 等の定性判定によらず、メーカーが示したそれぞれの半定量値の結果から、尿糖の場合６段階、尿蛋白・尿潜血の場合７段階に再区分した数値で回答を求めている。その結果、メーカー毎の定性判定基準の相違によって評価への影響が出ていないか慎重に検討してきたが特に問題点が生じたことはなかった。少なくとも、使用している試験紙の相違で検査結果が不利になる事例は発生していないとみてよい。評点結果が悪かったのは、「判定の不確かさ」、或いは「検体のとり違い」・「転記ミス」等に起因していることが多い。

表13 尿試験紙メーカー別半定量値

	製造元（販売元）名	試験紙名	判定時間	±	1＋	2＋	3＋	4＋	5＋
尿糖	栄研化学（同）	ウロペーパーⅢ栄研	60秒	50	100	250	500	2000	—
	ロッシュ・Ｄ＊＊	BMテスト　３－Ⅲ	30～60秒	50	100	300	1000	—	—
	和光純薬（同＊）	プレテスト	30秒	—	100	250	500	2000	—
	アークレイファクトリー(三和化学＊)	ファグノス・Uテスト	60秒	50	100	200	500	1000	—
	テルモ（同）	ウリエース	30秒	50	100	500	2000	—	—
	東洋濾紙(協和メディックス)	ウロピース	30秒	50	100	250	500	1000	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	30秒	50	100	250	500	1000	—
	シーメンス・ＨＣＤ＊＊	エームス尿検査試験紙	30秒	—	100	250	500	1000	2000
尿蛋白	栄研化学（同）	ウロペーパーⅢ栄研	直後	15	30	100	300	1000	—
	ロッシュ・Ｄ＊＊	BMテスト　３－Ⅲ	30～60秒	—	30	100	500	—	—
	和光純薬（同＊）	プレテスト	30秒	10～20	30	100	300	1000	—
	アークレイファクトリー(三和化学＊)	ファグノス・Uテスト	60秒	15	30	100	300	1000	
	テルモ（同）	ウリエース	10秒	15	30	100	250	1000	—
	東洋濾紙(協和メディックス)	ウロピース	30秒	15	30	100	300	1000	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	30秒	15	30	100	300	1000	—
	シーメンス・ＨＣＤ＊＊	エームス尿検査試験紙	0～60秒	15	30	100	300	1000	—
尿潜血	栄研化学（同）	ウロペーパーⅢ栄研	30秒	0.03	0.06	0.15	0.75	—	—
	ロッシュ・Ｄ＊＊	BMテスト　３－Ⅲ	30～60秒	(10)	(20)	(50)	(250)	—	—
	和光純薬（同＊）	プレテスト	30～60秒	—	0.06	0.15	0.75	—	—
	アークレイファクトリー((三和化学＊)	ファグノス・Uテスト	60秒	—	0.06	0.2	1	—	—
	テルモ（同）	ウリエース	20秒	—	0.06	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙（協和メディックス）	ウロピース	30秒	0.03	0.06	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙(三和化学)	U-テストビジュアル	45秒	0.03	0.06	0.2	1	—	—
	シーメンス・ＨＣＤ＊＊	エームス尿検査試験紙	60秒	0.03	0.06	0.135	0.405	—	—

（注）＊:発売元　　＊＊:販売元　　（ ）内の単位:赤血球　個／μＬ
D:ダイアグノスティクスの略　　HCD:ヘルスケアダイアグノスティックスの略　　（2009．4　調査）

（4）項目別・試験紙メーカー別・測定法別評点結果

各項目について試験紙メーカー別・測定方法別にみた評点結果を、85点以上、70～84点、60～69点、60点未満の４群に分けて集計した結果が、表14である。

尿糖検査の「60点未満」の施設は目視判定で２施設（テルモ：１、東洋濾紙（協和

M）：１）に対して、機器判定はゼロ。尿蛋白検査では、目視判定は１施設(東洋濾紙（協和M）：１)、機器判定はゼロ。尿潜血検査では、目視判定はゼロであったが、機器判定で２施設（シーメンス・HCD：２）に認められた。

例年とは若干異なる結果であった。

表14 項目別･試験紙メーカー別･判定法別評価結果

	試験紙メーカー	試験紙・目視判定法					試験紙・機器判定法				
		実施数	85点以上	70～84	60～69	60点未満	実施数	85点以上	70～84	60～69	60点未満
尿糖	02 栄研化学	75	68	7	0	0	133	131	2	0	0
	07 協和メデックス	7	6	1	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	-	-	-	-	-	4	420	0	0	0
	22 ロシュ･D	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・ＨＣＤ	27	25	2	0	0	23	20	0	0	0
	32 和光純薬	16	15	1	0	0	3	3	0	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	32	30	2	0	0
	60 テルモ	5	3	1	0	1	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙（協和M）	32	31	0	0	1	-	-	-	-	-
	合　計　（363施設）	163	149	12	0	2	192	188	4	0	0
			91.4%	7.4%	0.0%	1.2%		97.9%	2.1%	0.0%	0.0%
尿蛋白	02 栄研化学	75	73	2	0	0	133	133	0	0	0
	07 協和メデックス	7	7	0	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0
	22 ロシュ･D	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・ＨＣＤ	26	26	0	0	0	21	21	0	0	0
	32 和光純薬	16	16	0	0	0	3	3	0	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	32	32	0	0	0
	60 テルモ	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙（協和M）	32	31	0	0	1	-	-	-	-	-
	合　計（363施設）	162	159	2	0	1	193	193	0	0	0
			98.1%	1.2%	0.0%	0.6%		100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
尿潜血	02 栄研化学	73	73	0	0	0	133	133	0	0	0
	07 協和メデックス	7	7	0	0	0	-	-	-	-	-
	09 シスメックス	-	-	-	-	-	4	4	0	0	0
	22 ロシュ･D	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンス・ＨＣＤ	28	28	0	0	0	21	18	1	0	2
	32 和光純薬	16	15	1	0	0	3	2	1	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	32	32	0	0	0
	60 テルモ	5	5	0	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙（協和M）	31	31	0	0	0	-	-	-	-	-
	62 東洋濾紙（三和化）	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	合　計　（363施設）	162	161	1	0	0	193	189	2	0	2
			99.4%	0.6%	0.0%	0.0%		97.9%	1.0%	0.0%	1.0%

［注］ D：ダイアグノスティックスの略　　ＨＣＤ：ヘルスケアダイアグノスティックスの略　　M：メディックスの略

（5）項目別・評価点ランク別にみた経年比（20回～24回）

表15は、第20回以降25回までの評価点結果を、5段階ランク別にその推移を全施設、自施設測定、外部施設測定毎に見たものである。経年変化（回数毎）について、全施設・自施設測定・外部施設測定ともに若干の変動はあるものの大きな変化は見られなかった。

今回も外部施設測定の方が良好な結果であった。

表15 項目別・評価点ランク別 施設数(全施設・自施設検査・外部委託検査)

	項目	得点	90点以上		80～89点		70～79点		60～69点		60点未満		合計	
		回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
全施設	尿糖	25回	305	85.9%	47	13.2%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	355	100.0%
		24回	294	81.8%	61	16.8%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.1%	363	100.0%
		23回	300	83.6%	48	13.4%	4	1.1%	2	0.6%	5	1.4%	359	100.0%
		22回	284	79.6%	57	16.0%	7	2.0%	2	0.6%	7	2.0%	357	100.0%
		21回	283	77.5%	65	17.8%	8	2.2%	5	1.4%	4	1.1%	365	100.0%
		20回	301	83.8%	52	14.5%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.1%	359	100.0%
	尿蛋白	25回	346	97.5%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	355	100.0%
		24回	353	97.2%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	363	100.0%
		23回	345	96.1%	12	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
		22回	342	95.8%	8	1.7%	5	1.4%	1	0.3%	3	0.8%	357	100.0%
		21回	348	95.3%	13	3.6%	2	0.5%	2	0.5%	0	0.0%	365	100.0%
		20回	348	96.9%	9	2.5%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	359	100.0%
	尿潜血	25回	317	89.3%	33	9.3%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	355	100.0%
		24回	328	90.4%	34	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	363	100.0%
		23回	324	90.3%	28	7.8%	5	1.4%	0	0.0%	2	0.6%	359	100.0%
		22回	330	92.4%	16	4.5%	6	1.7%	2	0.6%	3	0.8%	357	100.0%
		21回	327	89.6%	28	7.7%	7	1.9%	0	0.0%	3	0.8%	365	100.0%
		20回	347	96.9%	11	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	358	100.0%
自施設検査	尿糖	25回	282	84.9%	47	14.2%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	332	100.0%
		24回	273	80.1%	60	17.6%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.2%	341	100.0%
		23回	277	82.7%	47	14.0%	4	1.2%	2	0.6%	5	1.5%	335	100.0%
		22回	266	78.9%	56	16.6%	7	2.1%	2	0.6%	6	1.8%	337	100.0%
		21回	262	76.4%	64	18.7%	8	2.3%	5	1.5%	4	1.2%	343	100.0%
		20回	285	83.1%	52	15.2%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.2%	343	100.0%
	尿蛋白	25回	323	97.3%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	332	100.0%
		24回	331	97.1%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	341	100.0%
		23回	321	95.8%	12	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
		22回	323	95.8%	6	1.8%	5	1.5%	1	0.3%	2	0.6%	337	100.0%
		21回	326	95.0%	13	3.8%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	343	100.0%
		20回	332	96.8%	9	2.6%	1	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	343	100.0%
	尿潜血	25回	296	89.2%	31	9.3%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	332	100.0%
		24回	306	89.7%	34	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	341	100.0%
		23回	300	89.6%	28	8.4%	5	1.5%	0	0.0%	2	0.6%	335	100.0%
		22回	311	92.3%	16	4.7%	6	1.8%	1	0.3%	3	0.9%	337	100.0%
		21回	307	89.5%	26	7.6%	7	2.0%	0	0.0%	3	0.9%	343	100.0%
		20回	332	97.1%	10	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	342	100.0%
外部委託検査	尿糖	25回	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
		24回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	18	90.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
		21回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
	尿蛋白	25回	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
		24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	20	100.0%
		21回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%
	尿潜血	25回	21	91.3%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%
		24回	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		23回	24	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%
		22回	19	95.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	20	100.0%
		21回	20	90.9%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%
		20回	15	93.8%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%

（6）ゼロ評価のある参加施設

表16は、配布した5試料中にゼロ評価［Ｚ］が、1以上あった参加施設の一覧である。

尿糖検査での「Ｚ評価」は、20年度11施設、21年度14施設、22年度13施設、23年度6施設、24年度17施設、25年度16施設、26度10施設、27年度は8施設、今回は4施設と減少した。

しかし、28019施設の16点、13008施設の20点は、極端な低得点であった。特に網がけした28019施設は、後述する尿蛋白検査でも低得点（36点）であった。ゴシック体で表記した13008施設は、23・24回に引き続いて3年連続して「Ｚ評価」が認められ、評価点も前年の36点より低い20点であった。

尿蛋白検査での「Ｚ評価」は、20年度26施設、21年度7施設、22年度8施設、23年度3施設、24年度5施設、25年度9施設、26年度3施設、27年度5施設、今回は3施設であったが、既述したように網がけした28019施設は、「Ｚ評価」が3あり36点であった。

尿潜血検査での「Ｚ評価」は、20年度10施設、21年度９施設、22年度７施設、23年度1施設、24年度16施設、25年度11施設、26年度６施設、今年27年度2施設に減少したが今年度は5施設に認められた。しかし、「Ｚ評価」が2あった40030・43007施設は56点に留まった。

今年は、2項目以上に「Ｚ評価」が認められたのは網がけした28019施設のみであったが、尿糖16点・尿蛋白36点は、健康診断のスクリーニング検査として許される限界を大きく下回った低得点といわざるを得ない。

表16　ゼロ点評価のある施設一覧（尿糖・尿蛋白・尿潜血）

項目	施設ｺｰﾄﾞ	測定方法	機器ｺｰﾄﾞ	試験紙ﾒｰｶｰ	評価点	評価内容				
尿糖	13008	試験紙・目視判定法	AAZ901	テルモ	20.0	A	Z	Z	Z	Z
	13080	試験紙・目視判定法	AAZ901	〃	80.0	A	A	A	Z	A
	28019	〃	AAZ901	東洋ろ紙（協和M）	16.0	Z	Z	Z	B	Z
	40029	〃	〃	栄研化学	76.0	A	A	Z	B	A
尿蛋白	13014	〃	〃	栄研化学	72.0	B	A	Z	B	A
	15010	〃	〃	〃	72.0	B	A	Z	B	A
	28019	〃	〃	東洋ろ紙（協和M）	36.0	Z	Z	B	A	Z
尿潜血	02004	試験紙・機器判定法	LBJ806	シーメンスHCD	76.0	A	A	B	A	Z
	13056	試験紙・目視判定法	AAZ901	和光純薬	72.0	A	A	B	Z	B
	22004	試験紙・機器判定法	LBD101	〃	72.0	A	A	Z	B	B
	40030	〃	LBJ805	シーメンスHCD	56.0	A	A	B	Z	Z
	43007	〃	〃	〃	56.0	A	A	Z	Z	B

【注】　13008施設の尿糖検査結果は、23・24回に引き続いて３回連続して「Ｚ評価」があった
網掛けした28019施設は、２項目にゼロ点評価「Ｚ評価」があった施設

3. まとめ

毎回述べていることではあるが、尿検査は、臨床化学検査や血液検査等と比較して、簡単に取り扱われる傾向は否定できない。そのため、初心者がまず取組む検査というイメージが強い。偽陰性に判定されれば「要再検査」「要２次健診」・・としてフォローアップされることは無く、糖尿・腎疾患等の初期診断に有効であるとは言い難い。

汎用されている「尿検査用試験紙」は、容器の開封直後から劣化が始まる。試験紙の適切な保管・管理が大切である。まして試薬部分に触れることは絶対にあってはならない。試験紙を尿中に浸漬後判定（dip and read）する基本、項目ごとに異なる判定時間の厳守、照度等の検査環境等も大切である。受診者自身に放尿中の尿を試験紙にかけてもらいこれを検査判定するとか、少ない尿をガーゼや綿棒等で試験紙に擦りつけるような検査をしてはいけない。

目視判定する場合は、検査台上の照度を800～1,000LX確保しなければ、誤判定する。検体を検査室に持ち帰るときや、やむを得ず外部委託先に送付するときの温度管理は極めて重要である。尿は、時間経過とともに外気温等の影響を受けて細菌が繁殖し変性することを忘れてはならない。

今回実施したような「精度管理調査用検体」は、こうした劣悪な条件下で検査することは無いであろう。しかも、習熟したベテラン技師が検査することも多い・・・。それにも関わらず60点未満、70点未満を取得することは、日常健康診断の検査においてをやである。検査技術のみならず、結果の記載・転記・入力等も大切に手順通りに行わなければ検査結果報告を誤ることもある。

適正な検査を行うべく「標準作業書」の使用は必須である。その「標準作業書」は、最新の条件で更新されたものでなくてはならないし、検査担当者のみならず、関係者全員で共有されていることが不可欠である。

尿検査は、基本的な検査である。基本的な検査だけに大切にしたい検査である。

第25回臨床検査精度管理調査

試料測定結果（1）

試料測定結果について

1．調査項目の測定法別試料ごとの参加施設数、標準偏差、平均値（表1）

表1に、項目別、測定法別測定値の平均値±２SD以内の施設数、標準偏差、平均値を示す。

ここで示した標準偏差は、調査項目欄で示した測定法群に属する25回精度管理調査の測定値から実際に計算された統計量で、全衛連調査における項目別、同一測定法群別の現行の技術水準と見なされる。

なお、表1の調査項目欄の［　］内の番号は測定方法のコード番号であり、表3には、調査項目について、それぞれのコード番号の測定方法名、測定機種、実施施設数を掲載している。

2．調査項目の測定法別試料ごとの平均値および平均値評価規準（表2）

評価規準として用いた平均値（基準濃度）と評価範囲として用いた評価規準の一覧を表2に示す。

「平均値評価規準」の値は、「Ⅲ.評価規準等」で示した表2-1、および表2-2の評価Aの評価規準（%）を実際の濃度に換算して示している。

この表に示されている評価規準は評価範囲を示すもので、表1に示した現行の技術水準とは異なるので注意されたい。

3．調査項目別・測定方法別実施施設数（表3）

測定法分類による「評価せず」は、施設数が5施設以下の統計量で計算された標準偏差は統計的意義が乏しいことからあくまでも参考であり、これらの項目および測定法群は「評価せず」と備考欄に記載した。

なお、26年度より複数の施設の検査を受託している検査施設を、受託している施設数で計上するか、同一の検査方法であるため、検査施設ごとに１として計上するかについて検討し、検査施設への集約は行わず、参加施設単位で計上することとしている。

表17　調査項目の測定法別標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[11・21] ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法・脱水素酵素法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.76	0.88	1.02	1.08	1.05	1.69	1.50	1.62
	平均値	77.50	96.49	115.72	135.15	147.94	167.13	186.60	205.47
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.00	0.63	1.10	0.83	1.47	0.83	3.19	2.48
	平均値	77.00	94.00	112.00	133.25	147.80	170.75	189.80	207.80
中性脂肪　[11・21] 酵素UV法・比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.61	0.68	0.90	0.93	1.16	1.24	1.40	1.42
	平均値	53.06	65.17	77.50	89.88	98.17	110.59	122.82	135.11
中性脂肪　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.71	0.75	0.49	0.50	0.49	0.83	1.02	0.80
	平均値	71.00	87.80	105.40	123.50	135.60	153.75	172.40	192.40
尿酸　[31] ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06
	平均値	5.09	5.51	5.97	6.41	6.69	7.12	7.59	8.01
尿酸　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.04	0.04	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00	0.05
	平均値	5.18	5.58	6.00	6.45	6.70	7.18	7.60	8.06
クレアチニン　[21] 酵素法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
	平均値	1.01	1.61	2.21	2.82	3.22	3.83	4.44	5.04
クレアチニン　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.00	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03	0.06
	平均値	0.98	1.59	2.24	2.93	3.39	4.14	4.91	5.71
AST　[11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.76	1.34	2.21	2.62	3.07	3.59	3.98	4.27
	平均値	21.09	38.99	57.17	75.60	86.51	105.54	123.92	143.50
AST　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.00	1.85	0.49	0.87	0.89	1.22	1.20	1.72
	平均値	17.00	30.60	44.40	61.50	74.00	93.00	111.60	133.20
ALT　[11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.44	0.49	0.69	0.85	1.06	1.20	1.24	1.50
	平均値	19.74	37.55	55.22	73.36	85.19	102.80	120.29	137.51
ALT　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.83	0.40	0.80	0.43	1.02	0.87	0.75	1.85
	平均値	28.75	44.20	62.40	79.25	89.60	105.50	120.80	135.60
γ-GT　[11] JSCC標準化対応法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.41	0.57	0.81	0.91	0.82	1.13	1.18	1.44
	平均値	30.21	48.56	66.66	85.45	97.51	116.03	134.37	152.35
γ-GT　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.71	0.98	0.80	0.87	1.17	1.12	1.72	2.06
	平均値	30.00	47.80	65.40	83.50	93.80	109.50	123.80	137.60
血糖　[11・12・21・31] ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素比色法・電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法/ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	施設数	147	152	143	115	115	149	146	144
	標準偏差	0.79	0.80	1.03	0.81	1.21	1.08	1.38	1.48
	平均値	91.52	108.42	125.38	142.53	153.35	170.19	187.42	204.26
血糖　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	施設数	4	5	5	4	5	4	5	5
	標準偏差	0.00	0.80	0.63	1.22	0.75	1.30	0.63	1.60
	平均値	87.00	104.40	122.00	141.00	153.20	173.25	193.00	214.20
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[01-0403] 沈殿操作を行わない方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C)	施設数	70	72	81	51	65			
	標準偏差	0.47	0.61	0.67	0.78	1.01			
	平均値	31.64	43.99	50.29	48.70	72.39			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[01-1201] 沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	施設数	69	63	59	55	45			
	標準偏差	0.49	0.63	0.84	0.61	0.99			
	平均値	36.14	51.67	56.57	49.63	75.43			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1301]	施設数	1	0	1	0	1			
沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
生研(EX N)	平均値	32.00	0.00	54.00	0.00	73.00			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2304]	施設数	6	9	5	9	1			
沈殿操作を行わない方法 和光	標準偏差	0.00	0.57	0.80	0.79	0.00			
純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰHDL-CM3)	平均値	32.00	45.11	52.60	47.78	69.00			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [08-2801]	施設数	4	5	5	4	5			
ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	標準偏差	0.00	0.50	2.17	1.00	9.55			
	平均値	33.00	44.50	54.75	49.00	78.00			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-0403]	施設数	70	72	81	52	64			
沈殿操作を行わない方法 協和ﾒ	標準偏差	0.60	0.86	1.20	2.05	1.25			
ﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C)	平均値	66.24	93.48	126.43	148.68	100.34			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1201]	施設数	68	63	56	55	43			
沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨ	標準偏差	0.84	1.14	1.47	1.59	1.64			
ｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	平均値	71.16	101.74	132.11	155.52	105.15			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1301]	施設数	0	1	1	0	1			
沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
生研(LDL-EX N)	平均値	0.00	106.00	143.00	0.00	103.00			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1302]	施設数	1	0	1	0	1			
沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
生研(ﾃﾞｭｱﾙCHO T&L)	平均値	75.00	0.00	132.00	0.00	103.00			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2302]	施設数	7	8	7	8	3			
沈殿操作を行わない方法 和光	標準偏差	2.06	1.94	1.64	3.04	1.25			
純薬(Lﾀｲﾌﾟ LDL-C M)	平均値	77.43	109.50	140.14	151.38	102.67			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2801]	施設数	4	5	5	4	5			
沈殿操作を行わない方法 ｵｰｿ	標準偏差	0.50	1.50	8.70	0.50	7.54			
(ﾋﾞﾄﾛｽﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟdLDL)	平均値	66.50	97.50	127.75	144.50	89.00			
HbA1c [01-2701]	施設数	17	17	15	23	23			
HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	標準偏差	0.05	0.07	0.06	0.04	0.06			
	平均値	5.51	6.43	7.44	5.38	6.10			
HbA1c [01-2901]	施設数	46	47	49	71	71			
HPLC法 東ｿｰ	標準偏差	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08			
	平均値	5.55	6.57	7.59	5.36	6.08			
HbA1c [02-0401・03]	施設数	20	21	26	29	29			
免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(汎用	標準偏差	0.04	0.07	0.07	0.06	0.05			
自動分析装置)凍乾品・液状品	平均値	5.58	6.84	7.99	5.29	5.98			
HbA1c [02-0402・04]	施設数	19	19	16	27	27			
免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(DM-	標準偏差	0.05	0.08	0.06	0.07	0.07			
JACKｼﾘｰｽﾞ)凍結品・液状品	平均値	5.56	6.77	7.89	5.31	5.92			
HbA1c [02-2401]	施設数	9	7	7	10	10			
免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	標準偏差	0.03	0.05	0.07	0.05	0.05			
	平均値	5.50	6.68	7.78	5.24	5.94			
HbA1c [03-0401]	施設数	24	18	23	29	29			
酵素法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ	標準偏差	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05			
	平均値	5.70	6.67	7.70	5.31	6.00			
HbA1c [03-1201]	施設数	6	7	5	9	9			
酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ	標準偏差	0.11	0.10	0.10	0.06	0.04			
	平均値	5.53	6.49	7.56	5.28	5.98			
HbA1c [03-2701]	施設数	6	10	7	11	11			
酵素法 ｱｰｸﾚｲ	標準偏差	0.07	0.07	0.06	0.05	0.09			
	平均値	5.37	6.38	7.39	5.33	5.99			
HbA1c [03-3501]	施設数	1	0	1	1	1			
酵素法 日本電子	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	5.40	0.00	7.40	5.30	6.10			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ [1･2･9]	施設数	210	123	108	209	210			
その他(比色法[ﾉﾆｼｱﾝ法]/比色法	標準偏差	0.10	0.11	0.07	0.09	0.07			
[四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩法]/SLSﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	平均値	14.51	13.46	9.37	12.19	9.83			
赤血球	施設数	1	1	0	1	1			
日本光電JAA702	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	471.00	451.00	0.00	404.00	369.00			
赤血球	施設数	3	2	1	3	3			
ｼｽﾒｯｸｽJAB511	標準偏差	6.85	3.00	0.00	5.25	3.74			
	平均値	477.67	449.00	348.00	402.33	363.00			
赤血球	施設数	127	70	75	127	127			
ｼｽﾒｯｸｽJAB512	標準偏差	2.24	2.26	1.90	2.32	2.40			
	平均値	489.44	463.78	354.11	406.89	365.78			
赤血球	施設数	23	14	9	23	23			
ｼｽﾒｯｸｽJAB514	標準偏差	5.33	3.38	5.31	4.88	4.62			
	平均値	483.61	459.69	345.78	403.64	362.41			
赤血球	施設数	40	24	17	40	40			
ｼｽﾒｯｸｽJAB517	標準偏差	3.21	3.11	3.04	3.17	3.45			
	平均値	488.07	461.07	347.53	407.27	364.78			
赤血球	施設数	1	0	1	1	1			
ｼｽﾒｯｸｽJAB519	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	487.00	0.00	346.00	405.00	360.00			
赤血球	施設数	1	0	1	1	1			
堀場製作所JAC910	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	479.00	0.00	342.00	389.00	355.00			
赤血球	施設数	4	4	0	3	4			
ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ011	標準偏差	1.41	1.41	0.00	1.25	2.18			
	平均値	484.00	460.00	0.00	405.33	361.50			
赤血球	施設数	5	3	2	5	5			
ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ012	標準偏差	2.76	4.19	3.00	4.22	4.07			
	平均値	478.00	455.33	348.00	406.60	365.80			
赤血球	施設数	1	1	0	1	1			
ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	468.00	446.00	0.00	389.00	365.00			
赤血球	施設数	3	2	2	3	3			
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	標準偏差	4.24	1.00	1.50	0.82	0.94			
	平均値	483.00	459.00	350.50	399.00	356.67			
赤血球	施設数	2	2	0	2	2			
ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR409	標準偏差	3.50	3.00	0.00	3.00	4.50			
	平均値	489.50	464.00	0.00	398.00	358.50			
白血球	施設数	1	1	0	1	1			
日本光電JAA702	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	28.00	56.00	0.00	67.00	60.00			
白血球	施設数	3	2	1	3	3			
ｼｽﾒｯｸｽJAB511	標準偏差	0.82	0.50	0.00	2.16	0.47			
	平均値	28.00	55.50	117.00	66.00	59.67			
白血球	施設数	127	70	75	127	127			
ｼｽﾒｯｸｽJAB512	標準偏差	0.59	0.89	1.57	1.67	1.34			
	平均値	28.73	58.78	116.78	68.77	60.40			
白血球	施設数	23	14	9	23	23			
ｼｽﾒｯｸｽJAB514	標準偏差	0.67	0.49	1.89	1.28	1.01			
	平均値	29.74	59.62	116.44	69.00	59.81			
白血球	施設数	40	24	17	40	40			
ｼｽﾒｯｸｽJAB517	標準偏差	0.48	0.56	1.40	2.52	1.44			
	平均値	28.63	58.14	112.57	69.19	61.14			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
白血球 ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	25.00	0.00	103.00	69.00	59.00			
白血球 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	28.00	0.00	112.00	66.00	60.00			
白血球 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ011	施設数	4	4	0	3	4			
	標準偏差	0.43	0.43	0.00	1.70	1.09			
	平均値	30.25	59.25	0.00	69.33	59.75			
白血球 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	5	3	2	5	5			
	標準偏差	0.49	0.82	0.50	3.54	1.41			
	平均値	29.60	59.00	114.50	65.80	57.00			
白血球 ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	28.00	56.00	0.00	61.00	55.00			
白血球 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	1.78	0.00	0.50	1.41	3.19			
	平均値	27.50	57.00	111.50	68.00	58.50			
白血球 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR409	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.50	4.00			
	平均値	29.00	57.00	0.00	60.50	41.00			
ヘマトクリット 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	43.20	40.50	0.00	35.60	30.10			
ヘマトクリット ｼｽﾒｯｸｽJAB511	施設数	3	2	1	3	3			
	標準偏差	0.52	0.10	0.00	0.33	0.22			
	平均値	37.93	34.80	25.50	34.87	30.30			
ヘマトクリット ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	127	70	75	127	127			
	標準偏差	0.44	0.32	0.34	0.38	0.36			
	平均値	41.70	38.74	27.80	35.79	30.75			
ヘマトクリット ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	23	14	9	23	23			
	標準偏差	0.48	0.40	0.43	0.57	0.48			
	平均値	40.50	37.79	27.03	35.31	30.45			
ヘマトクリット ｼｽﾒｯｸｽJAB517	施設数	40	24	17	40	40			
	標準偏差	0.54	0.49	0.29	0.39	0.42			
	平均値	41.62	38.57	27.32	36.25	31.20			
ヘマトクリット ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	42.20	0.00	27.60	36.80	31.30			
ヘマトクリット 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	39.80	0.00	26.40	35.80	30.60			
ヘマトクリット ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ011	施設数	4	4	0	3	4			
	標準偏差	0.38	0.43	0.00	0.17	0.45			
	平均値	41.95	39.17	0.00	35.87	29.72			
ヘマトクリット ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	5	3	2	5	5			
	標準偏差	0.25	0.19	0.20	0.48	0.59			
	平均値	42.82	39.93	28.70	36.86	31.14			
ヘマトクリット ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	37.90	34.90	0.00	35.70	32.50			
ヘマトクリット ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.40	0.25	0.15	0.05	0.16			
	平均値	39.87	36.95	26.45	36.73	31.30			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
ヘマトクリット ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR409	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.70	0.60	0.00	0.80	0.10			
	平均値	38.10	35.30	0.00	36.70	31.10			
血小板 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	40.90	30.00	0.00	26.70	25.90			
血小板 ｼｽﾒｯｸｽJAB511	施設数	3	2	1	3	3			
	標準偏差	1.34	0.45	0.00	0.54	1.10			
	平均値	36.60	28.35	56.60	27.67	26.60			
血小板 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	127	70	75	127	127			
	標準偏差	0.59	0.41	0.81	0.60	0.64			
	平均値	35.31	26.89	52.69	28.35	27.64			
血小板 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	23	14	9	23	23			
	標準偏差	0.73	0.54	1.54	0.79	0.84			
	平均値	35.10	26.92	49.91	27.16	26.58			
血小板 ｼｽﾒｯｸｽJAB517	施設数	40	24	17	40	40			
	標準偏差	1.08	0.76	1.46	0.67	0.63			
	平均値	36.71	27.33	50.54	27.84	26.62			
血小板 ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	37.70	0.00	52.50	27.40	26.30			
血小板 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	33.00	0.00	46.50	27.20	26.00			
血小板 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ011	施設数	4	4	0	3	4			
	標準偏差	0.54	0.28	0.00	0.05	0.11			
	平均値	30.70	23.02	0.00	24.87	24.55			
血小板 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	5	3	2	5	5			
	標準偏差	0.87	0.14	0.25	0.72	0.62			
	平均値	31.50	23.90	46.75	24.18	22.94			
血小板 ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	30.50	23.80	0.00	26.40	26.50			
血小板 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.15	0.35	0.10	0.52	0.34			
	平均値	34.82	26.95	52.50	27.63	27.28			
血小板 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR409	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.80	1.00	0.00	1.00	0.55			
	平均値	34.60	27.30	0.00	25.30	23.85			
平均赤血球容積 日本光電JAA702	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	91.90	89.60	0.00	88.10	81.60			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB511	施設数	3	2	1	3	3			
	標準偏差	0.22	0.30	0.00	0.37	0.40			
	平均値	79.40	77.50	73.40	86.60	83.53			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	127	70	75	127	127			
	標準偏差	0.73	0.58	0.82	0.79	0.80			
	平均値	85.18	83.52	78.45	87.90	84.03			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	23	14	9	23	23			
	標準偏差	0.73	0.82	0.46	0.82	0.78			
	平均値	83.71	82.18	78.32	87.53	84.14			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB517	施設数	40	24	17	40	40			
	標準偏差	0.86	0.74	0.88	1.04	0.96			
	平均値	85.31	83.87	78.59	88.93	85.64			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	86.70	0.00	79.80	90.90	86.90			
平均赤血球容積 堀場製作所JAC910	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	83.10	0.00	77.20	92.00	86.20			
平均赤血球容積 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ011	施設数	4	4	0	3	4			
	標準偏差	0.84	1.05	0.00	0.53	0.96			
	平均値	86.65	85.15	0.00	88.47	82.22			
平均赤血球容積 ﾍﾞｯｸﾏﾝｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	5	3	2	5	5			
	標準偏差	0.48	0.21	0.20	0.38	0.70			
	平均値	89.62	88.33	82.50	90.60	85.08			
平均赤血球容積 ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	80.80	78.60	0.00	91.60	89.10			
平均赤血球容積 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	3	2	2	3	3			
	標準偏差	0.17	0.35	0.00	0.26	0.22			
	平均値	82.53	80.55	75.50	92.07	87.70			
平均赤血球容積 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR409	施設数	2	2	0	2	2			
	標準偏差	0.80	0.90	0.00	1.40	1.35			
	平均値	77.80	76.10	0.00	92.30	86.95			

(2)尿検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	施設数	349	349	180	171	178	175	178	174
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
尿蛋白　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	施設数	349	349	180	171	178	175	178	174
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
尿潜血　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	施設数	349	349	180	171	178	175	178	174
	標準偏差	-	-	-	-	-	-	-	-
	平均値	1	1	3	2	1	2	2	3

表18　調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[11・21] ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法・脱水素酵素法	平均値	77.50	96.49	115.72	135.15	147.94	167.13	186.60	205.47
	平均値 評価規準	3.10	3.86	4.63	5.41	5.92	6.69	7.46	8.22
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	77.00	94.00	112.00	133.25	147.80	170.75	189.80	207.80
	平均値 評価規準	3.08	3.76	4.48	5.33	5.91	6.83	7.59	8.31
中性脂肪　[11・21] 酵素UV法・比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	平均値	53.06	65.17	77.50	89.88	98.17	110.59	122.82	135.11
	平均値 評価規準	2.81	3.45	4.11	4.76	5.20	5.86	6.51	7.16
中性脂肪　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	71.00	87.80	105.40	123.50	135.60	153.75	172.40	192.40
	平均値 評価規準	3.76	4.65	5.59	6.55	7.19	8.15	9.14	10.20
尿酸　[31] ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	平均値	5.09	5.51	5.97	6.41	6.69	7.12	7.59	8.01
	平均値 評価規準	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
尿酸　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	5.18	5.58	6.00	6.45	6.70	7.18	7.60	8.06
	平均値 評価規準	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
クレアチニン　[21] 酵素法	平均値	1.01	1.61	2.21	2.82	3.22	3.83	4.44	5.04
	平均値 評価規準	0.05	0.05	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15	0.17
クレアチニン　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	0.99	1.59	2.24	2.93	3.39	4.14	4.91	5.71
	平均値 評価規準	0.05	0.05	0.08	0.10	0.12	0.14	0.17	0.19
AST　[11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	21.09	38.99	57.17	75.60	86.51	105.54	123.92	143.50
	平均値 評価規準	1.14	2.11	3.09	4.08	4.67	5.70	6.69	7.75
AST　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	17.00	30.60	44.40	61.50	74.00	93.00	111.60	133.20
	平均値 評価規準	1.00	1.65	2.40	3.32	4.00	5.02	6.03	7.19
ALT　[11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	19.74	37.55	55.22	73.36	85.19	102.80	120.29	137.51
	平均値 評価規準	1.18	2.25	3.31	4.40	5.11	6.17	7.22	8.25
ALT　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	28.75	44.20	62.40	79.25	89.60	105.50	120.80	135.60
	平均値 評価規準	1.73	2.65	3.74	4.76	5.38	6.33	7.25	8.14
γ-GT　[11] JSCC標準化対応法	平均値	30.21	48.56	66.66	85.45	97.51	116.03	134.37	152.35
	平均値 評価規準	1.63	2.62	3.60	4.61	5.27	6.27	7.26	8.23
γ-GT　[85] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	平均値	30.00	47.80	65.40	83.50	93.80	109.50	123.80	137.60
	平均値 評価規準	1.62	2.58	3.53	4.51	5.07	5.91	6.69	7.43
血糖　[11・12・21・31] ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素比色法・電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法/ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	平均値	91.52	108.42	125.38	142.53	153.35	170.19	187.42	204.26
	平均値 評価規準	2.01	2.39	2.76	3.14	3.37	3.74	4.12	4.49
血糖　[81] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値	87.00	104.40	122.00	141.00	153.20	173.25	193.00	214.20
	平均値 評価規準	1.91	2.30	2.68	3.10	3.37	3.81	4.25	4.71
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[01-0403] 沈殿操作を行わない方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C)	平均値	31.64	43.99	50.29	48.70	72.39			
	平均値 評価規準	0.82	1.14	1.31	1.27	1.88			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[01-1201] 沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	平均値	36.14	51.67	56.57	49.63	75.43			
	平均値 評価規準	0.94	1.34	1.47	1.29	1.96			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ　[01-2304] 沈殿操作を行わない方法 和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰHDL-CM3)	平均値	32.00	45.11	52.60	47.78	69.00			
	平均値 評価規準	0.83	1.17	1.37	1.24	1.79			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [08-2801]	平均値	33.00	44.50	54.75	49.00	78.00			
ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	平均値評価規準	0.86	1.16	1.42	1.27	2.03			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-0403]	平均値	66.24	93.48	126.43	148.68	100.34			
沈殿操作を行わない方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C)	平均値評価規準	2.25	3.18	4.30	5.06	3.41			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1201]	平均値	71.16	101.74	132.11	155.52	105.15			
沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	平均値評価規準	2.42	3.46	4.49	5.29	3.58			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2302]	平均値	77.43	109.50	140.14	151.38	102.67			
沈殿操作を行わない方法 和光純薬(Lﾀｲﾌﾟ LDL-C M)	平均値評価規準	2.63	3.72	4.76	5.15	3.49			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2801]	平均値	66.50	97.50	127.75	144.50	89.00			
沈殿操作を行わない方法 ｵｰｿ(ﾋﾞﾄﾛｽﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟdLDL)	平均値評価規準	2.26	3.32	4.34	4.91	3.03			
HbA1c [01-2701]	平均値	5.51	6.43	7.44	5.38	6.10			
HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	平均値評価規準	0.15	0.17	0.20	0.15	0.16			
HbA1c [01-2901]	平均値	5.55	6.57	7.59	5.36	6.08			
HPLC法 東ｿｰ	平均値評価規準	0.15	0.18	0.20	0.14	0.16			
HbA1c [02-0401・03]	平均値	5.58	6.84	7.99	5.29	5.98			
免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(汎用自動分析装置)凍乾品・液状品	平均値評価規準	0.15	0.18	0.22	0.14	0.16			
HbA1c [02-0402・04]	平均値	5.56	6.77	7.89	5.31	5.92			
免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)凍結品・液状品	平均値評価規準	0.15	0.18	0.21	0.14	0.16			
HbA1c [02-2401]	平均値	5.50	6.68	7.78	5.24	5.94			
免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	平均値評価規準	0.15	0.18	0.21	0.14	0.16			
HbA1c [03-0401]	平均値	5.70	6.67	7.70	5.31	6.00			
酵素法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ	平均値評価規準	0.15	0.18	0.21	0.14	0.16			
HbA1c [03-1201]	平均値	5.53	6.49	7.56	5.28	5.98			
酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ	平均値評価規準	0.15	0.18	0.20	0.14	0.16			
HbA1c [03-2701]	平均値	5.37	6.38	7.39	5.33	5.99			
酵素法 ｱｰｸﾚｲ	平均値評価規準	0.14	0.17	0.20	0.14	0.16			
ヘモグロビン [1・2・9]	平均値	14.51	13.46	9.37	12.19	9.83			
その他(比色法[ﾉﾆｼｱﾝ法]/比色法[四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩法]/SLSﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	平均値評価規準	0.30	0.28	0.20	0.26	0.21			
赤血球	平均値	489.44	463.78	354.11	406.89	365.78			
ｼｽﾒｯｸｽJAB512	平均値評価規準	10.77	10.20	7.79	8.95	8.05			
赤血球	平均値	483.61	459.69	345.78	403.64	362.41			
ｼｽﾒｯｸｽJAB514	平均値評価規準	10.64	10.11	7.61	8.88	7.97			
赤血球	平均値	488.07	461.07	347.53	407.27	364.78			
ｼｽﾒｯｸｽJAB517	平均値評価規準	10.74	10.14	7.65	8.96	8.03			
白血球	平均値	28.73	58.78	116.78	68.77	60.40			
ｼｽﾒｯｸｽJAB512	平均値評価規準	2.10	4.29	8.53	5.02	4.41			
白血球	平均値	29.74	59.62	116.44	69.00	59.81			
ｼｽﾒｯｸｽJAB514	平均値評価規準	2.17	4.35	8.50	5.04	4.37			

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
白血球 シスメックスJAB517	平均値	28.63	58.14	112.57	69.19	61.14			
	平均値 評価規準	2.09	4.24	8.22	5.05	4.46			
ヘマトクリット シスメックスJAB512	平均値	41.70	38.74	27.80	35.79	30.75			
	平均値 評価規準	1.71	1.59	1.14	1.47	1.26			
ヘマトクリット シスメックスJAB514	平均値	40.50	37.79	27.03	35.31	30.45			
	平均値 評価規準	1.66	1.55	1.11	1.45	1.25			
ヘマトクリット シスメックスJAB517	平均値	41.62	38.57	27.32	36.25	31.20			
	平均値 評価規準	1.71	1.58	1.12	1.49	1.28			
血小板 シスメックスJAB512	平均値	35.31	26.89	52.69	28.35	27.64			
	平均値 評価規準	2.37	1.80	3.53	1.90	1.85			
血小板 シスメックスJAB514	平均値	35.10	26.92	49.91	27.16	26.58			
	平均値 評価規準	2.35	1.80	3.34	1.82	1.78			
血小板 シスメックスJAB517	平均値	36.71	27.33	50.54	27.84	26.62			
	平均値 評価規準	2.46	1.83	3.39	1.87	1.78			
平均赤血球容積 シスメックスJAB512	平均値	85.18	83.52	78.45	87.90	84.03			
	平均値 評価規準	1.79	1.75	1.65	1.85	1.76			
平均赤血球容積 シスメックスJAB514	平均値	83.71	82.18	78.33	87.53	84.14			
	平均値 評価規準	1.76	1.73	1.64	1.84	1.77			
平均赤血球容積 シスメックスJAB517	平均値	85.31	83.87	78.59	88.93	85.64			
	平均値 評価規準	1.79	1.76	1.65	1.87	1.80			

(2)尿検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-
尿蛋白　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-
尿潜血　[1･2] 試験紙法 目視判定･機器判定	平均値	1	1	3	2	1	2	2	3
	平均値 評価規準	-	-	-	-	-	-	-	-

表19　調査項目別・測定方法別・実施施設数

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	実施施設	備考
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	11	ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法	323	
	21	ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ脱水素酵素法	32	
	81	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
中性脂肪	11	酵素UV法 ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	9	
	21	酵素比色法 ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	346	
	81	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
尿酸	31	ｳﾘｶｰｾﾞ･ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	355	
	81	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
クレアチニン	21	酵素法	355	
	81	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
AST	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	355	
	85	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	1	
ALT	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	355	
	85	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	1	
γ-GT	11	JSCC標準化対応法	355	
	85	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽJ(ｵｰｿ)	1	
血糖	11	ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素比色法	1	
	12	ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法	35	
	21	ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ･UV法	315	
	31	ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	4	
	81	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	沈殿操作を行わない方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C)	179	
	01-1201	沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	165	
	01-1301	沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ生研(EX N)	1	評価せず
	01-2304	沈殿操作を行わない方法 和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰHDL-CM3)	10	
	08-2801	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘｰ法ﾋﾞﾄﾛｽ(ｵｰｿ)	1	
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	沈殿操作を行わない方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C)	179	
	01-1201	沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	163	
	01-1301	沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ生研(LDL-EX N)	1	評価せず
	01-1302	沈殿操作を行わない方法 ﾃﾞﾝｶ生研(ﾃﾞｭｱﾙCHO T&L)	1	評価せず
	01-2302	沈殿操作を行わない方法 和光純薬(Lﾀｲﾌﾟ LDL-C M)	11	
	01-2801	沈殿操作を行わない方法 ｵｰｿ(ﾋﾞﾄﾛｽﾏｲｸﾛﾁｯﾌﾟdLDL)	1	
HbA1c	01-2701	HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	25	
	01-2901	HPLC法 東ｿｰ	72	
	02-0401	免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(汎用自動分析装置)凍乾品	73	
	02-0402	免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)凍乾品	1	
	02-0403	免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(汎用自動分析装置)液状品	23	
	02-0404	免疫学的方法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ(DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)液状品	26	
	02-2401	免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	23	
	03-0401	酵素法 協和ﾒﾃﾞｯｸｽ	66	
	03-1201	酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ	9	
	03-2701	酵素法 ｱｰｸﾚｲ	36	
	03-3501	酵素法 日本電子	1	評価せず
尿糖	1	試験紙法 目視判定	163	
	2	試験紙法 機器判定	192	
尿蛋白	1	試験紙法 目視判定	162	
	2	試験紙法 機器判定	193	
尿潜血	1	試験紙法 目視判定	162	
	2	試験紙法 機器判定	193	
ヘモグロビン	1	ｼｱﾝﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法	9	
	2	非ｼｱﾝ界面活性剤法	338	
	9	その他（比色法[ﾉﾆｼｱﾝ法]/比色法[四級ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩法]/SLSﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法/ｵｷｼﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ変法）	6	

表19　調査項目別・測定方法別・実施施設数

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	実施施設	備考
赤血球		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	263	
		JAB514	23	
		JAB517	45	
		JAB519	1	評価せず
		JAC910	1	評価せず
		JAJ011	4	評価せず
		JAJ012	5	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
白血球		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	263	
		JAB514	23	
		JAB517	45	
		JAB519	1	評価せず
		JAC910	1	評価せず
		JAJ011	4	評価せず
		JAJ012	5	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
ヘマトクリット		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	263	
		JAB514	23	
		JAB517	45	
		JAB519	1	評価せず
		JAC910	1	評価せず
		JAJ011	4	評価せず
		JAJ012	5	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
血小板		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	263	
		JAB514	23	
		JAB517	45	
		JAB519	1	評価せず
		JAC910	1	評価せず
		JAJ011	4	評価せず
		JAJ012	5	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず
平均赤血球容積		JAA702	1	評価せず
		JAB511	3	評価せず
		JAB512	263	
		JAB514	23	
		JAB517	45	
		JAB519	1	評価せず
		JAC910	1	評価せず
		JAJ011	4	評価せず
		JAJ012	5	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	4	評価せず
		JAR409	2	評価せず

第25回臨床検査精度管理調査

試料測定結果（2）

調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比

付表　１－１（全施設）
付表　１－２（自施設測定）
付表　１－３（外部機関測定）

測定法別の評価点ランク別施設数、構成比

付表　２－１（全施設）
付表　２－２（自施設測定）
付表　２－３（外部機関測定）

尿検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比

付表　３－１（尿糖）
付表　３－２（尿蛋白）
付表　３－３（尿潜血）

付表１－１　調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設分）

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	25回	334	93.8%	12	3.4%	6	1.7%	2	0.6%	2	0.6%	356	100%
	24回	349	96.1%	8	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	363	100%
	23回	341	94.7%	12	3.3%	5	1.4%	1	0.3%	1	0.3%	360	100%
中性脂肪	25回	328	92.1%	14	3.9%	10	2.8%	4	1.1%	0	0.0%	356	100%
	24回	348	95.9%	6	1.7%	2	0.6%	3	0.8%	4	1.1%	363	100%
	23回	328	91.1%	10	2.8%	15	4.2%	6	1.7%	1	0.3%	360	100%
尿酸	25回	329	92.4%	13	3.7%	7	2.0%	7	2.0%	0	0.0%	356	100%
	24回	345	95.0%	9	2.5%	5	1.4%	1	0.3%	3	0.8%	363	100%
	23回	337	93.6%	14	3.9%	4	1.1%	1	0.3%	4	1.1%	360	100%
クレアチニン	25回	332	93.3%	17	4.8%	5	1.4%	1	0.3%	1	0.3%	356	100%
	24回	353	97.0%	5	1.4%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.8%	364	100%
	23回	327	90.8%	3	0.8%	7	1.9%	15	4.2%	8	2.2%	360	100%
AST	25回	307	86.2%	16	4.5%	11	3.1%	8	2.2%	14	3.9%	356	100%
	24回	351	96.4%	5	1.4%	3	0.8%	1	0.3%	4	1.1%	364	100%
	23回	316	87.8%	14	3.9%	13	3.6%	1	0.3%	16	4.4%	360	100%
ALT	25回	344	96.6%	6	1.7%	4	1.1%	0	0.0%	2	0.6%	356	100%
	24回	353	97.0%	5	1.4%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.8%	364	100%
	23回	338	93.9%	9	2.5%	4	1.1%	9	2.5%	0	0.0%	360	100%
γ-GT	25回	332	93.3%	12	3.4%	10	2.8%	1	0.3%	1	0.3%	356	100%
	24回	349	96.1%	6	1.7%	3	0.8%	1	0.3%	4	1.1%	363	100%
	23回	338	93.9%	15	4.2%	5	1.4%	2	0.6%	0	0.0%	360	100%
血糖	25回	324	91.0%	13	3.7%	9	2.5%	5	1.4%	5	1.4%	356	100%
	24回	349	95.9%	9	2.5%	2	0.5%	0	0.0%	4	1.1%	364	100%
	23回	332	92.2%	9	2.5%	7	1.9%	6	1.7%	6	1.7%	360	100%
HDLコレステロール	25回	329	92.4%	7	2.0%	5	1.4%	1	0.3%	14	3.9%	356	100%
	24回	344	94.5%	7	1.9%	8	2.2%	1	0.3%	4	1.1%	364	100%
	23回	340	94.4%	10	2.8%	5	1.4%	1	0.3%	4	1.1%	360	100%
LDLコレステロール	25回	338	94.9%	1	0.3%	3	0.8%	0	0.0%	14	3.9%	356	100%
	24回	362	99.5%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	364	100%
	23回	352	98.1%	1	0.3%	1	0.3%	1	0.3%	4	1.1%	359	100%
HbA1c	25回	348	98.3%	2	0.6%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.6%	354	100%
	24回	352	97.2%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.6%	6	1.7%	362	100%
	23回	346	96.6%	4	1.1%	4	1.1%	2	0.6%	2	0.6%	358	100%
尿糖	25回	305	85.9%	47	13.2%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	355	100%
	24回	294	81.0%	61	16.8%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.1%	363	100%
	23回	300	83.6%	48	13.4%	4	1.1%	2	0.6%	5	1.4%	359	100%
尿蛋白	25回	346	97.5%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	355	100%
	24回	353	97.2%	6	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	363	100%
	23回	345	96.1%	12	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	359	100%
尿潜血	25回	317	89.3%	33	9.3%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	355	100%
	24回	328	90.4%	34	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	363	100%
	23回	324	90.3%	28	7.8%	5	1.4%	0	0.0%	2	0.6%	359	100%
ヘモグロビン	25回	345	97.7%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.3%	3	0.8%	353	100%
	24回	351	97.2%	3	0.8%	2	0.6%	1	0.3%	4	1.1%	361	100%
	23回	347	96.7%	8	2.2%	3	0.8%	0	0.0%	1	0.3%	359	100%
赤血球	25回	350	99.2%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%
	24回	358	99.2%	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100%
	23回	355	98.9%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	359	100%
白血球	25回	352	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%
	24回	361	#####	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100%
	23回	357	99.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	359	100%
ヘマトクリット	25回	351	99.4%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%
	24回	361	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	361	100%
	23回	355	98.9%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	3	0.8%	359	100%
血小板	25回	350	99.2%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	353	100%
	24回	351	97.2%	2	0.6%	7	1.9%	0	0.0%	1	0.3%	361	100%
	23回	352	98.1%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	3	0.8%	359	100%
平均赤血球容積	25回	343	97.2%	4	1.1%	3	0.8%	1	0.3%	2	0.6%	353	100%
	24回	356	98.6%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	361	100%
	23回	345	96.1%	9	2.5%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	359	100%

付表１－２　調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設分）

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	25回	131	86.8%	12	7.9%	4	2.6%	2	1.3%	2	1.3%	151	100%
	24回	151	96.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	156	100%
	23回	141	88.7%	11	6.9%	5	3.1%	1	0.6%	1	0.6%	159	100%
中性脂肪	25回	128	84.8%	12	7.9%	7	4.6%	4	2.6%	0	0.0%	151	100%
	24回	145	92.9%	5	3.2%	1	0.6%	2	1.3%	3	1.9%	156	100%
	23回	133	83.6%	9	5.7%	11	6.9%	5	3.1%	1	0.6%	159	100%
尿酸	25回	134	88.7%	7	4.6%	5	3.3%	5	3.3%	0	0.0%	151	100%
	24回	145	92.9%	5	3.2%	4	2.6%	1	0.6%	1	0.6%	156	100%
	23回	141	88.7%	11	6.9%	3	1.9%	1	0.6%	3	1.9%	159	100%
クレアチニン	25回	130	86.1%	14	9.3%	5	3.3%	1	0.7%	1	0.7%	151	100%
	24回	151	96.2%	3	1.9%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.6%	157	100%
	23回	144	90.6%	2	1.3%	4	2.5%	7	4.4%	2	1.3%	159	100%
AST	25回	127	84.1%	11	7.3%	4	2.6%	3	2.0%	6	4.0%	151	100%
	24回	146	93.0%	5	3.2%	2	1.3%	1	0.6%	3	1.9%	157	100%
	23回	128	80.5%	13	8.2%	6	3.8%	0	0.0%	12	7.5%	159	100%
ALT	25回	146	96.7%	2	1.3%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.7%	151	100%
	24回	148	94.3%	4	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	157	100%
	23回	142	89.3%	5	3.1%	4	2.5%	8	5.0%	0	0.0%	159	100%
γ-GT	25回	131	86.8%	10	6.6%	8	5.3%	1	0.7%	1	0.7%	151	100%
	24回	147	94.2%	3	1.9%	3	1.9%	0	0.0%	3	1.9%	156	100%
	23回	145	91.2%	10	6.3%	2	1.3%	2	1.3%	0	0.0%	159	100%
血糖	25回	125	82.8%	10	6.6%	8	5.3%	4	2.6%	4	2.6%	151	100%
	24回	147	93.6%	6	3.8%	1	0.6%	0	0.0%	3	1.9%	157	100%
	23回	135	84.9%	7	4.4%	7	4.4%	5	3.1%	5	3.1%	159	100%
HDLコレステロール	25回	137	90.7%	7	4.6%	4	2.6%	1	0.7%	2	1.3%	151	100%
	24回	140	89.7%	6	3.8%	6	3.8%	1	0.6%	3	1.9%	156	100%
	23回	142	89.3%	9	5.7%	4	2.5%	1	0.6%	3	1.9%	159	100%
LDLコレステロール	25回	145	96.0%	1	0.7%	3	2.0%	0	0.0%	2	1.3%	151	100%
	24回	154	98.7%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	156	100%
	23回	154	97.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	3	1.9%	158	100%
HbA1c	25回	143	96.6%	1	0.7%	1	0.7%	1	0.7%	2	1.4%	148	100%
	24回	147	94.8%	1	0.6%	1	0.6%	2	1.3%	4	2.6%	155	100%
	23回	148	94.3%	2	1.3%	4	2.5%	2	1.3%	1	0.6%	157	100%
尿糖	25回	282	84.9%	47	14.2%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	332	100%
	24回	273	80.1%	60	17.6%	2	0.6%	2	0.6%	4	1.2%	341	100%
	23回	277	82.7%	47	14.0%	4	1.2%	2	0.6%	5	1.5%	335	100%
尿蛋白	25回	323	97.3%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	332	100%
	24回	331	97.1%	6	1.8%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	341	100%
	23回	321	95.8%	12	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	335	100%
尿潜血	25回	296	89.2%	31	9.3%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	332	100%
	24回	306	89.7%	34	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	341	100%
	23回	300	89.6%	28	8.4%	5	1.5%	0	0.0%	2	0.6%	335	100%
ヘモグロビン	25回	145	96.0%	0	0.0%	3	2.0%	1	0.7%	2	1.3%	151	100%
	24回	147	93.6%	3	1.9%	2	1.3%	1	0.6%	4	2.5%	157	100%
	23回	150	93.8%	6	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	1	0.6%	160	100%
赤血球	25回	148	98.0%	2	1.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%
	24回	154	98.1%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100%
	23回	156	97.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.9%	160	100%
白血球	25回	150	99.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%
	24回	157	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100%
	23回	158	98.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	160	100%
ヘマトクリット	25回	149	98.7%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%
	24回	157	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	157	100%
	23回	156	97.5%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	3	1.9%	160	100%
血小板	25回	149	98.7%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	151	100%
	24回	152	96.8%	1	0.6%	3	1.9%	0	0.0%	1	0.6%	157	100%
	23回	154	96.3%	1	0.6%	2	1.3%	0	0.0%	3	1.9%	160	100%
平均赤血球容積	25回	146	96.7%	2	1.3%	1	0.7%	0	0.0%	2	1.3%	151	100%
	24回	154	98.1%	2	1.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	157	100%
	23回	153	95.6%	2	1.3%	3	1.9%	0	0.0%	2	1.3%	160	100%

付表１−３　調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設分）

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	25回	203	99.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	24回	198	95.7%	5	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%	207	100%
	23回	200	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	201	100%
中性脂肪	25回	200	97.6%	2	1.0%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	24回	203	98.1%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	207	100%
	23回	195	97.0%	1	0.5%	4	2.0%	1	0.5%	0	0.0%	201	100%
尿酸	25回	195	95.1%	6	2.9%	2	1.0%	2	1.0%	0	0.0%	205	100%
	24回	200	96.6%	4	1.9%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	207	100%
	23回	196	97.5%	3	1.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100%
クレアチニン	25回	202	98.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	24回	202	97.6%	2	1.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	207	100%
	23回	183	91.0%	1	0.5%	3	1.5%	8	4.0%	6	3.0%	201	100%
AST	25回	180	87.8%	5	2.4%	7	3.4%	5	2.4%	8	3.9%	205	100%
	24回	205	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100%
	23回	188	93.5%	1	0.5%	7	3.5%	1	0.5%	4	2.0%	201	100%
ALT	25回	198	96.6%	4	2.0%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	205	100%
	24回	205	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	207	100%
	23回	196	97.5%	4	2.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	201	100%
γ-GT	25回	201	98.0%	2	1.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	24回	202	97.6%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	207	100%
	23回	193	96.0%	5	2.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	201	100%
血糖	25回	199	97.1%	3	1.5%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	205	100%
	24回	202	97.6%	3	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100%
	23回	197	98.0%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.5%	201	100%
HDLコレステロール	25回	192	93.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	12	5.9%	205	100%
	24回	204	98.1%	1	0.5%	2	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	208	100%
	23回	198	98.5%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100%
LDLコレステロール	25回	193	94.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%	205	100%
	24回	208	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100%
	23回	198	98.5%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	201	100%
HbA1c	25回	205	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	206	100%
	24回	205	99.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100%
	23回	198	98.5%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	201	100%
尿糖	25回	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	24回	21	95.5%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100%
	23回	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100%
尿蛋白	25回	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	24回	22	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100%
	23回	24	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100%
尿潜血	25回	21	91.3%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	24回	22	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100%
	23回	24	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100%
ヘモグロビン	25回	200	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	202	100%
	24回	204	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100%
	23回	197	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%
赤血球	25回	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%
	24回	204	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100%
	23回	199	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%
白血球	25回	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%
	24回	204	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100%
	23回	199	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%
ヘマトクリット	25回	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%
	24回	204	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100%
	23回	199	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%
血小板	25回	201	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	202	100%
	24回	199	97.5%	1	0.5%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	204	100%
	23回	198	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%
平均赤血球容積	25回	197	97.5%	2	1.0%	2	1.0%	1	0.5%	0	0.0%	202	100%
	24回	202	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	204	100%
	23回	192	96.5%	7	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	199	100%

付表２－１　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点 測定方法	85点以上 施設数	 構成比	70点以上85点未満 施設数	 構成比	60点以上70点未満 施設数	 構成比	60点未満 施設数	 構成比	合　計 施設数	 構成比
総コレステロール	11	305	94.4%	14	4.3%	2	0.6%	2	0.6%	323	90.7%
	21	32	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	9.0%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	338	94.9%	14	3.9%	2	0.6%	2	0.6%	356	100%
中性脂肪	11	8	88.9%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%
	21	325	93.9%	17	4.9%	4	1.2%	0	0.0%	346	97.2%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	334	93.8%	18	5.1%	4	1.1%	0	0.0%	356	100%
尿酸	31	332	93.5%	16	4.5%	7	2.0%	0	0.0%	355	99.7%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	333	93.5%	16	4.5%	7	2.0%	0	0.0%	356	100%
クレアチニン	21	337	94.9%	16	4.5%	1	0.3%	1	0.3%	355	99.7%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	338	94.9%	16	4.5%	1	0.3%	1	0.3%	356	100%
AST	11	314	88.5%	19	5.4%	8	2.3%	14	3.9%	355	99.7%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	315	88.5%	19	5.3%	8	2.2%	14	3.9%	356	100%
ALT	11	347	97.7%	6	1.7%	0	0.0%	2	0.6%	355	99.7%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	348	97.8%	6	1.7%	0	0.0%	2	0.6%	356	100%
γ-GT	11	335	94.4%	18	5.1%	1	0.3%	1	0.3%	355	99.7%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	336	94.4%	18	5.1%	1	0.3%	1	0.3%	356	100%
血糖	11	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	12	32	91.4%	2	5.7%	1	2.9%	0	0.0%	35	9.8%
	21	293	93.0%	13	4.1%	4	1.3%	5	1.6%	315	88.5%
	31	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	331	93.0%	15	4.2%	5	1.4%	5	1.4%	356	100%
HDLコレステロール	01-0403	164	91.6%	1	0.6%	1	0.6%	13	7.3%	179	50.3%
	01-1201	161	97.6%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	165	46.3%
	01-1301	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-2304	10	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.8%
	08-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	0.3%
	計	336	94.4%	5	1.4%	1	0.3%	14	3.9%	356	100%
LDLコレステロール	01-0403	165	92.2%	1	0.6%	0	0.0%	13	7.3%	179	50.3%
	01-1201	161	98.8%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	163	45.8%
	01-1301	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-1302	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	01-2302	11	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.1%
	01-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	0.3%
	計	339	95.2%	3	0.8%	0	0.0%	14	3.9%	356	100%
HbA1c	01-2701	24	96.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.1%
	01-2901	69	97.2%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	71	20.1%
	02-0401	73	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	20.6%
	02-0402	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	02-0403	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	02-0404	26	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	7.3%
	02-2401	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	03-0401	65	98.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	66	18.6%
	03-1201	9	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.5%
	03-2701	36	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	10.2%
	03-3501	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	350	98.9%	1	0.3%	1	0.3%	2	0.6%	354	100%

付表２－１　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿糖	1	149	91.4%	12	7.4%	0	0.0%	2	1.2%	163	45.9%
	2	188	97.9%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	192	54.1%
	計	337	94.9%	16	4.5%	0	0.0%	2	0.6%	355	100%
尿蛋白	1	159	98.1%	2	1.2%	0	0.0%	1	0.6%	162	45.6%
	2	193	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	193	54.4%
	計	352	99.2%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	355	100%
尿潜血	1	161	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	162	45.6%
	2	189	97.9%	2	1.0%	0	0.0%	2	1.0%	193	54.4%
	計	350	98.6%	3	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	355	100%
ヘモグロビン	1	7	77.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	11.1%	9	2.5%
	2	332	98.2%	3	0.9%	1	0.3%	2	0.6%	338	95.8%
	9	6	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%
	計	345	97.7%	4	1.1%	1	0.3%	3	0.8%	353	100%
赤血球	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	262	99.6%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	263	74.5%
	JAB514	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	JAB517	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	12.7%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ011	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	計	352	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%
白血球	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	263	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	263	74.5%
	JAB514	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	JAB517	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	12.7%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ011	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	計	353	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%

付表２－１　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
ヘマトクリット	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	263	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	263	74.5%
	JAB514	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	JAB517	45	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	45	12.7%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ011	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	計	353	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	353	100%
血小板	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	262	99.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	263	74.5%
	JAB514	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	JAB517	44	97.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	45	12.7%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ011	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	計	351	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	353	100%
平均赤血球容積	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%
	JAB512	259	98.5%	3	1.1%	1	0.4%	0	0.0%	263	74.5%
	JAB514	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.5%
	JAB517	43	95.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	45	12.7%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAJ011	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.1%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	計	347	98.3%	3	0.8%	1	0.3%	2	0.6%	353	100%

付表２－２　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点 測定方法	85点以上 施設数	構成比	70点以上85点未満 施設数	構成比	60点以上70点未満 施設数	構成比	60点未満 施設数	構成比	合　計 施設数	構成比
総コレステロール	11	124	88.6%	12	8.6%	2	1.4%	2	1.4%	140	92.7%
	21	10	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	6.6%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	135	89.4%	12	7.9%	2	1.3%	2	1.3%	151	100%
中性脂肪	11	7	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.6%
	21	126	88.1%	13	9.1%	4	2.8%	0	0.0%	143	94.7%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	134	88.7%	13	8.6%	4	2.6%	0	0.0%	151	100%
尿酸	31	134	89.3%	11	7.3%	5	3.3%	0	0.0%	150	99.3%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	135	89.4%	11	7.3%	5	3.3%	0	0.0%	151	100%
クレアチニン	21	134	89.3%	14	9.3%	1	0.7%	1	0.7%	150	99.3%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	135	89.4%	14	9.3%	1	0.7%	1	0.7%	151	100%
AST	11	133	88.7%	8	5.3%	3	2.0%	6	4.0%	150	99.3%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	134	88.7%	8	5.3%	3	2.0%	6	4.0%	151	100%
ALT	11	147	98.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.7%	150	99.3%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	148	98.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	0.7%	151	100%
γ-GT	11	133	88.7%	15	10.0%	1	0.7%	1	0.7%	150	99.3%
	85	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	134	88.7%	15	9.9%	1	0.7%	1	0.7%	151	100%
血糖	11	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	12	27	90.0%	2	6.7%	1	3.3%	0	0.0%	30	19.9%
	21	97	84.3%	11	9.6%	3	2.6%	4	3.5%	115	76.2%
	31	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.6%
	81	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	130	86.1%	13	8.6%	4	2.6%	4	2.6%	151	100%
HDLコレステロール	01-0403	75	96.2%	1	1.3%	1	1.3%	1	1.3%	78	51.7%
	01-1201	60	95.2%	3	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	63	41.7%
	01-1301	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	01-2304	8	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.3%
	08-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	0.7%
	計	144	95.4%	4	2.6%	1	0.7%	2	1.3%	151	100%
LDLコレステロール	01-0403	76	97.4%	1	1.3%	0	0.0%	1	1.3%	78	51.7%
	01-1201	59	96.7%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	61	40.4%
	01-1301	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	01-1302	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	01-2302	9	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	6.0%
	01-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100%	1	0.7%
	計	146	96.7%	3	2.0%	0	0.0%	2	1.3%	151	100%
HbA1c	01-2701	20	95.2%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	21	14.2%
	01-2901	62	96.9%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.6%	64	43.2%
	02-0401	6	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.1%
	02-0402	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	02-0403	6	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.1%
	02-0404	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	14.2%
	02-2401	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	03-0401	12	92.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	13	8.8%
	03-1201	9	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	6.1%
	03-2701	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	03-3501	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	計	144	97.3%	1	0.7%	1	0.7%	2	1.4%	148	100%

付表２−２　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿糖	1	149	91.4%	12	7.4%	0	0.0%	2	1.2%	163	49.1%
	2	165	97.6%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	169	50.9%
	計	314	94.6%	16	4.8%	0	0.0%	2	0.6%	332	100%
尿蛋白	1	159	98.1%	2	1.2%	0	0.0%	1	0.6%	162	48.8%
	2	170	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	170	51.2%
	計	329	99.1%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	332	100%
尿潜血	1	161	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	162	48.8%
	2	166	97.6%	2	1.2%	0	0.0%	2	1.2%	170	51.2%
	計	327	98.5%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	332	100%
ヘモグロビン	1	5	71.4%	1	14.3%	0	0.0%	1	14.3%	7	4.6%
	2	136	97.1%	2	1.4%	1	0.7%	1	0.7%	140	92.7%
	9	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.6%
	計	145	96.0%	3	2.0%	1	0.7%	2	1.3%	151	100%
赤血球	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAB512	78	98.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	79	52.3%
	JAB514	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.9%
	JAB517	33	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	21.9%
	JAB519	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAJ011	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.3%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	計	150	99.3%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%
白血球	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAB512	79	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	52.3%
	JAB514	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.9%
	JAB517	33	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	21.9%
	JAB519	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAJ011	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.3%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	計	151	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%

付表２−２　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
ヘマトクリット	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAB512	79	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	52.3%
	JAB514	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.9%
	JAB517	33	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	21.9%
	JAB519	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAJ011	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.3%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	計	151	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	151	100%
血小板	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAB512	79	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	79	52.3%
	JAB514	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.9%
	JAB517	32	97.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	33	21.9%
	JAB519	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAJ011	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.3%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	計	150	99.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	151	100%
平均赤血球容積	JAA702	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAB511	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAB512	78	98.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	79	52.3%
	JAB514	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	13.9%
	JAB517	31	93.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.1%	33	21.9%
	JAB519	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAC910	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAJ011	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.0%
	JAJ012	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.3%
	JAJ803	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	JAR409	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%
	計	148	98.0%	1	0.7%	0	0.0%	2	1.3%	151	100%

付表２－３　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目	得点 測定方法	85点以上 施設数	 構成比	70点以上85点未満 施設数	 構成比	60点以上70点未満 施設数	 構成比	60点未満 施設数	 構成比	合　計 施設数	 構成比
総コレステロール	11	181	98.9%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	183	89.3%
	21	22	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	10.7%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	203	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
中性脂肪	11	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	21	199	98.0%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	203	99.0%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	200	97.6%	5	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
尿酸	31	198	96.6%	5	2.4%	2	1.0%	0	0.0%	205	100%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	198	96.6%	5	2.4%	2	1.0%	0	0.0%	205	100%
クレアチニン	21	203	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	203	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
AST	11	181	88.3%	11	5.4%	5	2.4%	8	3.9%	205	100%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	181	88.3%	11	5.4%	5	2.4%	8	3.9%	205	100%
ALT	11	200	97.6%	4	2.0%	0	0.0%	1	0.5%	205	100%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	200	97.6%	4	2.0%	0	0.0%	1	0.5%	205	100%
γ-GT	11	202	98.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
	85	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	202	98.5%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	205	100%
血糖	11	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	12	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.4%
	21	196	98.0%	2	1.0%	1	0.5%	1	0.5%	200	97.6%
	31	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	81	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	201	98.0%	2	1.0%	1	0.5%	1	0.5%	205	100%
HDLコレステロール	01-0403	89	88.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	11.9%	101	49.3%
	01-1201	101	99.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	49.8%
	01-1301	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-2304	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	08-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	192	93.7%	1	0.5%	0	0.0%	12	5.9%	205	100%
LDLコレステロール	01-0403	89	88.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	11.9%	101	49.3%
	01-1201	102	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	49.8%
	01-1301	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-1302	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	01-2302	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	01-2801	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	193	94.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%	205	100%
HbA1c	01-2701	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.9%
	01-2901	7	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.4%
	02-0401	67	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	32.5%
	02-0402	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	02-0403	17	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	8.3%
	02-0404	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	2.4%
	02-2401	20	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	9.7%
	03-0401	53	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	25.7%
	03-1201	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03-2701	33	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	16.0%
	03-3501	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	206	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	206	100%

付表２−３　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目	得点 測定方法	85点以上 施設数	構成比	70点以上85点未満 施設数	構成比	60点以上70点未満 施設数	構成比	60点未満 施設数	構成比	合　計 施設数	構成比
尿糖	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	計	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
尿蛋白	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	計	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
尿潜血	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
	計	23	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100%
ヘモグロビン	1	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	2	196	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	198	98.0%
	9	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	計	200	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	202	100%
赤血球	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	184	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	91.1%
	JAB514	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB517	12	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAC910	0	0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%
白血球	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	184	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	91.1%
	JAB514	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB517	12	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%

付表２−３　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（外部施設）

調査項目	得点 測定方法	85点以上 施設数	 構成比	70点以上85点未満 施設数	 構成比	60点以上70点未満 施設数	 構成比	60点未満 施設数	 構成比	合　計 施設数	 構成比
ヘマトクリット	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	184	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	184	91.1%
	JAB514	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB517	12	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	202	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	202	100%
血小板	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	183	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	184	91.1%
	JAB514	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB517	12	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	201	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	202	100%
平均赤血球容積	JAA702	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB511	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAB512	181	98.4%	2	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	184	91.1%
	JAB514	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAB517	12	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	5.9%
	JAB519	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAC910	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ011	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	JAJ012	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAJ803	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAR408	2	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
	JAR409	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	199	98.5%	2	1.0%	1	0.5%	0	0.0%	202	100%

付表３－１　尿糖検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
試験紙法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
目視判定	02	68	90.7%	7	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	75	46.0%
	07	6	85.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.3%
	22	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	29	25	92.6%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	27	16.6%
	32	15	93.8%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	9.8%
	60	3	60.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	3.1%
	61	31	96.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	32	19.6%
	合計	149	91.4%	12	7.4%	0	0.0%	2	1.2%	163	100%
機器判定	02	131	98.5%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	133	69.3%
	09	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
	29	20	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	10.4%
	32	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	38	30	93.8%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	32	16.7%
	合計	188	97.9%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	192	100%

付表３－２　尿蛋白検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
試験紙法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
目視判定	02	73	97.3%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	75	46.3%
	07	7	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.3%
	22	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	29	26	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	16.0%
	32	16	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	9.9%
	60	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.1%
	61	31	96.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	32	19.8%
	合計	159	98.1%	2	1.2%	0	0.0%	1	0.6%	162	100%
機器判定	02	133	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	133	68.9%
	09	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
	29	21	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	10.9%
	32	3	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	38	32	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	16.6%
	合計	193	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	193	100%

付表３－３　尿潜血検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
試験紙法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
目視判定	02	73	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	73	45.1%
	07	7	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	4.3%
	22	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	29	28	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	17.3%
	32	15	93.8%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	9.9%
	60	5	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.1%
	61	31	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	19.1%
	62	1	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%
	合計	161	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	162	100%
機器判定	02	133	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	133	68.9%
	09	4	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.1%
	29	18	85.7%	1	4.8%	0	0.0%	2	9.5%	21	10.9%
	32	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	1.6%
	38	32	100%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	16.6%
	合計	189	97.9%	2	1.0%	0	0.0%	2	1.0%	193	100%

第25回臨床検査精度管理調査

調査項目総合評価点一覧

付表４

注）項目の※表示は測定を外部機関に委託
注）同測定法、同測定機器5施設以下も評価

付表４　臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
01001	80	90	96.7	100	----	100	96.7	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.9
01002	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.7
01007	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
01013	100	80	100	86.7	----	100	100	66.7	85.7	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	94.7
01018	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
01019	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
01023	83.3	100	100	96.7	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
01025	100	100	96.7	100	----	100	100	93.3	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.7
01027	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
02001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
02003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	92	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
02004	83.3	90	80	86.7	----	100	80	56.7	100	100	78.6	88	100	76	100	100	100	100	100	100	90.0
03001	96.7	73.3	93.3	100	----	93.3	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	97.4
03004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	88	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
03006	96.7	63.3	100	96.7	----	100	96.7	100	78.6	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	96.0
04001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
04004	100	100	100	100	----	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
04006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
04008	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
04009	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
04010	100	93.3	93.3	93.3	----	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.5
04012	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
04015	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
06001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
06004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
07002	100	96.7	93.3	93.3	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
07004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	88	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
07007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
07008	96.7	100	76.7	100	----	100	100	100	100	100	100	96	100	92	100	100	100	100	100	100	97.9
08001	90	76.7	100	66.7	----	100	100	100	85.7	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	95.1
08002	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
08003	100	93.3	100	100	----	100	96.7	73.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.0
08006	100	93.3	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	99.0

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料 平　均
08009	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	99.6
08010	93.3	100	96.7	100	----	100	100	96.7	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
09001	93.3	93.3	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.3
09004	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
09005	93.3	100	100	73.3	----	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	97.7
09007	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
09008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
09009	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
09010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
09011	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
09012	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
09013	96.7	86.7	93.3	83.3	----	100	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	100	97.1
09014	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 86.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.1
09016	100	100	93.3	100	----	100	100	93.3	100	92.9		92	100	100							97.6
10001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
10002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
10003	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	96	88	100	100	100	100	100	100	99.1
10004	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	99.6
10005	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
10007	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11002	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
11004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 70	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
11005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ ----	※ 80	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.8
11006	100	100	100	96.7	----	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
11007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
11010	100	100	100	100	----	100	96.7	76.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.5
11011	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11016	100	100	100	100	----	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
11020	100	100	100	100	----	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	99.6
11021	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 86.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.9
11023	100	100	93.3	100	----	100	100	86.7	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	98.7
11025	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 80	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
12001	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12002	100	100	93.3	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	99.2
12003	※ 100	※ 96.7	※ 93.3	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 50	※ 0	※ 0	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	85.2

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料 平　均
12006	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
12008	100	90	100	93.3	----	100	83.3	93.3	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	97.6
12010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
12011	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
12012	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
12013	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
12014	※ 90	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ ----	※ 36.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.3
12015	※ 100	※ 93.3	※ 83.3	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	92	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.4
12016	93.3	100	100	100	----	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
12018	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13001	※ 100	※ 90	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
13002	100	100	100	100	----	100	100	93.3	100	100	100	100	100	96	100	92.9	100	100	100	100	99.0
13003	93.3	100	100	100	----	100	90	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	98.6
13004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
13005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
13006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	20	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.7
13010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
13013	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
13014	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	72	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	96.9
13015	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
13016	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100				※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13017	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13021	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13024	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13026	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13033	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13035	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
13036	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 90	※ 0	※ 0	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.1
13038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13039	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13045	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
13049	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ−GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
13051	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13052	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13053	100	100	100	93.3	----	73.3	100	93.3	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	97.3
13055	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13056	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 93.3	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	72	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	96.5
13061	93.3	100	100	100	----	100	86.7	73.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	97.4
13063	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	92	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.6
13064	100	100	100	100	----	100	100	100	92.9	100	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.8
13067	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
13071	※ 70	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.9
13074	100	100	90	100	----	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
13077	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13078	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 0	※ 0	※ 100	92	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.2
13079	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13080	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	80	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98
13082	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
13083	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
13084	93.3	100	100	100	----	100	93.3	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
13088	※ 100	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.6
13089	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13090	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
13094	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13095	100	100	100	100	----	100	100	73.3	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	98.3
13100	100	100	100	100	----	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
13101	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13103	100	100	96.7	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
13107	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
13108	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	100							98.7
13109	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
13115	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
14001	100	96.7	100	93.3	----	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
14002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
14003	100	93.3	100	100	----	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
14004	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.3
14005	※ 100	※ 100	※ 70	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 78.6	※ 100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.7

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料 平　均
14006	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 0	※ 0	※ 100	96	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.5
14007	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
14010	93.3	100	100	100	----	100	100	96.7	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88.3
14018	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
14022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	99.0
14023	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 90	※ 0	※ 0	※ 100	88	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	86.8
14024	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	99.1
14025	83.3	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	96.3
14026	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	88	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.3
14027	100	100	93.3	100	----	100	73.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.1
14029	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ ----	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.3
14030	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100
15001	100	96.7	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
15004	100	100	100	83.3	----	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	92.9	100	85.7	100	78.6	97.7
15006	93.3	100	100	83.3	----	100	100	100	71.4	92.9	92.9	100	100	92	100	100	100	100	100	100	95.9
15007	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
15008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
15010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	72	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
15011	100	100	93.3	100	----	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
15012	100	100	93.3	93.3	----	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95.9
16002	100	100	93.3	93.3	----	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	99.1
16004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
16005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 0	※ 0	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88.7
16006	100	86.7	100	100	----	100	80	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.8
16008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
17001	100	100	96.7	100	----	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.3
17003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 90	※ 96.7	※ 92.9	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	98.2
18001	100	100	100	100	----	100	100	96.7	100	100	100	100	96	96	100	100	100	100	100	100	99.4
18003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
20001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 0	※ 0	※ 100	92	88	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.2
20002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
20003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
20004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
20005	100	100	93.3	93.3	----	100	96.7	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	98.4
20007	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料 平　均
21001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
21002	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21004	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.3
21005	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21006	96.7	100	66.7	100	----	90	96.7	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.5
22001	66.7	86.7	100	100	----	100	100	96.7	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	96.6
22002	100	100	93.3	96.7	----	100	100	73.3	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	97.7
22003	100	100	100	100	----	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
22004	83.3	83.3	66.7	100	----	76.7	76.7	86.7	92.9	100	100	100	100	72	100	100	100	100	100	100	91.0
22006	100	100	83.3	100	----	100	93.3	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.0
22007	※ 90	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
22010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 90	※ 0	※ 0	※ 100	96	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.4
22011	100	100	93.3	100	----	100	100	83.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.7
22012	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22015	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 90	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.2
22017	100	100	100	100	----	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	78.6	100	100	100	100	100	98.4
22018	66.7	93.3	100	93.3	----	86.7	93.3	50	64.3	100	92.9	100	100	96	100	100	100	100	100	100	90.9
22019	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 0	※ 0	※ 100	92	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.2
22023	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23001	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 78.6	99.2
23002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23003	73.3	90	73.3	96.7	----	100	100	66.7	92.9	85.7	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	92.9
23005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
23006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
23008	100	93.3	100	73.3	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	97.8
23009	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
23011	100	100	100	100	----	100	96.7	100	100	100	100	100	100	88	92.9	100	100	100	100	100	98.8
23012	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
23015	100	90	100	100	----	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.3
23016	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23017	100	100	100	100	----	93.3	100	100	100	100	92.9	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.0
23018	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
23019	100	100	100	93.3	----	100	100	100	100	100		100	100	100	92.9	92.9	100	100	100	50	93.3
23020	100	76.7	76.7	100	----	100	93.3	60	100	100	100	100	100	100	100	71.4	100	85.7	100	92.9	92.4

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST(GOT)	ALT(GPT)	γ－GT	血糖	HDLコレステロール	LDLコレステロール	HbA1c	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
23022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 0	※ 0	※ 100	100	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.4
23024	100	93.3	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
23026	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23029	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	※ 100	100	92	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
23030	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23032	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
23037	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23039	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
23040	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
23042	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
24001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
24002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
24003	100	100	63.3	93.3	----	100	100	53.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95
25001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
25002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
25003	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26001	100	93.3	100	100	----	100	86.7	76.7	85.7	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	96.4
26002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
26003	100	100	100	100	----	96.7	100	93.3	85.7	100	85.7	96	100	100	100	100	100	100	100	92.9	97.6
26005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.6
26006	100	96.7	100	93.3	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
26009	100	100	100	93.3	----	93.3	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
26012	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
27001	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	98.8
27002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
27003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
27004	100	66.7	83.3	83.3	----	100	83.3	100	78.6	100	100	100	100	100	71.4	100	100	100	100	100	92.6
27005	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
27006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
27007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	88	96	※ 71.4	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.5
27009	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
27010	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
27013	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	57.1	100	100	100	100	100	97.6
27014	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST(GOT)	ALT(GPT)	γ－GT	血糖	HDLコレステロール	LDLコレステロール	HbA1c	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
27018	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
27020	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27023	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 50	※ 92.9	95.5
27031	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 64.3	99.4
27037	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
27038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
27041	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
27042	※ 100	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
27044	100	66.7	100	93.3	----	100	100	86.7	100	78.6	92.9	96	100	100	100	100	100	100	100	100	95.2
27045	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
27046	100	93.3	100	100	----	96.7	73.3	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	97.7
27048	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
27049	73.3	66.7	63.3	80	----	100	93.3	80	100	100	28.6	100	100	100	42.9	100	100	100	100	100	84.9
27051	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
27052	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
27061	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
28001	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	88	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	97.5
28002	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	57.1	100
28003	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28007	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
28008	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 71.4	99.4
28011	96.7	100	93.3	80	----	96.7	100	83.3	100	100	100	100	100	100	64.3	100	100	100	100	100	95.2
28014	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
28015	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
28016	100	80	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	98.7
28017	100	83.3	100	96.7	----	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	98.7
28018	※ 90	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.8
28019	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	16	36	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	91.6
28022	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
28024	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 0	※ 0	※ 100	88	100	100							83.7
28029	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
28031	100	93.3	100	96.7	----	90	70	96.7	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.6
28033	100	100	100	100	----	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
28034	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
30004	80	100	100	100	----	100	100	16.7	100	92.9	100	84	100	100	78.6	85.7	100	100	85.7	100	90.2

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ−GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
30005	100	96.7	100	100	----	93.3	90	100	100	100	100	96	100	92	100	100	100	100	100	100	98.2
30006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
31002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
31003	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
31005	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	99.3
32001	80	86.7	100	100	----	90	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	96.1
32002	100	100	100	100	----	100	96.7	100	85.7	100	64.3	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	96.6
33001	100	100	100	100	----	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
33002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
33004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
33005	93.3	100	86.7	93.3	----	100	76.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.2
33008	86.7	86.7	100	86.7	----	100	100	73.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.3
33009	76.7	86.7	100	93.3	----	100	63.3	73.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94.1
33014	※ 100	※ 83.3	※ 66.7	※ 100	※ ----	※ 76.7	※ 73.3	※ 73.3	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92.6
34001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
34002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
34003	※ 100	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	98.8
34004	100	93.3	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	99.4
34005	※ 100	※ 100	※ 73.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.1
34009	100	76.7	93.3	100	----	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.9
34010	100	73.3	83.3	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.6
34011	53.3	73.3	73.3	76.7	----	100	93.3	63.3	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	90.3
34012	40	83.3	83.3	86.7	----	93.3	100	100	100	100	100	100	100	88	100	100	100	100	100	100	93.0
34013	※ 100	※ 100	※ 66.7	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.5
34015	100	100	70	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.3
35001	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	96	92	100	100	100	100	100	100	99.3
35006	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 80	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	88	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.3
36002	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
37001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	98.3
37004	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
37005	86.7	100	100	100	----	86.7	70	93.3	100	100	92.9	100	100	88	100	100	100	100	100	100	95.4
37007	83.3	100	93.3	100	----	100	93.3	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	97.4
38004	86.7	76.7	93.3	76.7	----	93.3	90	100	92.9	100	100	100	100	92	92.9	100	92.9	100	100	100	93.7
38006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
38009	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 0	※ 0	※ 100	100	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	87.4

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ−GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ヘマトクリット	血小板	平均赤血球容積	全試料平均
39001	100	100	100	43.3	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.9
39002	76.7	93.3	100	93.3	----	100	96.7	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.4
39003	100	100	96.7	100	----	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.4
39004	100	80	66.7	100	----	90	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95.4
40001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.6
40002	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
40004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
40005	100	100	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
40007	100	93.3	100	100	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
40009	100	100	100	83.3	----	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.7
40011	100	100	100	100	----	100	100	100	100	78.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.8
40013	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ ----	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
40015	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
40021	86.7	100	93.3	93.3	----	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	98.5
40022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
40025	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
40026	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
40027	100	100	100	96.7	----	100	76.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.5
40028	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
40029	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	76	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
40030	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	56	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.9
40031	※ 100	※ 80	※ 93.3	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.6
40034	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
40035	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
41001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
41002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	98.9
42001	※ 100	※ 90	※ 100	※ 96.7	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
42002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
43001	96.7	100	100	100	----	100	83.3	100	100	100	92.9	100	100	96	100	100	100	100	100	100	98.3
43003	93.3	100	100	90	----	93.3	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.1
43004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 80	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
43007	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 60	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	56	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.6
44001	100	100	100	100	----	100	100	100	0	0	100	88	100	88	100	100	100	100	100	100	87.6
44002	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6

施設 ｺｰﾄﾞ	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	HbA1c	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	ヘモグロビン	赤血球	白血球	ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ	血小板	平均赤血球容積	全試料 平　均
45002	93.3	100	100	93.3	----	100	90	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	98.3
46001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ ----	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
46004	93.3	100	100	100	----	100	83.3	96.7	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.1
47001	100	100	93.3	86.7	----	100	100	100	85.7	71.4	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	96.1
47004	100	90	100	83.3	----	100	33.3	100	100	100	100	96	100	88	100	100	100	100	100	100	93.9
47005	100	100	80	96.7	----	100	100	93.3	71.4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.7
47006	100	100	100	73.3	----	100	76.7	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.8
48512	100	100	93.3	83.3	----	100	96.7	93.3	92.9	100	100	92	100	88	100	100	100	100	100	100	96.6

第25回臨床検査精度管理調査

自施設測定施設評価結果

測定評価結果一覧

・測定値評価
・解析値評価点
・総合評価点

[1]総コレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	80	98	-----	-----	150	172	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	60.0	80.0
01013	11	-----	96	116	-----	149	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01018	11	-----	96	115	135	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	11	80	97	-----	138	-----	171	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	66.7	83.3
01025	11	78	-----	117	-----	149	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	78	-----	117	-----	151	169	191	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	66.7	83.3
03001	11	76	96	-----	136	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
03006	11	78	-----	117	-----	150	170	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
04004	21	77	96	-----	134	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	77	-----	115	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	11	77	97	-----	135	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04015	11	-----	97	115	-----	148	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	11	78	98	-----	-----	149	167	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
07008	11	-----	98	117	137	-----	170	-----	208	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
08001	11	75	-----	113	133	-----	-----	184	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
08003	11	-----	96	116	-----	148	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08006	11	76	96	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	11	78	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	11	77	96	-----	-----	148	168	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
09001	11	78	-----	118	-----	151	169	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
09005	11	77	97	-----	-----	149	169	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
09012	11	77	97	-----	-----	149	168	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	11	79	-----	117	137	-----	-----	189	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
09016	11	-----	98	117	-----	149	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10003	11	78	96	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	11	78	98	-----	-----	149	169	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	11	-----	96	116	-----	148	-----	187	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	21	-----	97	116	135	-----	168	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	11	77	97	-----	-----	148	166	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11010	11	79	97	-----	137	-----	167	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11011	11	77	-----	115	-----	147	166	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	11	78	97	-----	-----	149	168	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	11	-----	97	117	-----	149	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	11	77	-----	115	134	-----	-----	185	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12001	11	76	-----	115	-----	147	166	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	11	78	-----	116	-----	149	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	11	-----	95	114	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12016	11	79	-----	116	135	-----	-----	185	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
13002	11	-----	96	116	136	-----	169	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	11	-----	94	114	-----	146	-----	183	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
13017	11	78	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	21	78	97	-----	135	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	11	77	96	-----	-----	148	168	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13061	11	-----	96	114	135	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13064	11	-----	96	116	-----	149	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	21	78	-----	116	-----	148	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13084	11	77	97	-----	136	-----	170	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
13094	11	-----	97	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	11	-----	97	117	-----	148	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	21	78	-----	116	-----	147	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	11	77	96	-----	-----	147	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	11	-----	97	116	-----	149	-----	188	208	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[1]総コレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	11	-----	97	117	-----	150	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14010	11	-----	96	118	135	-----	169	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
14025	11	78	97	-----	-----	146	167	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100	66.7	83.3
14027	11	-----	95	115	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14030	11	77	-----	115	-----	146	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	11	77	-----	115	134	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	11	77	-----	116	-----	147	166	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	11	-----	94	114	136	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
15011	11	78	-----	116	136	-----	-----	188	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	11	77	-----	116	-----	148	166	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	11	-----	95	113	134	-----	166	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16006	11	75	-----	114	134	-----	-----	186	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
17001	11	77	96	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
18001	11	79	97	-----	136	-----	168	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	11	77	97	-----	134	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20007	11	78	97	-----	135	-----	168	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	11	78	-----	116	-----	149	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	78	97	-----	-----	149	168	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	11	77	95	-----	133	-----	164	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
22001	11	76	-----	114	-----	144	163	182	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	33.3	66.7
22002	11	77	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	-----	95	114	134	-----	166	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	11	-----	100	119	-----	151	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3
22006	11	78	98	-----	-----	149	168	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22011	11	78	98	-----	137	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	-----	97	116	136	-----	168	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	11	78	96	-----	-----	148	167	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	11	79	99	-----	-----	151	172	-----	212	A	A	--	--	A	A	--	A	100	33.3	66.7
23003	11	78	95	-----	134	-----	163	182	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	46.7	73.3
23008	11	78	98	-----	136	-----	169	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23011	11	-----	97	115	-----	148	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	11	77	-----	115	-----	147	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23016	11	78	-----	116	136	-----	-----	188	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	11	78	-----	117	137	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	11	78	97	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	21	77	-----	114	-----	148	166	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23024	21	77	96	-----	-----	147	166	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	11	-----	96	115	-----	147	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	11	78	97	-----	136	-----	169	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25003	11	-----	97	116	-----	148	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	97	116	-----	147	-----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26003	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26006	11	77	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26009	21	77	96	-----	-----	146	165	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27004	11	77	96	-----	-----	147	165	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27013	21	-----	96	116	-----	147	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	11	77	96	-----	-----	149	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	11	78	97	-----	135	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	-----	97	117	136	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27046	11	79	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27049	11	-----	95	111	133	-----	163	-----	202	--	A	B	A	--	A	--	A	93.3	53.3	73.3
28002	11	-----	97	116	136	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	-----	95	114	-----	147	-----	187	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[1]総コレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28011	11	76	95	-----	-----	146	165	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
28016	11	78	-----	117	-----	151	168	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	78	-----	115	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28031	11	77	-----	115	-----	147	165	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28033	11	77	96	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	11	-----	96	115	-----	148	-----	186	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	11	78	-----	117	-----	151	171	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
30005	11	-----	95	115	134	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
31005	11	-----	96	116	-----	148	-----	187	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	11	76	95	-----	133	-----	164	182	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	60.0	80.0
32002	11	-----	97	116	-----	149	-----	186	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	11	-----	98	116	135	-----	168	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	11	76	-----	114	133	-----	-----	183	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
33008	11	-----	97	115	134	-----	165	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
33009	11	74	93	-----	131	-----	162	182	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	60.0	76.7
34004	11	78	97	-----	-----	148	168	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	11	77	-----	115	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34010	11	76	95	-----	134	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34011	11	-----	94	114	-----	146	-----	180	198	--	A	A	--	A	--	A	A	100	6.7	53.3
34012	11	77	96	-----	135	-----	108	187	-----	A	A	--	A	--	D	A	--	80.0	0.0	40.0
34015	11	79	98	-----	137	-----	168	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	11	78	97	-----	136	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	11	-----	95	113	132	-----	163	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
37007	11	-----	95	114	133	-----	164	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100	66.7	83.3
38004	11	76	-----	113	132	-----	-----	183	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
39001	11	76	95	-----	134	-----	166	184	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	11	74	-----	112	131	-----	-----	183	202	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	60.0	76.7
39003	11	78	-----	116	136	-----	-----	188	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39004	11	78	-----	116	-----	147	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40005	11	77	97	-----	135	-----	168	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	11	77	95	-----	-----	146	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	11	78	97	-----	-----	148	165	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40011	11	76	95	-----	133	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	11	78	-----	118	-----	151	170	190	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
40027	11	78	-----	117	-----	149	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
43001	11	-----	95	115	-----	146	-----	183	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
43003	11	76	-----	113	134	-----	-----	183	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
44001	81	-----	93	110	-----	145	-----	184	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	11	-----	98	118	137	-----	169	-----	209	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
46004	11	79	98	-----	138	-----	170	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
47001	11	78	-----	117	136	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47004	11	-----	95	115	134	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
47005	11	78	-----	115	135	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47006	21	78	97	-----	-----	148	168	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
48512	11	-----	96	116	-----	148	-----	185	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[2]中性脂肪　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	53	66	-----	-----	99	110	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	80.0	90.0
01013	21	-----	65	75	-----	96	-----	119	131	--	A	A	--	A	--	A	A	100	60.0	80.0
01018	21	-----	66	79	91	-----	112	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	21	53	65	-----	90	-----	109	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
01025	21	53	-----	78	-----	97	110	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	21	54	-----	78	-----	100	113	126	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
03001	21	50	61	-----	86	-----	107	118	-----	B	B	--	A	--	A	A	--	86.7	60.0	73.3
03006	21	54	-----	80	-----	102	116	127	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	26.7	63.3
04004	11	53	66	-----	90	-----	111	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	21	54	-----	78	-----	98	110	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	21	53	65	-----	89	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	21	-----	65	78	90	-----	112	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
04015	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	21	51	64	-----	-----	96	109	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
07008	21	-----	66	78	91	-----	112	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08001	21	52	-----	75	86	-----	-----	119	132	A	--	A	A	--	--	A	A	100	53.3	76.7
08003	21	-----	64	76	-----	96	-----	120	132	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
08006	21	52	64	-----	88	-----	108	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
08009	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	21	53	66	-----	-----	98	110	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09001	21	53	-----	79	-----	100	113	125	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
09005	21	54	66	-----	-----	100	112	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09012	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	11	54	-----	77	90	-----	-----	125	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
09016	21	-----	66	78	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10003	21	53	65	-----	90	-----	110	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	21	-----	66	78	-----	99	-----	124	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	21	-----	64	77	89	-----	110	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	21	53	65	-----	-----	98	110	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11010	21	53	65	-----	89	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11011	21	53	-----	77	-----	99	111	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	21	54	66	-----	-----	98	110	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	21	-----	66	78	-----	98	-----	122	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	21	53	-----	78	91	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12001	21	53	-----	77	-----	98	110	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	21	53	-----	77	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	21	-----	64	77	-----	97	-----	120	131	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
12016	21	53	-----	78	91	-----	-----	124	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13002	21	-----	64	76	89	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	21	-----	64	77	-----	96	-----	121	132	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13017	21	54	66	-----	91	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	21	53	65	-----	90	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	21	52	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13061	11	-----	66	78	91	-----	113	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	21	-----	65	77	-----	98	-----	122	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	21	53	-----	78	-----	99	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13084	21	52	64	-----	89	-----	110	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13094	21	-----	65	77	90	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	21	53	-----	79	-----	100	113	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	11	53	66	-----	-----	98	110	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	21	-----	65	77	-----	99	-----	121	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7

[2]中性脂肪　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	21	-----	65	78	-----	100	-----	125	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14010	21	-----	66	79	91	-----	112	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14025	21	53	66	-----	-----	98	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	21	-----	65	76	-----	97	-----	122	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14030	21	53	-----	77	-----	97	110	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	21	53	-----	76	90	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
15004	21	53	-----	78	-----	98	110	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	21	-----	64	76	88	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
15011	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	21	52	-----	76	-----	97	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	21	-----	64	77	89	-----	108	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16006	21	52	-----	75	87	-----	-----	120	132	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
17001	21	53	65	-----	-----	98	112	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
18001	21	53	66	-----	91	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	11	53	65	-----	89	-----	111	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20007	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	21	53	-----	77	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	53	65	-----	-----	99	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	21	53	66	-----	90	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22001	21	52	-----	76	-----	96	107	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
22002	21	52	-----	76	89	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	21	-----	65	77	89	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	21	-----	68	81	-----	100	-----	124	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3
22006	21	53	67	-----	-----	99	112	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22011	21	53	66	-----	91	-----	112	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	21	-----	65	77	89	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	21	53	66	-----	-----	99	112	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	21	52	65	-----	-----	96	109	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23003	21	56	66	-----	91	-----	112	123	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
23008	21	53	66	-----	91	-----	113	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
23011	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	21	53	-----	75	-----	96	110	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
23016	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	21	54	-----	78	90	-----	-----	123	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	21	53	66	-----	91	-----	112	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	21	50	-----	75	-----	95	107	120	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
23024	21	54	66	-----	-----	99	110	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23029	21	-----	64	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	21	53	65	-----	91	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25003	21	-----	65	78	-----	97	-----	122	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	66	78	-----	99	-----	122	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
26003	21	-----	65	78	90	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26006	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	133	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
26009	21	53	65	-----	-----	99	111	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27004	21	52	63	-----	-----	94	106	-----	129	A	A	--	--	A	A	--	A	100	33.3	66.7
27013	21	-----	66	78	-----	99	-----	125	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	21	53	64	-----	-----	97	109	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	21	53	65	-----	90	-----	110	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	21	-----	63	76	87	-----	106	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	33.3	66.7
27046	21	54	-----	79	92	-----	-----	126	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
27049	21	-----	63	74	86	-----	105	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	33.3	66.7
28002	21	-----	65	76	89	-----	109	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[2]中性脂肪　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28011	21	51	64	-----	-----	97	109	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28016	21	52	-----	77	-----	96	107	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
28017	21	54	-----	79	92	-----	-----	126	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	66.7	83.3
28031	21	54	-----	79	-----	100	113	125	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
28033	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	21	-----	66	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	21	53	-----	77	-----	99	111	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30005	21	-----	64	77	90	-----	109	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
31005	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	21	52	63	-----	88	-----	108	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
32002	21	-----	67	78	-----	100	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	21	-----	65	77	89	-----	109	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	11	53	-----	77	89	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33008	21	-----	64	77	88	-----	108	-----	131	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
33009	21	50	63	-----	89	-----	109	122	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	80.0	86.7
34004	21	53	66	-----	-----	100	112	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
34009	21	52	-----	76	-----	95	107	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	53.3	76.7
34010	21	51	63	-----	86	-----	106	118	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	46.7	73.3
34011	21	-----	63	76	-----	95	-----	119	130	--	A	A	--	A	--	A	A	100	46.7	73.3
34012	21	52	64	-----	88	-----	108	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	66.7	83.3
34015	21	54	66	-----	90	-----	111	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	21	52	64	-----	89	-----	110	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	21	-----	65	77	89	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
37007	21	-----	65	77	89	-----	109	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
38004	21	50	-----	74	86	-----	-----	119	131	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	60.0	76.7
39001	21	53	65	-----	89	-----	109	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	21	52	-----	76	88	-----	-----	120	132	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
39003	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39004	21	52	-----	76	-----	95	108	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
40005	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	21	54	65	-----	-----	97	109	-----	133	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
40009	21	54	66	-----	-----	98	110	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40011	21	53	65	-----	89	-----	110	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	21	54	-----	79	-----	100	112	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40027	21	52	-----	77	-----	97	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
43001	21	-----	65	77	-----	97	-----	121	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43003	21	52	-----	76	89	-----	-----	122	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
44001	81	-----	88	106	-----	136	-----	172	191	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	11	-----	65	77	89	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
46004	21	53	66	-----	91	-----	112	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
47001	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47004	21	-----	64	77	88	-----	112	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
47005	21	53	-----	78	90	-----	-----	122	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47006	21	54	66	-----	-----	99	111	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
48512	21	-----	64	76	-----	96	-----	121	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[3]尿酸　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
01013	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01018	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	31	5.1	5.5	-----	6.3	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
01025	31	5	-----	6	-----	6.6	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
02004	31	5.1	-----	6	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	93.3	66.7	80.0
03001	31	5	5.4	-----	6.3	-----	7	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
03006	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04004	31	5.1	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	31	5.1	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
04015	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
07008	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	A	--	B	--	A	93.3	60.0	76.7
08001	31	5.1	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	31	-----	5.4	5.9	-----	6.6	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08006	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	31	5.1	5.6	-----	-----	6.8	7.1	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
09001	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09005	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09012	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
09016	31	-----	5.6	6.1	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
10003	31	5.1	5.5	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	31	5	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	31	5	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11010	31	5.2	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11011	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	31	5	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	31	-----	5.5	5.9	-----	6.6	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	31	5.1	-----	5.9	6.5	-----	-----	7.5	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
12001	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
12008	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12016	31	5.2	-----	6	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13002	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13017	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13061	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	31	5.2	-----	6	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	93.3	86.7	90.0
13084	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13094	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	31	5.1	-----	6	-----	6.8	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	31	5.1	5.6	-----	-----	6.8	7.1	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
14001	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[3]尿酸　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14010	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14025	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14030	31	5.2	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	31	5.1	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.5	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	31	5	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
15011	31	5	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
15012	31	5	-----	5.9	-----	6.6	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
16002	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
16006	31	5	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
17001	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
18001	31	5	5.5	-----	6.3	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	31	5.1	5.5	-----	6.3	-----	7	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
20007	31	5	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	31	5.3	5.7	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	B	B	--	B	--	B	A	--	73.3	60.0	66.7
22001	31	5.1	-----	5.9	-----	6.6	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22002	31	5.2	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
22003	31	-----	5.5	6	6.5	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	31	-----	5.5	6	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	B	B	86.7	46.7	66.7
22006	31	5.2	5.7	-----	-----	6.8	7.2	-----	8	A	B	--	--	A	A	--	A	93.3	73.3	83.3
22011	31	5.2	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
22012	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23003	31	5.1	5.5	-----	6.3	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	B	--	93.3	53.3	73.3
23008	31	5.1	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23011	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	31	5	-----	5.9	-----	6.6	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23016	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	31	5.3	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.7	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
23024	31	5.1	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	31	5	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.4	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	80.0	46.7	63.3
25003	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26003	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26006	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26009	31	5	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27004	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	B	93.3	73.3	83.3
27013	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27046	31	5	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.5	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27049	31	-----	5.4	5.8	6.3	-----	6.9	-----	7.8	--	A	B	A	--	B	--	B	80.0	46.7	63.3
28002	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[3]尿酸　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28011	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
28016	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28031	31	5.1	-----	5.9	-----	6.6	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28033	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30005	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
31005	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
32002	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	31	5	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.4	7.9	A	--	A	A	--	--	B	A	93.3	80.0	86.7
33008	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33009	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34004	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	31	5	-----	5.9	-----	6.6	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
34010	31	4.9	5.4	-----	6.3	-----	7	7.5	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	73.3	83.3
34011	31	-----	5.4	5.9	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	B	B	86.7	60.0	73.3
34012	31	4.9	5.4	-----	6.3	-----	7	7.5	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	73.3	83.3
34015	31	5.1	5.6	-----	6.6	-----	7.3	7.7	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	86.7	53.3	70.0
35001	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
37007	31	-----	5.5	5.9	6.3	-----	7	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
38004	31	5	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.5	7.9	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
39001	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39003	31	5.2	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
39004	31	5	-----	5.8	-----	6.5	6.9	7.5	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	80.0	53.3	66.7
40005	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	31	5	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40011	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
40027	31	5.2	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
43001	31	-----	5.5	5.9	-----	6.6	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43003	31	5.1	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.5	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
44001	81	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
46004	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
47001	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
47004	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
47005	31	5.1	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.8	8.1	A	--	A	A	--	--	B	A	93.3	66.7	80.0
47006	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
48512	31	-----	5.4	5.9	-----	6.6	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3

[4]クレアチニン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	1.05	1.64	-----	-----	3.24	3.85	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01013	21	-----	1.65	2.22	-----	3.2	-----	4.4	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
01018	21	-----	1.6	2.19	2.81	-----	3.8	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	21	1.05	1.65	-----	2.84	-----	3.87	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
01025	21	1.01	-----	2.21	-----	3.22	3.83	4.41	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	21	1.03	-----	2.24	-----	3.26	3.92	4.53	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
03001	21	0.99	1.58	-----	2.77	-----	3.79	4.38	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	21	1.02	-----	2.22	-----	3.26	3.87	4.51	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
04004	21	1.02	1.62	-----	2.84	-----	3.86	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	21	1.02	-----	2.21	-----	3.22	3.83	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	21	0.98	1.58	-----	2.82	-----	3.84	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	21	-----	1.6	2.2	2.85	-----	3.88	-----	5.09	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
04015	21	-----	1.6	2.21	-----	3.22	-----	4.45	5.05	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	21	0.99	1.6	-----	-----	3.22	3.85	-----	5.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
07008	21	-----	1.62	2.2	2.84	-----	3.84	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08001	21	1.07	-----	2.34	2.93	-----	-----	4.57	5.18	B	--	B	B	--	--	A	A	80.0	53.3	66.7
08003	21	-----	1.62	2.22	-----	3.23	-----	4.41	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08006	21	1.02	1.61	-----	2.82	-----	3.84	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	21	1	-----	2.2	2.8	-----	-----	4.45	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	21	1.03	1.63	-----	-----	3.27	3.86	-----	5.12	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09001	21	1.01	-----	2.21	-----	3.25	3.85	4.49	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09005	21	0.95	1.54	-----	-----	3.15	3.74	-----	4.98	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	60.0	73.3
09012	21	1	1.62	-----	-----	3.23	3.83	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	21	1.02	-----	2.23	2.84	-----	-----	4.41	4.95	A	--	A	A	--	--	A	A	100	66.7	83.3
09016	21	-----	1.63	2.23	-----	3.25	-----	4.49	5.08	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10003	21	1.02	1.6	-----	2.82	-----	3.83	4.42	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	21	1	1.6	-----	-----	3.2	3.8	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	21	-----	1.61	2.2	-----	3.22	-----	4.44	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	21	-----	1.59	2.21	2.81	-----	3.8	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	21	1.02	1.62	-----	-----	3.23	3.84	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
11010	21	1.01	1.59	-----	2.81	-----	3.81	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11011	21	1.02	-----	2.22	-----	3.23	3.82	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	21	1.02	1.62	-----	-----	3.21	3.81	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	21	-----	1.62	2.22	-----	3.22	-----	4.42	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	21	0.97	-----	2.19	2.81	-----	-----	4.43	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12001	21	1.03	-----	2.24	-----	3.26	3.87	4.49	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	21	1.01	-----	2.22	-----	3.22	3.84	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	21	-----	1.59	2.19	-----	3.19	-----	4.37	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12016	21	1.01	-----	2.24	2.84	-----	-----	4.52	5.09	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13002	21	-----	1.6	2.18	2.81	-----	3.8	-----	4.99	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	21	-----	1.6	2.19	-----	3.19	-----	4.42	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13017	21	1.01	1.61	-----	2.81	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	21	0.99	1.59	-----	2.8	-----	3.8	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	21	1	1.61	-----	-----	3.27	3.88	-----	5.11	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
13061	21	-----	1.57	2.19	2.78	-----	3.79	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	21	-----	1.61	2.21	-----	3.23	-----	4.43	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	21	1	-----	2.16	-----	3.18	3.8	4.41	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13084	21	1	1.6	-----	2.79	-----	3.8	4.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13094	21	-----	1.61	2.22	2.84	-----	3.86	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	21	-----	1.57	2.19	-----	3.2	-----	4.41	5	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	21	0.99	-----	2.19	-----	3.19	3.77	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	21	1.01	1.63	-----	-----	3.22	3.85	-----	5.07	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	21	-----	1.64	2.25	-----	3.28	-----	4.51	5.12	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3

[4]クレアチニン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14003	21	-----	1.62	2.21	-----	3.27	-----	4.47	5.08	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14010	21	-----	1.58	2.18	2.79	-----	3.78	-----	4.97	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14025	21	1	1.6	-----	-----	3.23	3.85	-----	5.06	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	21	-----	1.6	2.2	-----	3.2	-----	4.4	4.99	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14030	21	1.02	-----	2.21	-----	3.21	3.84	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	21	1.01	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.43	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	21	1.01	-----	2.21	-----	3.22	3.81	4.35	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	66.7	83.3
15006	21	-----	1.58	2.2	2.79	-----	3.9	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	66.7	83.3
15011	21	1.03	-----	2.23	2.86	-----	-----	4.47	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	21	1.01	-----	2.2	-----	3.19	3.78	4.38	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
16002	21	-----	1.66	2.25	2.86	-----	3.84	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
16006	21	1	-----	2.2	2.81	-----	-----	4.43	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
17001	21	1.03	1.64	-----	-----	3.26	3.88	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
18001	21	1.02	1.62	-----	2.85	-----	3.84	4.46	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	21	1.01	1.62	-----	2.79	-----	3.86	4.42	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
20007	21	1.02	1.61	-----	2.83	-----	3.81	4.42	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	21	1.02	-----	2.21	-----	3.22	3.82	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	1.02	1.62	-----	-----	3.22	3.82	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	21	1.02	1.6	-----	2.8	-----	3.81	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22001	21	1.02	-----	2.23	-----	3.26	3.87	4.49	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22002	21	1.01	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.44	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
22003	21	-----	1.58	2.17	2.79	-----	3.78	-----	4.98	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	21	-----	1.65	2.25	-----	3.28	-----	4.5	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22006	21	1.02	1.63	-----	-----	3.24	3.83	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22011	21	1.02	1.62	-----	2.85	-----	3.85	4.51	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	21	-----	1.62	2.24	2.82	-----	3.81	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	21	1.01	1.62	-----	-----	3.2	3.83	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	21	0.99	1.61	-----	-----	3.2	3.78	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23003	21	1.04	1.66	-----	2.86	-----	3.85	4.47	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
23008	21	1.04	1.66	-----	2.89	-----	3.92	4.54	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	46.7	73.3
23011	21	-----	1.61	2.21	-----	3.21	-----	4.41	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	21	1.02	-----	2.22	-----	3.21	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23016	21	1.02	-----	2.21	2.83	-----	-----	4.43	5.03	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	21	1.02	-----	2.23	2.85	-----	-----	4.48	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	21	1.03	1.65	-----	2.87	-----	3.89	4.51	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
23020	21	1	-----	2.18	-----	3.2	3.78	4.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23024	21	1	1.59	-----	-----	3.19	3.84	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	21	-----	1.59	2.2	-----	3.2	-----	4.42	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	21	1.04	1.63	-----	2.84	-----	3.8	4.39	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
25003	21	-----	1.61	2.21	-----	3.22	-----	4.44	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	1.63	2.25	-----	3.26	-----	4.48	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26003	21	-----	1.61	2.21	2.82	-----	3.83	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26006	21	1	1.63	-----	-----	3.25	3.87	-----	5.11	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
26009	21	0.96	1.57	-----	-----	3.19	3.82	-----	5.06	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
27004	21	1.03	1.65	-----	-----	3.29	3.91	-----	5.14	A	A	--	--	A	A	--	A	100	66.7	83.3
27013	21	-----	1.58	2.17	-----	3.19	-----	4.4	5	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	21	1.03	1.62	-----	-----	3.27	3.88	-----	5.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	21	1.02	1.62	-----	2.82	-----	3.82	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	21	-----	1.61	2.22	2.81	-----	3.8	-----	4.97	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27046	21	1.03	-----	2.2	2.81	-----	-----	4.41	5	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27049	21	-----	1.67	2.27	2.87	-----	3.92	-----	5.15	--	B	A	A	--	A	--	A	93.3	66.7	80.0
28002	21	-----	1.59	2.19	2.79	-----	3.81	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	21	-----	1.63	2.23	-----	3.23	-----	4.45	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[4]クレアチニン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28011	21	1.05	1.62	-----	-----	3.19	3.78	-----	4.94	A	A	--	--	A	A	--	A	100	60.0	80.0
28016	21	1	-----	2.22	-----	3.25	3.85	4.48	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	21	1.02	-----	2.19	2.83	-----	-----	4.46	5.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
28031	21	1.06	-----	2.27	-----	3.27	3.86	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
28033	21	1.01	1.62	-----	-----	3.25	3.86	-----	5.07	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	21	-----	1.59	2.2	-----	3.23	-----	4.46	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	21	1.04	-----	2.25	-----	3.25	3.87	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30005	21	-----	1.62	2.22	2.84	-----	3.85	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
31005	21	-----	1.61	2.2	-----	3.22	-----	4.45	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	21	1.02	1.61	-----	2.82	-----	3.86	4.49	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
32002	21	-----	1.6	2.21	-----	3.23	-----	4.42	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	21	-----	1.62	2.24	2.85	-----	3.87	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	21	1.02	-----	2.19	2.77	-----	-----	4.37	4.98	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
33008	21	-----	1.63	2.2	2.81	-----	3.81	-----	4.95	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
33009	21	1.01	1.61	-----	2.79	-----	3.78	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
34004	21	1.01	1.6	-----	-----	3.19	3.79	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	21	1.01	-----	2.19	-----	3.18	3.8	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34010	21	1.01	1.61	-----	2.84	-----	3.86	4.47	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34011	21	-----	1.53	2.14	-----	3.14	-----	4.32	4.95	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	60.0	76.7
34012	21	0.97	1.57	-----	2.76	-----	3.77	4.36	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
34015	21	0.99	1.58	-----	2.79	-----	3.8	4.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	21	1	1.59	-----	2.8	-----	3.83	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	21	-----	1.59	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
37007	21	-----	1.63	2.22	2.83	-----	3.85	-----	5.06	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
38004	21	0.93	-----	2.14	2.74	-----	-----	4.36	4.96	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	60.0	76.7
39001	21	1.07	1.69	-----	2.93	-----	3.98	4.62	-----	B	B	--	B	--	B	B	--	66.7	20.0	43.3
39002	21	1.02	-----	2.2	2.79	-----	-----	4.39	4.98	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
39003	21	1.01	-----	2.21	2.81	-----	-----	4.43	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39004	21	1.04	-----	2.23	-----	3.24	3.84	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40005	21	1.01	1.6	-----	2.8	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	21	1.04	1.64	-----	-----	3.25	3.85	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	21	1.04	1.64	-----	-----	3.28	3.9	-----	5.15	A	A	--	--	A	A	--	A	100	66.7	83.3
40011	21	1.03	1.61	-----	2.84	-----	3.89	4.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	21	1.02	-----	2.2	-----	3.19	3.77	4.38	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
40027	21	1.01	-----	2.25	-----	3.27	3.85	4.46	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
43001	21	-----	1.61	2.22	-----	3.22	-----	4.42	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43003	21	1.02	-----	2.24	2.87	-----	-----	4.52	5.13	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
44001	81	-----	1.58	2.21	-----	3.35	-----	4.87	5.64	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	21	-----	1.62	2.2	2.84	-----	3.86	-----	5.13	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
46004	21	0.99	1.6	-----	2.78	-----	3.8	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
47001	21	1.06	-----	2.26	2.88	-----	-----	4.5	5.12	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
47004	21	-----	1.62	2.24	2.87	-----	3.92	-----	5.15	--	A	A	A	--	A	--	A	100	66.7	83.3
47005	21	0.99	-----	2.22	2.79	-----	-----	4.45	5.03	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
47006	21	0.96	1.54	-----	-----	3.12	3.73	-----	4.95	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	60.0	73.3
48512	21	-----	1.6	2.2	-----	3.19	-----	4.35	4.93	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3

[5]AST　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	20	39	-----	-----	88	110	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01013	11	-----	38	54	-----	81	-----	116	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01018	11	-----	39	57	76	-----	106	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01023	11	20	39	-----	76	-----	110	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01025	11	21	-----	55	-----	85	107	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
02004	11	21	-----	55	-----	83	103	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
03001	11	21	36	-----	70	-----	99	116	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
03006	11	20	-----	53	-----	82	100	117	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04004	11	21	38	-----	74	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04008	11	20	-----	57	-----	86	105	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04009	11	21	38	-----	73	-----	103	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04010	11	-----	38	56	74	-----	105	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04015	11	-----	39	57	-----	87	-----	125	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
07002	11	21	39	-----	-----	86	105	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
07008	11	-----	35	52	70	-----	99	-----	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08001	11	23	-----	60	79	-----	-----	129	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08003	11	-----	40	57	-----	88	-----	127	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08006	11	21	38	-----	75	-----	105	122	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08009	11	21	-----	55	73	-----	-----	119	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08010	11	22	39	-----	-----	86	106	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09001	11	21	-----	58	-----	87	103	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09005	11	20	37	-----	-----	86	105	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09012	11	21	40	-----	-----	88	108	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09013	11	21	-----	59	78	-----	-----	128	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09016	11	-----	39	54	-----	85	-----	119	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10003	11	21	38	-----	76	-----	104	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10004	11	20	38	-----	-----	84	102	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10005	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10007	11	-----	40	60	79	-----	110	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11006	11	20	38	-----	-----	86	106	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11010	11	20	37	-----	71	-----	101	116	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11011	11	21	-----	60	-----	90	107	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11016	11	20	38	-----	-----	82	100	-----	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11020	11	-----	38	54	-----	82	-----	118	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11023	11	21	-----	56	74	-----	-----	123	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12001	11	21	-----	54	-----	84	103	120	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12002	11	21	-----	56	-----	86	105	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12008	11	-----	37	54	-----	83	-----	119	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12016	11	21	-----	58	77	-----	-----	125	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13002	11	-----	41	59	81	-----	112	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13003	11	-----	38	54	-----	82	-----	119	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13017	11	21	40	-----	78	-----	106	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13026	11	23	42	-----	81	-----	114	134	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13053	11	23	42	-----	-----	92	111	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13061	11	-----	41	58	78	-----	108	-----	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13064	11	-----	40	58	-----	89	-----	126	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13074	11	24	-----	63	-----	96	116	137	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13084	11	22	41	-----	80	-----	113	133	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13094	11	-----	39	57	76	-----	105	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13095	11	-----	42	61	-----	93	-----	130	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13100	11	24	-----	63	-----	95	116	136	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13103	11	21	37	-----	-----	86	104	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14001	11	-----	41	59	-----	90	-----	128	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14003	11	-----	41	59	-----	91	-----	128	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14010	11	-----	38	54	75	-----	100	-----	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[5]AST　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14025	11	21	39	-----	-----	86	105	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14027	11	-----	38	55	-----	83	-----	118	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14030	11	20	-----	54	-----	82	101	116	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15001	11	22	-----	56	76	-----	-----	125	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15004	11	21	-----	61	-----	89	108	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15006	11	-----	39	57	75	-----	107	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15011	11	21	-----	56	76	-----	-----	125	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15012	11	22	-----	57	-----	87	103	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
16002	11	-----	38	55	75	-----	104	-----	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
16006	11	21	-----	58	77	-----	-----	126	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
17001	11	21	39	-----	-----	87	106	-----	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
18001	11	21	39	-----	72	-----	103	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20005	11	21	38	-----	73	-----	105	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20007	11	21	40	-----	77	-----	108	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
21002	11	21	-----	58	-----	90	108	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
21005	11	21	40	-----	-----	90	108	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
21006	11	22	40	-----	77	-----	108	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22001	11	21	-----	58	-----	89	106	129	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22002	11	21	-----	56	73	-----	-----	121	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22003	11	-----	38	53	75	-----	105	-----	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22004	11	-----	35	49	-----	79	-----	112	130	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22006	11	20	37	-----	-----	84	101	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22011	11	20	38	-----	72	-----	107	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22012	11	-----	40	58	77	-----	108	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22017	11	20	38	-----	-----	85	104	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22018	11	21	37	-----	-----	85	103	-----	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23003	11	24	44	-----	82	-----	117	135	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23008	11	20	37	-----	72	-----	104	122	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23011	11	-----	40	58	-----	89	-----	125	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23015	11	21	-----	57	-----	88	103	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23016	11	21	-----	59	77	-----	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23017	11	21	-----	56	74	-----	-----	122	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23019	11	21	38	-----	73	-----	106	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23020	11	20	-----	53	-----	83	101	117	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23024	11	23	41	-----	-----	94	112	-----	151	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23029	11	-----	38	56	-----	86	-----	122	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
24003	11	20	38	-----	73	-----	104	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
25003	11	-----	39	55	-----	86	-----	122	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26001	11	-----	39	57	-----	88	-----	124	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26003	11	-----	35	52	68	-----	97	-----	133	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26006	11	21	38	-----	-----	86	104	-----	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26009	11	20	38	-----	-----	84	99	-----	141	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27004	11	24	43	-----	-----	96	116	-----	157	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27013	11	-----	43	62	-----	95	-----	133	152	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27014	11	21	38	-----	-----	86	105	-----	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27020	11	21	39	-----	76	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27044	11	-----	41	60	80	-----	113	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27046	11	21	-----	58	78	-----	-----	127	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27049	11	-----	38	58	76	-----	107	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28002	11	-----	39	57	75	-----	105	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28003	11	-----	39	57	-----	89	-----	125	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28011	11	20	38	-----	-----	83	102	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28016	11	22	-----	57	-----	86	103	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28017	11	21	-----	58	77	-----	-----	126	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28031	11	21	-----	56	-----	82	99	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[5]AST　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28033	11	21	38	-----	-----	88	104	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28034	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
30004	11	21	-----	55	-----	83	101	119	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
30005	11	-----	39	56	76	-----	105	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
31005	11	-----	40	58	-----	89	-----	125	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
32001	11	22	39	-----	76	-----	111	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
32002	11	-----	40	59	-----	88	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33001	11	-----	40	59	78	-----	109	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33005	11	21	-----	57	75	-----	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33008	11	-----	38	56	73	-----	104	-----	140	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33009	11	20	38	-----	75	-----	101	119	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34004	11	21	39	-----	-----	86	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34009	11	21	-----	55	-----	84	102	122	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34010	11	22	41	-----	80	-----	112	130	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34011	11	-----	40	53	-----	83	-----	118	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34012	11	21	38	-----	73	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34015	11	21	37	-----	72	-----	103	120	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
35001	11	20	39	-----	75	-----	109	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
37005	11	-----	41	59	78	-----	108	-----	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
37007	11	-----	36	52	72	-----	100	-----	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
38004	11	21	-----	54	71	-----	-----	120	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
39001	11	22	41	-----	79	-----	113	131	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
39002	11	21	-----	57	77	-----	-----	125	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
39003	11	21	-----	55	74	-----	-----	119	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
39004	11	20	-----	53	-----	82	100	115	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40005	11	21	39	-----	77	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40007	11	20	37	-----	-----	81	100	-----	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40009	11	22	41	-----	-----	91	109	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40011	11	21	38	-----	75	-----	108	125	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40021	11	21	-----	56	-----	84	103	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40027	11	21	-----	54	-----	82	100	118	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
43001	11	-----	40	57	-----	87	-----	122	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
43003	11	21	-----	59	79	-----	-----	130	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
44001	85	-----	34	45	-----	75	-----	111	132	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
45002	11	-----	40	58	78	-----	109	-----	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
46004	11	23	43	-----	84	-----	117	138	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
47001	11	21	-----	55	72	-----	-----	119	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
47004	11	-----	42	62	81	-----	116	-----	153	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
47005	11	23	-----	59	78	-----	-----	128	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
47006	11	22	41	-----	-----	90	109	-----	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
48512	11	-----	39	58	-----	89	-----	125	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[6]ALT　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	19	37	-----	-----	84	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01013	11	-----	36	55	-----	84	-----	119	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01018	11	-----	37	55	71	-----	103	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	11	19	37	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
01025	11	20	-----	54	-----	84	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	20	-----	55	-----	85	104	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
03001	11	21	38	-----	75	-----	104	122	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	93.3	93.3
03006	11	20	-----	55	-----	86	105	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04004	11	20	37	-----	73	-----	101	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	20	-----	55	-----	84	102	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	11	20	38	-----	73	-----	102	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	11	-----	37	54	73	-----	102	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04015	11	-----	38	55	-----	85	-----	119	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	11	20	38	-----	-----	84	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
07008	11	-----	37	54	73	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08001	11	19	-----	55	73	-----	-----	118	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	11	-----	38	55	-----	85	-----	121	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08006	11	20	38	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09001	11	20	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09005	11	19	37	-----	-----	86	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09012	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	11	20	-----	56	74	-----	-----	122	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09016	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10003	11	19	37	-----	72	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	11	19	37	-----	-----	84	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	11	-----	36	55	-----	85	-----	119	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	11	-----	37	56	73	-----	100	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	11	20	38	-----	-----	84	101	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
11010	11	20	37	-----	72	-----	102	117	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11011	11	20	-----	55	-----	87	104	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	11	19	38	-----	-----	85	103	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	11	-----	38	55	-----	85	-----	120	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	11	20	-----	54	72	-----	-----	119	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12001	11	20	-----	54	-----	85	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	11	20	-----	56	-----	86	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	11	-----	38	55	-----	85	-----	122	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12016	11	20	-----	55	74	-----	-----	121	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13002	11	-----	37	53	73	-----	102	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	11	-----	38	54	-----	85	-----	120	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13017	11	20	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	11	20	37	-----	74	-----	104	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	11	20	38	-----	-----	86	104	-----	130	A	A	--	--	A	A	--	A	100	46.7	73.3
13061	11	-----	38	55	73	-----	100	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	11	20	-----	57	-----	87	106	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
13084	11	19	37	-----	73	-----	102	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13094	11	-----	38	55	74	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	11	-----	38	55	-----	85	-----	117	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	11	19	-----	56	-----	84	100	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
13103	11	20	38	-----	-----	84	100	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	11	-----	38	56	-----	85	-----	120	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14003	11	-----	38	56	-----	86	-----	122	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14010	11	-----	38	56	73	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[6]ALT　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14025	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	11	-----	38	56	-----	84	-----	119	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14030	11	20	-----	55	-----	83	102	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	11	20	-----	55	75	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	11	20	-----	56	-----	86	104	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	11	-----	37	55	72	-----	100	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
15011	11	19	-----	54	72	-----	-----	121	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	11	20	-----	54	-----	22	105	120	-----	A	--	A	--	D	A	A	--	80.0	0.0	40.0
16002	11	-----	38	55	71	-----	101	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
16006	11	20	-----	55	72	-----	-----	119	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
17001	11	18	36	-----	-----	84	102	-----	137	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	86.7	90.0
18001	11	19	37	-----	73	-----	102	118	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	11	20	38	-----	74	-----	104	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20007	11	20	38	-----	73	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	11	20	-----	56	-----	85	103	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	11	18	36	-----	73	-----	101	119	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
22001	11	20	-----	56	-----	85	101	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22002	11	19	-----	56	73	-----	-----	119	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	-----	38	55	73	-----	103	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	11	-----	40	57	-----	89	-----	124	142	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	60.0	76.7
22006	11	20	38	-----	-----	86	104	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22011	11	19	38	-----	73	-----	105	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	-----	38	56	74	-----	103	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	11	19	38	-----	-----	86	104	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	11	20	39	-----	-----	88	104	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	73.3	86.7
23003	11	19	38	-----	74	-----	105	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23008	11	20	38	-----	73	-----	104	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23011	11	-----	37	55	-----	85	-----	121	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	11	20	-----	56	-----	86	104	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23016	11	20	-----	56	73	-----	-----	121	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	11	20	-----	56	73	-----	-----	124	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
23019	11	20	38	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	11	20	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23024	11	20	38	-----	-----	85	104	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	11	-----	37	55	-----	85	-----	121	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	11	20	37	-----	72	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25003	11	-----	37	55	-----	85	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	37	56	-----	87	-----	122	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26003	11	-----	38	52	74	-----	103	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
26006	11	20	38	-----	-----	86	104	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26009	11	19	37	-----	-----	84	99	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
27004	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27013	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	11	20	39	-----	-----	86	104	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	11	20	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	-----	37	54	73	-----	102	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27046	11	21	-----	56	75	-----	-----	121	138	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100.0	96.7
27049	11	-----	37	56	74	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28002	11	-----	37	55	72	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	-----	38	57	-----	86	-----	123	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28011	11	19	37	-----	-----	85	102	-----	133	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
28016	11	20	-----	55	-----	86	103	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28031	11	19	-----	55	-----	82	99	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0

[6]ALT　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28033	11	20	37	-----	-----	83	99	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
28034	11	-----	37	53	-----	84	-----	118	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	11	19	-----	56	-----	84	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30005	11	-----	39	57	75	-----	104	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
31005	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	11	18	36	-----	72	-----	103	119	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
32002	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	11	-----	38	57	75	-----	104	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
33005	11	20	-----	56	75	-----	-----	122	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33008	11	-----	37	54	72	-----	101	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33009	11	19	37	-----	74	-----	101	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34004	11	20	38	-----	-----	85	102	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	11	20	-----	55	-----	85	103	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34010	11	20	38	-----	75	-----	105	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34011	11	-----	38	55	-----	85	-----	119	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34012	11	19	37	-----	71	-----	100	117	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
34015	11	20	38	-----	75	-----	104	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	11	20	38	-----	73	-----	104	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	11	-----	37	55	70	-----	98	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
37007	11	-----	37	55	72	-----	99	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
38004	11	21	-----	54	71	-----	-----	119	136	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	93.3	93.3
39001	11	20	38	-----	75	-----	105	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	11	20	-----	55	73	-----	-----	118	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39003	11	20	-----	54	74	-----	-----	118	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39004	11	21	-----	56	-----	86	106	119	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0
40005	11	20	37	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	11	20	38	-----	-----	87	104	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
40011	11	20	37	-----	74	-----	105	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	11	19	-----	56	-----	84	102	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40027	11	20	-----	56	-----	86	103	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
43001	11	-----	38	56	-----	86	-----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43003	11	19	-----	55	72	-----	-----	121	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
44001	85	-----	44	62	-----	88	-----	120	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	11	-----	38	56	74	-----	104	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
46004	11	20	38	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
47001	11	20	-----	56	73	-----	-----	121	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47004	11	-----	37	54	73	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
47005	11	20	-----	56	73	-----	-----	121	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47006	11	20	38	-----	-----	86	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
48512	11	-----	36	55	-----	84	-----	119	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100

[7] γ－GT　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	31	48	-----	-----	98	117	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
01013	11	-----	48	66	-----	97	-----	133	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01018	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	154	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
01025	11	30	-----	66	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	31	-----	68	-----	99	118	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
03001	11	30	49	-----	86	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	11	29	-----	66	-----	96	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
04004	11	30	48	-----	84	-----	116	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	30	-----	66	-----	97	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	11	30	48	-----	85	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	154	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04015	11	-----	48	66	-----	97	-----	134	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	11	30	49	-----	-----	98	117	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
07008	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08001	11	30	-----	66	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
08006	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	11	30	-----	67	86	-----	-----	135	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	11	30	48	-----	-----	96	114	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09001	11	29	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09005	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09012	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	11	30	-----	67	85	-----	-----	133	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09016	11	-----	49	68	-----	99	-----	136	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10003	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	11	-----	49	67	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	11	-----	48	66	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	11	30	49	-----	-----	97	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11010	11	29	48	-----	85	-----	114	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
11011	11	30	-----	66	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11020	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11023	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12001	11	31	-----	66	-----	97	115	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	11	30	-----	66	-----	97	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	11	-----	48	65	-----	95	-----	131	150	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3
12016	11	30	-----	66	84	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
13002	11	-----	49	67	86	-----	118	-----	154	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13003	11	-----	48	66	-----	96	-----	131	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
13017	11	30	49	-----	85	-----	115	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	11	30	48	-----	84	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	11	30	47	-----	-----	96	114	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13061	11	-----	47	65	84	-----	114	-----	149	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
13064	11	-----	48	66	-----	97	-----	133	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	11	30	-----	66	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13084	11	30	49	-----	86	-----	118	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
13094	11	-----	48	67	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13100	11	30	-----	68	-----	98	117	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	11	30	49	-----	-----	97	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	11	-----	49	67	-----	98	-----	133	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14003	11	-----	48	66	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
14010	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[7] γ－GT　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14025	11	30	48	-----	-----	97	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	11	-----	47	65	-----	95	-----	132	148	--	A	A	--	A	--	A	A	100	46.7	73.3
14030	11	30	-----	67	-----	98	117	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	11	31	-----	67	85	-----	-----	133	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	11	29	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	11	-----	48	66	85	-----	117	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
15011	11	30	-----	68	86	-----	-----	135	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	11	30	-----	66	-----	96	114	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16006	11	31	-----	68	87	-----	-----	137	156	A	--	A	A	--	--	A	A	100	60.0	80.0
17001	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
18001	11	31	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20005	11	30	48	-----	84	-----	115	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
20007	11	30	49	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	11	30	-----	67	-----	97	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	30	49	-----	-----	97	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	11	30	49	-----	85	-----	115	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
22001	11	30	-----	66	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22002	11	30	-----	66	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	-----	48	65	84	-----	114	-----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
22004	11	-----	51	68	-----	100	-----	136	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	53.3	76.7
22006	11	30	48	-----	-----	99	117	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
22011	11	31	49	-----	87	-----	117	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	11	30	49	-----	-----	99	117	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
22018	11	29	47	-----	-----	97	114	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23003	11	31	49	-----	87	-----	118	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23008	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23011	11	-----	48	66	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
23015	11	30	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23016	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	11	30	-----	66	85	-----	-----	133	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	11	31	49	-----	87	-----	118	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	11	31	-----	66	-----	97	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
23024	11	30	48	-----	-----	97	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	11	-----	48	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	11	30	48	-----	85	-----	115	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25003	11	-----	48	66	-----	97	-----	135	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	49	67	-----	98	-----	133	150	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
26003	11	-----	48	66	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26006	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26009	11	31	49	-----	-----	98	115	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
27004	11	31	49	-----	-----	100	118	-----	156	A	A	--	--	A	A	--	A	100	66.7	83.3
27013	11	-----	48	66	-----	96	-----	133	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	11	31	50	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	-----	49	68	86	-----	117	-----	154	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27046	11	31	-----	68	87	-----	-----	137	157	A	--	A	A	--	--	A	A	100	46.7	73.3
27049	11	-----	50	68	86	-----	115	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
28002	11	-----	49	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	-----	48	66	-----	96	-----	133	150	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28011	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28016	11	31	-----	68	-----	99	117	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	30	-----	66	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28031	11	32	-----	69	-----	101	119	139	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	46.7	70.0

[7] γ－GT　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28033	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	11	30	-----	66	-----	96	114	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30005	11	-----	47	65	84	-----	114	-----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
31005	11	-----	48	67	-----	97	-----	133	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	11	31	49	-----	87	-----	118	137	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
32002	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
33001	11	-----	49	68	87	-----	117	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	11	30	-----	65	84	-----	-----	131	149	A	--	A	A	--	--	A	A	100	53.3	76.7
33008	11	-----	49	66	86	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33009	11	30	47	-----	84	-----	112	130	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	26.7	63.3
34004	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	11	30	-----	66	-----	96	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34010	11	30	48	-----	85	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34011	11	-----	48	67	-----	96	-----	132	150	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
34012	11	30	49	-----	85	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34015	11	31	49	-----	87	-----	118	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	11	30	48	-----	85	-----	115	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	11	-----	49	68	87	-----	118	-----	157	--	A	A	A	--	A	--	A	100	40.0	70.0
37007	11	-----	49	67	86	-----	118	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
38004	11	29	-----	65	83	-----	-----	132	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
39001	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	11	31	-----	67	85	-----	-----	135	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
39003	11	30	-----	67	85	-----	-----	136	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
39004	11	30	-----	68	-----	99	119	137	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
40005	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40011	11	31	49	-----	86	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	11	30	-----	68	-----	99	117	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40027	11	32	-----	69	-----	100	118	137	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
43001	11	-----	49	67	-----	99	-----	137	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3
43003	11	30	-----	66	84	-----	-----	132	149	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
44001	85	-----	46	64	-----	92	-----	121	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	11	-----	49	68	87	-----	118	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
46004	11	30	49	-----	87	-----	118	137	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	66.7	83.3
47001	11	30	-----	65	84	-----	-----	133	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47004	11	-----	53	73	95	-----	130	-----	170	--	B	B	C	--	C	--	C	46.7	20.0	33.3
47005	11	31	-----	67	85	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47006	11	29	47	-----	-----	97	114	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	53.3	76.7
48512	11	-----	48	67	-----	96	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7

[8]血糖　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	90	107	-----	-----	149	168	-----	202	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	66.7	80.0
01013	12	-----	104	122	-----	151	-----	183	202	--	B	B	--	A	--	B	A	80.0	53.3	66.7
01018	21	-----	108	125	142	-----	170	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01023	21	90	107	-----	140	-----	169	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
01025	21	91	-----	125	-----	152	169	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
02004	21	90	-----	125	-----	143	169	186	-----	A	--	A	--	D	A	A	--	80.0	33.3	56.7
03001	21	91	108	-----	142	-----	170	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	21	92	-----	126	-----	155	173	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04004	21	94	109	-----	143	-----	172	189	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	100.0	96.7
04008	12	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04009	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04010	12	-----	108	125	142	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04015	12	-----	108	125	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07002	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
07008	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08001	21	92	-----	127	144	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	21	-----	106	122	-----	152	-----	184	201	--	B	B	--	A	--	A	A	86.7	60.0	73.3
08006	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
08009	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08010	31	92	108	-----	-----	153	169	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
09001	21	92	-----	126	-----	154	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09005	12	91	108	-----	-----	152	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09012	21	93	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09013	21	93	-----	127	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09016	21	-----	108	124	-----	152	-----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
10003	21	92	109	-----	143	-----	170	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10004	31	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
10005	12	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
10007	12	-----	108	124	142	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11006	21	93	109	-----	-----	155	172	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11010	21	94	110	-----	145	-----	173	191	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	60.0	76.7
11011	21	93	-----	126	-----	154	171	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11016	21	91	108	-----	-----	153	169	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
11020	21	-----	108	124	-----	153	-----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
11023	12	90	-----	123	140	-----	-----	185	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
12001	21	92	-----	125	-----	154	170	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12002	12	92	-----	125	-----	155	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12008	21	-----	108	125	-----	153	-----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12016	21	92	-----	126	143	-----	-----	190	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13002	12	-----	108	124	142	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13003	21	-----	108	125	-----	153	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13017	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13026	12	91	108	-----	142	-----	169	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13053	12	90	107	-----	-----	152	168	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
13061	21	-----	107	124	140	-----	168	-----	200	--	A	A	A	--	A	--	A	100	46.7	73.3
13064	21	-----	109	126	-----	155	-----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13074	21	92	-----	126	-----	154	170	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13084	12	91	108	-----	142	-----	171	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
13094	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13095	12	-----	106	122	-----	151	-----	184	201	--	B	B	--	A	--	A	A	86.7	60.0	73.3
13100	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13103	21	93	110	-----	-----	154	172	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14001	21	-----	107	124	-----	150	-----	186	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14003	12	-----	110	126	-----	155	-----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14010	21	-----	110	127	144	-----	170	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7

[8]血糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14025	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14027	21	-----	108	125	-----	153	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14030	21	92	-----	126	-----	153	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15001	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15004	31	91	-----	125	-----	153	169	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15006	21	-----	109	125	143	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
15011	21	91	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15012	21	91	-----	126	-----	153	169	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16006	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
17001	12	91	108	-----	-----	153	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
18001	21	91	107	-----	140	-----	169	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
20005	21	91	108	-----	141	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20007	21	91	108	-----	142	-----	169	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21002	12	91	-----	125	-----	153	170	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21006	21	91	108	-----	141	-----	168	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
22001	12	90	-----	123	-----	153	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
22002	21	91	-----	123	140	-----	-----	184	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100	46.7	73.3
22003	21	-----	109	126	144	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22004	21	-----	110	127	-----	154	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
22006	21	92	108	-----	-----	153	168	-----	202	A	A	--	--	A	A	--	A	100	73.3	86.7
22011	21	92	108	-----	142	-----	168	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	66.7	83.3
22012	21	-----	108	125	142	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
22017	21	91	107	-----	-----	153	168	-----	201	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
22018	21	88	106	-----	-----	148	164	-----	199	B	B	--	--	B	B	--	B	66.7	33.3	50.0
23003	21	91	108	-----	140	-----	168	183	-----	A	A	--	A	--	A	B	--	93.3	40.0	66.7
23008	21	92	109	-----	144	-----	172	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23011	21	-----	109	126	-----	154	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	12	90	-----	124	-----	151	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
23016	21	91	-----	126	142	-----	-----	186	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23017	21	91	-----	126	142	-----	-----	186	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
23019	21	91	108	-----	142	-----	170	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23020	21	89	-----	124	-----	149	170	183	-----	B	--	A	--	B	A	B	--	80.0	40.0	60.0
23024	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23029	21	-----	108	125	-----	152	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
24003	21	90	106	-----	140	-----	166	183	-----	A	B	--	A	--	B	B	--	80.0	26.7	53.3
25003	21	-----	109	126	-----	155	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	109	128	-----	155	-----	189	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	53.3	76.7
26003	11	-----	107	123	141	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
26006	21	91	108	-----	-----	153	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26009	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27004	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27013	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
27014	21	92	108	-----	-----	154	170	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27020	21	92	109	-----	143	-----	170	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	31	-----	107	124	141	-----	168	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
27046	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27049	21	-----	107	123	140	-----	168	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100	60.0	80.0
28002	12	-----	108	125	141	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100.0	100.0
28003	12	-----	107	124	-----	152	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100.0	100.0
28011	21	90	106	-----	-----	151	168	-----	201	A	B	--	--	A	A	--	A	93.3	73.3	83.3
28016	21	91	-----	126	-----	153	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	21	91	-----	124	141	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28031	21	93	-----	127	-----	155	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7

[8]血糖　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
28033	12	91	108	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28034	21	-----	108	126	-----	153	-----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
30004	21	98	-----	135	-----	162	170	203	-----	D	--	D	--	C	A	D	--	26.7	6.7	16.7
30005	21	-----	108	125	142	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
31005	21	-----	108	125	-----	152	-----	186	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
32001	21	92	107	-----	143	-----	170	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
32002	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
33001	12	-----	108	125	142	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33005	12	90	-----	124	142	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33008	21	-----	109	125	140	-----	170	-----	200	--	A	A	A	--	A	--	A	100	46.7	73.3
33009	21	89	106	-----	140	-----	167	185	-----	B	B	--	A	--	A	A	--	86.7	60.0	73.3
34004	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34009	12	91	-----	125	-----	152	170	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34010	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34011	21	-----	108	124	-----	151	-----	183	200	--	A	A	--	A	--	B	A	93.3	33.3	63.3
34012	21	92	110	-----	143	-----	173	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34015	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
35001	21	90	107	-----	141	-----	169	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
37005	12	-----	107	124	140	-----	168	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
37007	21	-----	109	126	142	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
38004	21	91	-----	124	141	-----	-----	186	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39001	21	91	108	-----	142	-----	170	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
39002	21	92	-----	126	142	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39003	21	91	-----	125	142	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
39004	21	93	-----	125	-----	153	171	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40005	21	91	108	-----	142	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40007	21	92	108	-----	-----	153	171	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40009	12	90	108	-----	-----	152	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40011	21	92	109	-----	143	-----	172	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40021	21	91	-----	125	-----	153	170	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40027	21	92	-----	127	-----	155	171	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
43001	21	-----	108	126	-----	154	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43003	12	91	-----	124	141	-----	-----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
44001	81	-----	103	121	-----	152	-----	192	212	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
45002	21	-----	110	126	143	-----	172	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
46004	21	92	109	-----	143	-----	169	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
47001	21	92	-----	125	142	-----	-----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47004	12	-----	109	125	143	-----	172	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
47005	21	92	-----	126	142	-----	-----	187	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
47006	21	91	108	-----	-----	152	168	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
48512	12	-----	107	123	-----	151	-----	185	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3

[9]HDLコレステロール　自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	01-0403	32	45	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
01013	01-1201	35	-----	55	50	-----	B	--	B	--	--	85.7
01018	01-1201	-----	52	57	-----	75	--	A	A	--	--	100
01023	01-0403	-----	45	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
01025	01-0403	33	-----	50	49	-----	B	--	A	--	--	85.7
02004	01-0403	31	43	-----	-----	71	A	A	--	--	--	100
03001	01-0403	-----	44	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
03006	01-1201	-----	54	58	52	-----	--	B	A	--	--	78.6
04004	01-0403	32	-----	51	-----	74	A	--	A	--	--	100
04008	01-1201	36	52	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100
04009	01-1201	36	52	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100
04010	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
04015	01-1201	-----	52	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
07002	01-0403	-----	44	50	-----	73	--	A	A	--	--	100
07008	01-1201	37	53	-----	-----	79	A	A	--	--	--	100
08001	01-1201	-----	50	55	46	-----	--	B	B	--	--	85.7
08003	01-1201	36	-----	56	-----	75	A	--	A	--	--	100
08006	01-1201	36	51	-----	-----	77	A	A	--	--	--	100
08009	01-0403	32	44	-----	-----	48	A	A	--	--	--	100
08010	01-1201	37	53	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
09001	01-0403	32	44	-----	-----	73	A	A	--	--	--	100
09005	01-1201	-----	52	56	-----	76	--	A	A	--	--	100
09012	01-1201	36	51	-----	-----	76	A	A	--	--	--	100
09013	01-0403	32	-----	51	49	-----	A	--	A	--	--	100
09016	01-1201	37	-----	58	-----	75	A	--	A	--	--	100
10003	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
10004	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
10005	01-0403	31	43	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
10007	01-0403	-----	44	50	-----	71	--	A	A	--	--	100
11006	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
11010	01-0403	31	43	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
11011	01-0403	-----	44	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
11016	01-1201	-----	51	57	-----	75	--	A	A	--	--	100
11020	01-1201	-----	51	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
11023	01-1201	36	-----	57	-----	77	A	--	A	--	--	100
12001	01-1301	32	-----	54	-----	73	--	--	--	--	--	======
12002	01-1201	-----	52	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
12008	01-0403	-----	45	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
12016	01-0403	32	-----	50	49	-----	A	--	A	--	--	100
13002	01-0403	32	45	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13003	01-1201	-----	51	56	49	-----	--	A	A	--	--	100
13017	01-0403	32	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
13026	01-1201	36	51	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13053	01-0403	31	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
13061	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
13064	01-1201	36	-----	55	49	-----	A	--	B	--	--	92.9
13074	01-1201	-----	52	57	-----	78	--	A	A	--	--	100
13084	01-0403	32	45	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
13094	01-0403	32	45	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13095	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
13100	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
13103	01-1201	-----	52	58	-----	75	--	A	A	--	--	100
14001	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
14003	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
14010	01-0403	-----	93	127	150	-----	--	D	D	--	--	0
14025	01-1201	37	-----	58	50	-----	A	--	A	--	--	100

[9]HDLコレステロール　自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	01-0403	31	-----	49	-----	71	A	--	A	--	--	100
14030	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
15001	01-1201	-----	52	57	49	-----	--	A	A	--	--	100
15004	01-0403	-----	43	50	-----	71	--	A	A	--	--	100
15006	01-1201	34	-----	56	-----	76	C	--	A	--	--	71.4
15011	01-1201	36	-----	56	-----	75	A	--	A	--	--	100
15012	01-1201	36	-----	56	-----	74	A	--	A	--	--	100
16002	01-1201	37	53	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100
16006	01-1201	36	-----	56	50	-----	A	--	A	--	--	100
17001	01-0403	-----	44	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
18001	01-0403	-----	45	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
20005	01-2304	32	46	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
20007	01-0403	32	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
21002	01-0403	32	44	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
21005	01-0403	32	45	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
21006	01-0403	31	44	-----	-----	70	A	A	--	--	--	100
22001	01-2304	32	45	-----	47	-----	A	A	--	--	--	100
22002	01-0403	32	43	-----	-----	70	A	A	--	--	--	100
22003	01-1201	36	51	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
22004	01-2304	-----	44	51	49	-----	--	A	B	--	--	92.9
22006	01-0403	32	-----	49	49	-----	A	--	A	--	--	100
22011	01-0403	-----	43	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
22012	01-0403	32	-----	50	-----	72	A	--	A	--	--	100
22017	01-0403	-----	44	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
22018	01-0403	33	46	-----	49	-----	B	B	--	--	--	64.3
23003	01-2304	33	45	-----	48	-----	B	A	--	--	--	92.9
23008	01-0403	31	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
23011	01-1201	37	-----	56	50	-----	A	--	A	--	--	100
23015	01-0403	31	43	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
23016	01-0403	-----	44	50	50	-----	--	A	A	--	--	100
23017	01-0403	31	44	-----	-----	73	A	A	--	--	--	100
23019	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
23020	01-0403	-----	44	49	48	-----	--	A	A	--	--	100
23024	01-1201	-----	52	56	-----	75	--	A	A	--	--	100
23029	01-0403	31	-----	50	49	-----	A	--	A	--	--	100
24003	01-0403	31	-----	49	48	-----	A	--	A	--	--	100
25003	01-0403	-----	44	51	49	-----	--	A	A	--	--	100
26001	01-0403	33	44	-----	-----	75	B	A	--	--	--	85.7
26003	01-1201	-----	50	55	49	-----	--	B	B	--	--	85.7
26006	01-0403	31	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
26009	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
27004	01-1201	38	52	-----	50	-----	B	A	--	--	--	78.6
27013	01-1201	36	52	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
27014	01-1201	-----	53	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
27020	01-0403	32	-----	51	49	-----	A	--	A	--	--	100
27044	01-0403	-----	45	51	-----	74	--	A	A	--	--	100
27046	01-0403	-----	44	51	48	-----	--	A	A	--	--	100
27049	01-1201	37	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
28002	01-1201	37	52	-----	51	-----	A	A	--	--	--	100
28003	01-0403	31	-----	50	-----	71	A	--	A	--	--	100
28011	01-0403	32	-----	51	-----	71	A	--	A	--	--	100
28016	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
28017	01-0403	31	-----	50	49	-----	A	--	A	--	--	100
28031	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
28033	01-1201	-----	51	56	-----	76	--	A	A	--	--	100
28034	01-1201	36	-----	57	-----	77	A	--	A	--	--	100

[9]HDLコレステロール　自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	01-0403	32	-----	50	-----	74	A	--	A	--	--	100
30005	01-0403	31	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
31005	01-0403	32	44	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
32001	01-0403	31	-----	50	-----	72	A	--	A	--	--	100
32002	01-0403	33	-----	51	49	-----	B	--	A	--	--	85.7
33001	01-0403	32	-----	51	49	-----	A	--	A	--	--	100
33005	01-0403	31	44	-----	-----	71	A	A	--	--	--	100
33008	01-0403	-----	43	49	-----	73	--	A	A	--	--	100
33009	01-0403	-----	44	50	-----	73	--	A	A	--	--	100
34004	01-0403	-----	43	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
34009	01-1201	36	-----	56	50	-----	A	--	A	--	--	100
34010	01-1201	37	-----	58	-----	74	A	--	A	--	--	100
34011	01-1201	36	-----	55	49	-----	A	--	B	--	--	92.9
34012	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
34015	01-0403	31	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
35001	01-0403	32	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
37005	01-1201	37	53	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
37007	01-2304	-----	45	53	47	-----	--	A	A	--	--	100
38004	01-1201	35	-----	56	49	-----	B	--	A	--	--	92.9
39001	01-1201	36	51	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
39002	01-0403	-----	44	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
39003	01-0403	31	-----	49	-----	72	A	--	A	--	--	100
39004	01-1201	37	-----	56	-----	76	A	--	A	--	--	100
40005	01-0403	31	-----	51	47	-----	A	--	A	--	--	100
40007	01-2304	32	46	-----	-----	69	A	A	--	--	--	100
40009	01-2304	32	-----	53	48	-----	A	--	A	--	--	100
40011	01-1201	36	52	-----	-----	76	A	A	--	--	--	100
40021	01-1201	-----	52	58	-----	75	--	A	A	--	--	100
40027	01-0403	-----	43	49	-----	71	--	A	A	--	--	100
43001	01-2304	32	45	-----	47	-----	A	A	--	--	--	100
43003	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
44001	08-2801	-----	103	139	-----	97	--	D	D	--	--	0
45002	01-0403	32	-----	50	-----	72	A	--	A	--	--	100
46004	01-0403	-----	45	52	-----	73	--	A	B	--	--	92.9
47001	01-1201	35	50	-----	49	-----	B	B	--	--	--	85.7
47004	01-1201	36	51	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
47005	01-0403	32	-----	53	50	-----	A	--	C	--	--	71.4
47006	01-1201	35	51	-----	50	-----	B	A	--	--	--	92.9
48512	01-0403	32	-----	52	-----	73	A	--	B	--	--	92.9

[10]LDLコレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	01-0403	68	94	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
01013	01-1201	71	-----	135	152	-----	A	--	A	--	--	100
01018	01-1201	-----	101	130	-----	107	--	A	A	--	--	100
01023	01-0403	-----	94	127	-----	100	--	A	A	--	--	100
01025	01-0403	68	-----	127	149	-----	A	--	A	--	--	100
02004	01-0403	66	93	-----	-----	99	A	A	--	--	--	100
03001	01-0403	-----	93	123	144	-----	--	A	A	--	--	100
03006	01-1201	-----	102	135	160	-----	--	A	A	--	--	100
04004	01-0403	66	-----	128	-----	99	A	--	A	--	--	100
04008	01-1201	70	102	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
04009	01-1201	71	102	-----	-----	104	A	A	--	--	--	100
04010	01-1201	71	-----	133	157	-----	A	--	A	--	--	100
04015	01-1201	-----	102	132	157	-----	--	A	A	--	--	100
07002	01-0403	-----	94	127	-----	100	--	A	A	--	--	100
07008	01-1201	72	103	-----	-----	105	A	A	--	--	--	100
08001	01-1201	-----	101	131	154	-----	--	A	A	--	--	100
08003	01-1201	70	-----	130	-----	104	A	--	A	--	--	100
08006	01-1201	70	101	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
08009	01-0403	66	94	-----	-----	149	A	A	--	--	--	100
08010	01-1201	71	103	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
09001	01-0403	66	93	-----	-----	100	A	A	--	--	--	100
09005	01-1201	-----	101	130	-----	105	--	A	A	--	--	100
09012	01-1201	72	101	-----	-----	105	A	A	--	--	--	100
09013	01-0403	67	-----	127	148	-----	A	--	A	--	--	100
09016	01-1201	74	-----	136	-----	105	B	--	A	--	--	92.9
10003	01-1201	70	102	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
10004	01-0403	-----	93	125	147	-----	--	A	A	--	--	100
10005	01-0403	67	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
10007	01-0403	-----	95	128	-----	100	--	A	A	--	--	100
11006	01-1201	70	102	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
11010	01-0403	66	94	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
11011	01-0403	-----	93	126	-----	99	--	A	A	--	--	100
11016	01-1201	-----	101	132	-----	103	--	A	A	--	--	100
11020	01-1201	-----	101	132	153	-----	--	A	A	--	--	100
11023	01-1201	72	-----	131	-----	105	A	--	A	--	--	100
12001	01-1302	75	-----	132	-----	103	--	--	--	--	--	======
12002	01-1201	-----	103	134	153	-----	--	A	A	--	--	100
12008	01-0403	-----	94	126	-----	102	--	A	A	--	--	100
12016	01-0403	67	-----	128	152	-----	A	--	A	--	--	100
13002	01-0403	67	94	-----	-----	102	A	A	--	--	--	100
13003	01-1201	-----	103	135	155	-----	--	A	A	--	--	100
13017	01-0403	67	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
13026	01-1201	71	103	-----	-----	109	A	A	--	--	--	100
13053	01-0403	66	93	-----	-----	100	A	A	--	--	--	100
13061	01-1201	71	-----	132	-----	103	A	--	A	--	--	100
13064	01-1201	72	-----	128	155	-----	A	--	A	--	--	100
13074	01-1201	-----	103	132	-----	108	--	A	A	--	--	100
13084	01-0403	67	94	-----	151	-----	A	A	--	--	--	100
13094	01-0403	67	94	-----	-----	102	A	A	--	--	--	100
13095	01-1201	72	-----	133	156	-----	A	--	A	--	--	100
13100	01-1201	71	100	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
13103	01-1201	-----	102	134	-----	105	--	A	A	--	--	100
14001	01-1201	73	-----	135	155	-----	A	--	A	--	--	100
14003	01-0403	-----	95	127	150	-----	--	A	A	--	--	100
14010	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	D	D	--	--	0
14025	01-1201	71	-----	132	156	-----	A	--	A	--	--	100

[10]LDLコレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	01-0403	66	-----	126	-----	99	A	--	A	--	--	100
14030	01-1201	70	100	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
15001	01-2302	-----	111	141	151	-----	--	A	A	--	--	100
15004	01-1301	-----	106	143	-----	103	--	--	--	--	--	======
15006	01-1201	68	-----	132	-----	104	B	--	A	--	--	92.9
15011	01-2302	76	-----	139	-----	103	A	--	A	--	--	100
15012	01-2302	79	-----	140	-----	104	A	--	A	--	--	100
16002	01-1201	71	101	-----	-----	105	A	A	--	--	--	100
16006	01-1201	71	-----	132	156	-----	A	--	A	--	--	100
17001	01-0403	-----	93	126	145	-----	--	A	A	--	--	100
18001	01-0403	-----	94	127	-----	100	--	A	A	--	--	100
20005	01-2302	75	108	-----	152	-----	A	A	--	--	--	100
20007	01-0403	66	-----	127	-----	102	A	--	A	--	--	100
21002	01-0403	66	94	-----	148	-----	A	A	--	--	--	100
21005	01-0403	66	94	-----	148	-----	A	A	--	--	--	100
21006	01-0403	65	93	-----	-----	98	A	A	--	--	--	100
22001	01-2302	76	108	-----	151	-----	A	A	--	--	--	100
22002	01-0403	65	92	-----	-----	99	A	A	--	--	--	100
22003	01-1201	72	104	-----	158	-----	A	A	--	--	--	100
22004	01-0403	-----	92	124	154	-----	--	A	A	--	--	100
22006	01-0403	67	-----	123	152	-----	A	--	A	--	--	100
22011	01-0403	-----	92	126	-----	99	--	A	A	--	--	100
22012	01-0403	66	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
22017	01-0403	-----	92	127	-----	100	--	A	A	--	--	100
22018	01-0403	67	95	-----	146	-----	A	A	--	--	--	100
23003	01-2302	81	113	-----	157	-----	B	A	--	--	--	85.7
23008	01-0403	66	93	-----	-----	99	A	A	--	--	--	100
23011	01-1201	73	-----	135	156	-----	A	--	A	--	--	100
23015	01-0403	66	91	-----	-----	102	A	A	--	--	--	100
23016	01-0403	-----	94	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
23017	01-0403	66	93	-----	-----	100	A	A	--	--	--	100
23019	01-0403	-----	93	127	-----	98	--	A	A	--	--	100
23020	01-0403	-----	94	125	148	-----	--	A	A	--	--	100
23024	01-1201	-----	102	131	-----	105	--	A	A	--	--	100
23029	01-0403	66	-----	126	147	-----	A	--	A	--	--	100
24003	01-0403	66	-----	125	151	-----	A	--	A	--	--	100
25003	01-0403	-----	94	126	148	-----	--	A	A	--	--	100
26001	01-0403	68	95	-----	-----	103	A	A	--	--	--	100
26003	01-1201	-----	101	131	154	-----	--	A	A	--	--	100
26006	01-0403	66	-----	126	-----	100	A	--	A	--	--	100
26009	01-1201	72	102	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
27004	01-1201	71	103	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
27013	01-1201	71	102	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
27014	01-1201	-----	104	133	158	-----	--	A	A	--	--	100
27020	01-0403	66	-----	127	147	-----	A	--	A	--	--	100
27044	01-0403	-----	98	132	-----	104	--	B	B	--	--	78.6
27046	01-0403	-----	93	126	147	-----	--	A	A	--	--	100
27049	01-1201	70	-----	132	-----	105	A	--	A	--	--	100
28002	01-1201	72	103	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
28003	01-0403	65	-----	126	-----	99	A	--	A	--	--	100
28011	01-0403	67	-----	128	-----	100	A	--	A	--	--	100
28016	01-0403	-----	92	125	-----	100	--	A	A	--	--	100
28017	01-0403	67	-----	129	151	-----	A	--	A	--	--	100
28031	01-0403	-----	92	125	-----	101	--	A	A	--	--	100
28033	01-1201	-----	100	130	-----	103	--	A	A	--	--	100
28034	01-1201	70	-----	131	-----	106	A	--	A	--	--	100

[10]LDLコレステロール　　自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	01-0403	66	-----	122	-----	101	A	--	B	--	--	92.9
30005	01-0403	65	93	-----	147	-----	A	A	--	--	--	100
31005	01-0403	66	93	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
32001	01-0403	66	-----	126	-----	99	A	--	A	--	--	100
32002	01-0403	67	-----	126	151	-----	A	--	A	--	--	100
33001	01-0403	66	-----	125	148	-----	A	--	A	--	--	100
33005	01-0403	67	94	-----	-----	100	A	A	--	--	--	100
33008	01-0403	-----	93	126	-----	101	--	A	A	--	--	100
33009	01-0403	-----	95	127	-----	102	--	A	A	--	--	100
34004	01-0403	-----	94	127	150	-----	--	A	A	--	--	100
34009	01-1201	71	-----	131	155	-----	A	--	A	--	--	100
34010	01-1201	72	-----	133	-----	105	A	--	A	--	--	100
34011	01-1201	70	-----	128	150	-----	A	--	A	--	--	100
34012	01-1201	71	-----	132	157	-----	A	--	A	--	--	100
34015	01-0403	66	-----	126	149	-----	A	--	A	--	--	100
35001	01-0403	66	-----	126	148	-----	A	--	A	--	--	100
37005	01-1201	72	103	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
37007	01-2302	-----	110	142	151	-----	--	A	A	--	--	100
38004	01-1201	70	-----	131	154	-----	A	--	A	--	--	100
39001	01-1201	71	100	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
39002	01-0403	-----	93	124	145	-----	--	A	A	--	--	100
39003	01-0403	66	-----	124	-----	100	A	--	A	--	--	100
39004	01-1201	72	-----	129	-----	103	A	--	A	--	--	100
40005	01-0403	67	-----	127	148	-----	A	--	A	--	--	100
40007	01-2302	76	108	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
40009	01-2302	79	-----	142	154	-----	A	--	A	--	--	100
40011	01-1201	76	104	-----	-----	108	B	A	--	--	--	78.6
40021	01-1201	-----	102	133	-----	105	--	A	A	--	--	100
40027	01-0403	-----	92	123	-----	99	--	A	A	--	--	100
43001	01-1201	70	100	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
43003	01-0403	66	-----	127	145	-----	A	--	A	--	--	100
44001	01-2801	-----	45	55	-----	74	--	D	D	--	--	0
45002	01-0403	65	-----	125	-----	98	A	--	A	--	--	100
46004	01-0403	-----	96	128	-----	99	--	A	A	--	--	100
47001	01-1201	68	96	-----	145	-----	B	B	--	--	--	71.4
47004	01-1201	71	102	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
47005	01-0403	66	-----	129	152	-----	A	--	A	--	--	100
47006	01-1201	71	102	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
48512	01-0403	65	-----	128	-----	98	A	--	A	--	--	100

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	02-0404	-----	6.7	7.9	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100
01013	01-2901	5.5	6.5	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
01018	02-0401	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
01023	02-0404	-----	6.7	7.9	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
01025	02-0403	-----	6.8	7.9	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
02004	01-2701	5.3	6.2	-----	5.4	5.9	B	B	--	--	--	78.6
03001	01-2901	5.5	6.5	-----	5.3	6.1	A	A	--	--	--	100
03006	01-2901	-----	6.6	7.6	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
04004	01-2901	5.5	6.5	-----	5.3	6.1	A	A	--	--	--	100
04008	01-2901	-----	6.6	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
04009	01-2901	5.6	-----	7.7	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
04010	01-2901	-----	6.7	7.8	5.3	6.1	--	A	B	--	--	92.9
04015	01-2901	5.5	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
07002	02-0404	5.5	-----	7.9	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
07008	03-1201	-----	6.4	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
08001	01-2701	5.4	6.4	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
08003	01-2701	5.6	6.5	-----	5.4	6.2	A	A	--	--	--	100
08006	03-1201	-----	6.5	7.5	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
08009	02-0403	-----	6.8	8.0	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
08010	01-2901	5.4	6.5	-----	5.2	6.0	B	A	--	--	--	92.9
09001	02-0403	5.5	-----	8.0	5.2	5.8	A	--	A	--	--	100
09005	01-2701	-----	6.4	7.4	-----	-----	--	A	A	--	--	100
09012	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
09013	02-0404	5.6	6.7	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
10003	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
10004	02-0404	5.6	-----	7.9	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
10005	01-2901	5.4	-----	7.4	5.3	6.0	B	--	A	--	--	92.9
10007	01-2901	5.5	6.6	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
11006	02-0401	-----	6.9	8.2	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
11010	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
11011	02-0404	5.5	6.9	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
11016	01-2901	5.6	6.6	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
11020	01-2901	-----	6.6	7.6	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
11023	01-2901	-----	6.6	7.6	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
12001	03-3501	5.4	-----	7.4	5.3	6.1	--	--	--	--	--	======
12002	01-2701	5.5	6.5	-----	5.4	6.2	A	A	--	--	--	100
12008	03-0401	5.7	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
12016	01-2901	-----	6.6	7.6	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
13002	01-2701	5.5	-----	7.5	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
13003	01-2701	5.5	6.5	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
13017	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
13026	01-2701	-----	6.5	7.5	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
13053	01-2901	-----	6.6	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13061	03-2701	-----	6.4	7.4	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
13064	03-0401	5.7	-----	6.7	5.3	6.0	A	--	D	--	--	50.0
13074	02-2401	5.6	-----	7.9	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
13084	01-2701	-----	6.4	7.5	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
13094	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13095	01-2901	5.5	-----	7.4	5.5	6.2	A	--	A	--	--	100
13100	02-2401	-----	6.6	7.8	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
13103	02-0404	5.6	6.9	-----	5.4	5.8	A	A	--	--	--	100
14001	02-0404	-----	6.8	7.9	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
14003	01-2701	5.5	6.4	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
14010	03-0401	5.7	-----	7.7	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
14025	02-0404	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
14027	03-1201	5.4	6.5	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14030	03-1201	5.5	6.5	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
15001	03-1201	5.6	-----	7.6	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
15004	01-2901	5.6	-----	7.6	5.5	6.1	A	--	A	--	--	100
15006	01-2901	5.7	6.7	-----	5.5	6.2	B	A	--	--	--	92.9
15011	01-2901	5.6	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
15012	01-2901	5.5	6.5	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
16002	01-2901	5.5	6.5	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
16006	01-2901	5.4	6.4	-----	5.3	5.9	B	A	--	--	--	92.9
17001	01-2901	-----	6.7	7.7	5.4	6.2	--	A	A	--	--	100
18001	02-0404	5.6	6.7	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
20005	03-1201	-----	6.6	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
20007	02-0404	-----	6.7	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
21002	01-2901	-----	6.5	7.6	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
21005	02-0401	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
21006	02-0404	5.6	6.8	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
22001	01-2901	5.5	-----	7.5	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
22002	01-2901	5.6	6.6	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
22003	01-2901	5.6	-----	7.6	5.4	6.2	A	--	A	--	--	100
22004	01-2901	-----	6.5	7.5	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
22006	01-2901	5.6	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
22011	01-2901	-----	6.6	7.6	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100
22012	02-0401	-----	6.8	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
22017	01-2901	5.5	-----	7.5	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
22018	01-2901	5.7	-----	7.6	5.5	6.2	B	--	A	--	--	92.9
23003	02-0404	5.6	-----	7.9	5.2	5.8	A	--	A	--	--	100
23008	02-0404	5.5	6.7	-----	5.3	5.8	A	A	--	--	--	100
23011	01-2901	5.6	-----	7.6	5.5	6.2	A	--	A	--	--	100
23015	01-2901	5.5	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
23016	02-0403	5.5	6.8	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
23017	01-2901	5.7	6.6	-----	5.4	6.1	B	A	--	--	--	92.9
23019	01-2901	-----	-----	-----	5.4	6.2	--	--	--	--	--	======
23020	01-2901	5.6	-----	7.7	5.5	6.2	A	--	A	--	--	100
23024	01-2701	5.5	-----	7.4	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
24003	02-0404	5.5	-----	7.8	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
25003	02-0403	5.6	-----	7.8	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
26001	02-0402	-----	6.7	7.8	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100
26003	01-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	B	A	--	--	--	85.7
26006	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
26009	01-2901	-----	6.7	7.6	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
27004	01-2901	5.6	6.5	-----	5.4	6.2	A	A	--	--	--	100
27013	02-2401	5.5	-----	7.8	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
27014	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
27020	02-0403	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27044	01-2701	-----	6.4	7.2	5.2	6.0	--	A	B	--	--	92.9
27046	01-2901	5.5	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27049	01-2901	5.1	-----	7.1	4.9	5.7	D	--	C	--	--	28.6
28002	01-2901	-----	6.5	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
28003	01-2901	-----	6.5	7.5	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
28011	02-0404	-----	6.8	8.0	5.2	5.8	--	A	A	--	--	100
28016	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
28017	01-2901	-----	6.5	7.5	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
28031	01-2901	5.7	6.7	-----	5.4	6.2	B	A	--	--	--	92.9
28033	01-2901	5.5	6.5	-----	5.4	6.2	A	A	--	--	--	100
28034	03-2701	-----	6.4	7.3	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
30004	02-0404	5.6	-----	7.9	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
30005	01-2901	5.5	-----	7.6	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100

[11]HbA1C 自施設測定結果一覧

施設		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
31005	02-0404	-----	6.8	7.9	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
32001	01-2901	-----	6.6	7.5	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
32002	01-2901	5.3	6.3	-----	5.4	6.0	B	B	--	--	--	64.3
33001	01-2701	5.5	6.5	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
33005	01-2901	5.5	-----	7.5	5.5	6.2	A	--	A	--	--	100
33008	02-0404	5.6	-----	7.9	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
33009	02-0404	5.5	6.8	-----	5.4	6.3	A	A	--	--	--	100
34004	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
34009	01-2901	-----	6.7	7.8	5.3	6.0	--	A	B	--	--	92.9
34010	01-2901	5.6	6.7	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
34011	01-2901	-----	6.5	7.5	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
34012	01-2901	-----	6.7	7.7	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
34015	02-0401	5.6	-----	8.0	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
35001	03-0401	5.7	-----	7.7	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
37005	01-2901	-----	6.7	7.8	5.4	6.1	--	A	B	--	--	92.9
37007	01-2901	5.6	6.7	-----	5.5	6.2	A	A	--	--	--	100
38004	01-2901	5.6	-----	7.6	5.4	6.2	A	--	A	--	--	100
39001	01-2901	5.5	6.5	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
39002	03-1201	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	B	--	A	--	--	92.9
39003	01-2901	5.5	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
39004	01-2701	5.6	-----	7.5	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
40005	01-2901	5.5	6.5	-----	5.5	6.2	A	A	--	--	--	100
40007	02-0404	5.6	-----	7.8	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
40009	01-2901	-----	6.5	7.5	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
40011	01-2701	-----	6.5	7.4	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
40021	01-2901	-----	6.6	7.5	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
40027	03-0401	5.6	-----	7.8	5.2	5.8	A	--	A	--	--	100
43001	03-1201	5.4	6.3	-----	5.2	5.9	A	B	--	--	--	92.9
43003	01-2701	5.5	-----	7.5	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
44001	01-2901	5.5	-----	7.5	-----	-----	A	--	A	--	--	100
45002	03-1201	5.6	6.6	-----	5.4	6.2	A	A	--	--	--	100
46004	03-0401	-----	6.7	7.7	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
47001	01-2701	-----	6.5	7.4	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
47004	01-2701	-----	6.3	7.3	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
47005	01-2701	5.5	6.4	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
47006	01-2701	5.6	-----	7.5	5.4	6.2	A	--	A	--	--	100
48512	01-2901	-----	6.5	7.5	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01001	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01002	1	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
01007	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01013	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01018	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
01023	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01025	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
01027	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	1	3	4	-----	-----	4	1	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
02003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
02004	2	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
03001	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
03004	1	1	4	3	-----	4	-----	-----	5	A	B	A	--	A	--	--	B	92.0
03006	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04004	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
04006	2	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
04008	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
04010	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04012	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
04015	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	1	4	-----	3	4	-----	-----	5	A	B	--	A	A	--	--	B	92.0
06004	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
07002	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
07004	1	1	3	4	-----	5	-----	-----	5	A	A	B	--	B	--	--	B	88.0
07007	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
07008	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
08001	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
08002	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
08003	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
08006	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
08009	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
08010	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
09005	1	1	3	-----	4	-----	5	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
09007	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09008	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09009	1	1	4	-----	4	4	-----	-----	5	A	B	--	B	A	--	--	B	88.0
09010	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
09011	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09012	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
09013	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09014	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
09016	1	1	3	-----	4	-----	5	1	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
10001	1	1	3	4	-----	4	-----	1	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
10002	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
10003	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10004	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
10005	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
10007	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11002	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11004	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11005	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
11006	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11007	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
11010	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11011	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11016	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11020	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11021	1	1	3	-----	4	4	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
11023	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11025	1	1	3	-----	4	4	-----	-----	5	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
12001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12002	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
12003	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12006	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12008	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12010	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12011	1	1	4	-----	3	5	-----	-----	5	A	B	--	A	B	--	--	B	88.0
12012	1	1	3	3	-----	5	-----	-----	5	A	A	A	--	B	--	--	B	92.0
12013	1	1	3	3	-----	-----	5	1	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
12014	1	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
12015	1	1	4	-----	4	4	-----	-----	5	A	B	--	B	A	--	--	B	88.0
12016	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12018	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13001	1	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
13002	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13003	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13004	1	1	4	4	-----	5	-----	-----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
13005	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13006	1	1	3	4	-----	-----	5	1	-----	A	A	B	--	--	B	A	--	92.0
13007	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13008	1	1	5	-----	5	7	-----	-----	7	A	Z	--	Z	Z	--	--	Z	20.0
13010	2	1	4	4	-----	4	-----	1	-----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
13014	1	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
13015	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13017	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13021	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13024	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13026	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13033	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13035	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13036	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13038	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13039	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13045	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13049	1	1	3	3	-----	5	-----	1	-----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
13051	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13053	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13055	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
13056	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13061	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13063	1	1	3	4	-----	5	-----	1	-----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
13064	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13067	1	1	4	-----	3	-----	5	1	-----	A	B	--	A	--	B	A	--	92.0
13074	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13077	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13078	1	1	3	-----	3	3	-----	-----	5	A	A	--	A	B	--	--	B	92.0
13079	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13080	1	1	3	-----	3	-----	7	1	-----	A	A	--	A	--	Z	A	--	80.0
13082	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
13083	1	1	4	-----	4	4	-----	-----	4	A	B	--	B	A	--	--	A	92.0
13084	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13088	1	1	4	4	-----	5	-----	-----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
13090	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
13094	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13095	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13100	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13101	1	1	4	4	-----	4	-----	1	-----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
13103	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13107	1	1	3	4	-----	4	-----	1	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
13108	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13109	1	1	3	-----	4	-----	4	-----	4	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
14001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14002	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
14003	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
14004	2	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
14005	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
14006	1	1	3	3	-----	5	-----	1	-----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
14007	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14010	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14018	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
14022	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14023	1	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
14024	1	1	3	4	-----	5	-----	1	-----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
14025	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14026	1	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
14027	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
14029	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
14030	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
15001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15004	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	5	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
15006	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
15007	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15008	1	1	4	4	-----	4	-----	-----	4	A	B	B	--	A	--	--	A	92.0
15010	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
15011	2	1	3	3	-----	-----	3	1	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
15012	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
16002	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16004	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
16005	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16006	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16008	1	1	3	4	-----	4	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
17001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
17003	1	1	4	-----	3	-----	5	-----	5	A	B	--	A	--	B	--	B	88.0
18001	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
18003	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
20001	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
20002	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
20003	1	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
20004	1	1	3	4	-----	5	-----	1	-----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
20005	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
20007	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21001	1	1	3	4	-----	5	-----	-----	5	A	A	B	--	B	--	--	B	88.0
21002	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21004	1	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
21005	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
21006	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22001	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22002	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
22003	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
22004	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
22006	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22010	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	5	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
22011	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22012	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22015	1	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
22017	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22018	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
22019	1	1	4	4	-----	-----	4	1	-----	A	B	B	--	--	A	A	--	92.0
22023	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23001	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23002	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23005	1	1	4	2	-----	4	-----	1	-----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
23006	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23007	1	1	3	4	-----	4	-----	-----	5	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
23008	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23009	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
23011	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23012	1	1	4	2	-----	4	-----	-----	4	A	B	B	--	A	--	--	A	92.0
23015	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23017	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23018	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23019	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23020	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23024	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23026	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23029	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23032	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23037	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23038	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23040	1	1	3	-----	4	-----	5	1	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
23042	1	1	4	4	-----	4	-----	1	-----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
24001	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
24002	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
24003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
25001	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
25003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26001	2	1	2	-----	2	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
26003	2	1	3	4	-----	4	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
26005	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26006	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
26009	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26012	2	1	3	-----	4	-----	4	1	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
27001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27002	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
27003	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27004	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
27005	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27006	1	1	3	-----	4	-----	5	-----	5	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
27007	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27010	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27013	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27014	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
27018	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
27020	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27023	2	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
27031	2	1	3	4	-----	-----	4	1	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
27037	1	1	4	-----	3	-----	4	1	-----	A	B	--	A	--	A	A	--	96.0
27038	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27041	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27044	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
27045	2	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
27046	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	5	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
27049	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27051	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27061	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28001	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
28002	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
28003	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28007	1	1	3	-----	4	-----	4	-----	4	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
28008	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28011	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28014	1	1	4	3	-----	4	-----	1	-----	A	B	A	--	A	--	A	--	96.0
28015	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
28016	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
28017	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28018	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28019	1	3	1	-----	5	-----	5	-----	1	Z	Z	--	Z	--	B	--	Z	16.0
28024	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
28029	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28031	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
28033	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28034	2	1	4	-----	3	-----	4	-----	4	A	B	--	A	--	A	--	A	96.0
30004	2	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
30005	2	1	4	-----	3	4	-----	-----	4	A	B	--	A	A	--	--	A	96.0
30006	2	1	4	-----	3	-----	5	1	-----	A	B	--	A	--	B	A	--	92.0
31002	2	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
31003	2	1	4	-----	3	4	-----	-----	4	A	B	--	A	A	--	--	A	96.0
31005	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
32001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
32002	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
33001	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33002	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33004	2	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
33005	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33008	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33009	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33014	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
34001	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34002	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
34003	2	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
34004	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
34005	1	1	3	-----	4	-----	5	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
34009	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34010	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[12]尿糖　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
34011	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34012	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34013	2	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
34015	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
35001	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
35006	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
37001	1	1	4	4	-----	5	-----	1	-----	A	B	B	--	B	--	A	--	88.0
37004	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37005	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37007	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
38004	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
38006	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	5	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
38009	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
39001	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
39002	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
39003	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
39004	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40001	1	1	3	4	-----	-----	4	1	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
40002	1	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40005	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40006	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
40007	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40009	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40011	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40015	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40021	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40022	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
40025	1	1	4	-----	4	5	-----	-----	5	A	B	--	B	B	--	--	B	84.0
40027	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40028	1	1	4	-----	3	-----	5	1	-----	A	B	--	A	--	B	A	--	92.0
40029	1	1	3	-----	5	-----	5	-----	4	A	A	--	Z	--	B	--	A	76.0
40030	2	1	3	3	-----	-----	5	1	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
40031	1	1	4	4	-----	4	-----	1	-----	A	B	B	--	A	--	A	--	92.0
40034	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40035	2	1	3	4	-----	5	-----	1	-----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
41001	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
41002	2	1	4	4	-----	5	-----	-----	5	A	B	B	--	B	--	--	B	84.0
42002	1	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
43001	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
43003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
43004	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
43007	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
44001	2	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
44002	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
45002	1	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
46001	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
46004	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47004	2	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
47005	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
47006	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
48512	1	1	3	-----	4	-----	5	1	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01001	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01002	1	4	1	-----	5	3	-----	-----	1	B	A	--	B	A	--	--	A	92.0
01007	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01013	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01018	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
01023	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01025	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
01027	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	2	1	3	-----	-----	4	4	-----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
02003	2	3	1	3	-----	-----	5	5	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
02004	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
03001	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
03004	1	2	1	2	-----	2	-----	-----	1	B	A	B	--	B	--	--	A	88.0
03006	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04004	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
04006	2	3	1	3	-----	-----	4	5	-----	A	A	A	--	--	A	B	--	96.0
04008	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
04010	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04012	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
04015	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
06004	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
07002	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
07004	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
07007	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
07008	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
08001	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
08002	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
08003	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
08006	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
08009	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
08010	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
09005	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
09007	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09008	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09009	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09010	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
09011	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09012	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
09013	1	2	1	2	-----	2	-----	4	-----	B	A	B	--	B	--	A	--	88.0
09014	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
09016	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10001	1	3	1	3	-----	2	-----	4	-----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
10002	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
10003	1	3	1	-----	4	-----	5	4	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
10004	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
10005	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
10007	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11002	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11004	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11005	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
11006	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11007	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
11010	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11011	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11016	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11020	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11021	1	3	1	-----	4	2	-----	-----	1	A	A	--	A	B	--	--	A	96.0
11023	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11025	1	3	1	-----	4	2	-----	-----	1	A	A	--	A	B	--	--	A	96.0
12001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12002	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
12003	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12006	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12008	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12010	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12011	1	2	1	-----	4	3	-----	-----	1	B	A	--	A	A	--	--	A	96.0
12012	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12013	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12014	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12015	1	2	1	-----	4	2	-----	-----	1	B	A	--	A	B	--	--	A	92.0
12016	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12018	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13001	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13002	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13003	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13004	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13005	1	2	1	3	-----	-----	4	4	-----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
13006	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13007	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13008	1	2	1	-----	5	3	-----	-----	1	B	A	--	B	A	--	--	A	92.0
13010	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13014	1	4	1	-----	6	4	-----	-----	1	B	A	--	Z	B	--	--	A	72.0
13015	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13017	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13021	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13024	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13026	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13033	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13035	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13036	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13038	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13039	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13045	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13049	1	3	1	2	-----	2	-----	4	-----	A	A	B	--	B	--	A	--	92.0
13051	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13053	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13055	1	4	1	-----	4	-----	5	4	-----	B	A	--	A	--	B	A	--	92.0
13056	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13061	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13063	1	2	1	3	-----	2	-----	4	-----	B	A	A	--	B	--	A	--	92.0
13064	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13067	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13074	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13077	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13078	1	2	1	-----	4	2	-----	-----	1	B	A	--	A	B	--	--	A	92.0
13079	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13080	1	2	1	-----	4	-----	4	4	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
13082	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
13083	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13084	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13088	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13090	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13094	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13095	2	3	1	3	-----	-----	4	5	-----	A	A	A	--	--	A	B	--	96.0
13100	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13101	1	2	1	3	-----	2	-----	4	-----	B	A	A	--	B	--	A	--	92.0
13103	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13107	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13108	1	3	1	3	-----	3	-----	5	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
13109	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14002	1	2	1	3	-----	2	-----	-----	1	B	A	A	--	B	--	--	A	92.0
14003	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
14004	2	3	1	3	-----	-----	4	5	-----	A	A	A	--	--	A	B	--	96.0
14005	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14006	1	3	1	3	-----	3	-----	5	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
14007	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14010	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14018	2	3	1	-----	4	2	-----	-----	1	A	A	--	A	B	--	--	A	96.0
14022	1	3	1	3	-----	-----	5	5	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
14023	1	3	1	2	-----	3	-----	4	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
14024	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
14025	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14026	1	2	1	-----	3	-----	3	4	-----	B	A	--	B	--	B	A	--	88.0
14027	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
14029	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14030	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
15001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15004	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
15006	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
15007	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15008	1	2	1	3	-----	3	-----	-----	1	B	A	A	--	A	--	--	A	96.0
15010	1	2	1	1	-----	2	-----	4	-----	B	A	Z	--	B	--	A	--	72.0
15011	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15012	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
16002	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16004	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
16005	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16006	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16008	1	3	1	3	-----	2	-----	-----	1	A	A	A	--	B	--	--	A	96.0
17001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
17003	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
18001	1	3	1	3	-----	3	-----	5	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
18003	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
20001	1	3	1	-----	5	-----	5	5	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
20002	2	2	1	3	-----	3	-----	-----	1	B	A	A	--	A	--	--	A	96.0
20003	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
20004	1	3	1	3	-----	3	-----	5	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
20005	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
20007	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21001	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
21002	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21004	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
21005	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
21006	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22001	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22002	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
22003	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
22004	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
22006	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22010	1	3	1	3	-----	2	-----	-----	1	A	A	A	--	B	--	--	A	96.0
22011	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22012	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22015	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
22017	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22018	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
22019	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22023	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23001	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23002	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23005	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23006	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23007	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23008	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23009	1	3	1	-----	4	-----	5	5	-----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
23011	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23012	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23015	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23017	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23018	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23019	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23020	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	3	1	3	-----	-----	5	4	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
23024	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23026	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23029	1	2	1	-----	4	2	-----	-----	1	B	A	--	A	B	--	--	A	92.0
23032	1	2	1	-----	4	-----	4	4	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
23037	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23038	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23040	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23042	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
24001	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
24002	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
24003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
25001	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
25003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26001	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
26003	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26005	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26006	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
26009	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26012	2	3	1	-----	5	-----	5	4	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
27001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27002	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27003	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27004	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
27005	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27006	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
27007	1	3	2	3	-----	-----	5	5	-----	A	B	A	--	--	B	B	--	88.0
27010	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27013	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27014	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
27018	1	3	1	-----	4	-----	5	5	-----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
27020	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27023	2	3	1	-----	5	3	-----	-----	1	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
27031	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27037	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27038	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27041	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27044	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27045	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
27046	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27049	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27051	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27061	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28001	1	3	1	3	-----	-----	4	5	-----	A	A	A	--	--	A	B	--	96.0
28002	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
28003	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28007	1	2	1	-----	4	-----	4	-----	1	B	A	--	A	--	A	--	A	96.0
28008	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28011	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28014	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
28015	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28016	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
28017	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28018	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28019	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	Z	Z	--	B	--	A	--	Z	36.0
28024	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28029	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28031	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
28033	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28034	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
30004	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
30005	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
30006	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31002	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31003	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
31005	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
32001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
32002	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
33001	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33002	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33004	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
33005	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33008	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33009	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33014	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
34001	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34002	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
34003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34004	2	3	2	-----	4	-----	4	4	-----	A	B	--	A	--	A	A	--	96.0
34005	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34009	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34010	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[13]尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
34011	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34012	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34013	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34015	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
35001	1	3	1	-----	4	2	-----	-----	1	A	A	--	A	B	--	--	A	96.0
35006	1	2	1	-----	3	-----	3	-----	1	B	A	--	B	--	B	--	A	88.0
37001	1	3	1	3	-----	3	-----	5	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
37004	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37005	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37007	2	2	1	3	-----	2	-----	-----	1	B	A	A	--	B	--	--	A	92.0
38004	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
38006	1	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
38009	1	2	1	3	-----	-----	4	4	-----	B	A	A	--	--	A	A	--	96.0
39001	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
39002	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
39003	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
39004	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40001	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40002	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40005	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40006	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40007	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40009	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40011	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40015	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40021	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40022	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
40025	1	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40027	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40028	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40029	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
40030	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40031	1	3	1	3	-----	2	-----	4	-----	A	A	A	--	B	--	A	--	96.0
40034	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40035	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
41001	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
41002	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
42002	1	3	1	3	-----	2	-----	-----	1	A	A	A	--	B	--	--	A	96.0
43001	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
43003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
43004	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
43007	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
44001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
44002	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
45002	1	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
46001	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
46004	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47004	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
47005	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
47006	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
48512	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01001	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01002	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
01007	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01013	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
01018	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
01023	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01025	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
01027	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
02003	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
02004	2	1	1	4	-----	1	-----	4	-----	A	A	B	--	A	--	Z	--	76.0
03001	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	3	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
03004	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
03006	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	2	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
04001	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04004	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
04006	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
04008	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
04010	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04012	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
04015	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
06004	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
07002	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
07004	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
07007	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
07008	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
08001	2	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
08002	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
08003	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
08006	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
08009	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
08010	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09001	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
09005	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
09007	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09008	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09009	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09010	1	2	2	-----	2	-----	2	-----	3	B	B	--	A	--	A	--	A	92.0
09011	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09012	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
09013	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
09014	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
09016	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10001	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
10002	1	1	1	3	-----	-----	3	2	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
10003	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
10004	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
10005	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
10007	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11002	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11004	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
11005	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
11006	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11007	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
11010	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11011	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11016	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
11020	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11021	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
11023	2	1	1	-----	3	-----	2	-----	3	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
11025	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
12001	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12002	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
12003	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12006	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12008	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
12010	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
12011	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
12012	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
12013	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12014	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12015	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
12016	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12018	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13001	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
13002	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
13003	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
13004	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13005	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
13006	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
13007	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13008	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
13010	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13014	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
13015	1	1	1	-----	2	-----	2	3	-----	A	A	--	A	--	A	B	--	96.0
13017	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13021	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
13024	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13026	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13033	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13035	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13036	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13038	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13039	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13045	2	1	1	-----	3	-----	2	-----	3	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
13049	1	1	1	4	-----	1	-----	2	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
13051	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13053	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
13055	1	1	1	-----	3	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
13056	1	1	1	4	-----	-----	4	3	-----	A	A	B	--	--	Z	B	--	72.0
13061	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13063	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13064	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13067	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13074	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13077	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13078	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
13079	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13080	1	1	1	-----	3	-----	3	1	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13082	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
13083	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13084	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13088	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	3	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
13090	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
13094	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13095	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13100	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13101	1	1	1	3	-----	1	-----	3	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
13103	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13107	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13108	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13109	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	2	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
14001	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14002	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
14003	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
14004	2	1	1	3	-----	-----	3	2	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
14005	1	1	1	-----	3	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
14006	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
14007	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14010	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14018	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
14022	1	1	1	4	-----	-----	2	2	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
14023	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
14024	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
14025	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14026	1	1	1	-----	3	-----	3	1	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
14027	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
14029	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
14030	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
15001	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15004	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
15006	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
15007	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15008	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
15010	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
15011	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15012	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
16002	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16004	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
16005	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16006	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
16008	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	3	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
17001	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
17003	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
18001	1	1	1	4	-----	1	-----	2	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
18003	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
20001	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
20002	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
20003	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
20004	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
20005	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
20007	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21001	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
21002	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
21004	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
21005	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
21006	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22001	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
22002	2	1	1	3	-----	1	-----	3	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
22003	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
22004	2	1	1	-----	4	-----	3	3	-----	A	A	--	Z	--	B	B	--	72.0
22006	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22010	1	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
22011	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22012	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22015	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
22017	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22018	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
22019	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
22023	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23001	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
23002	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23003	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23005	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
23006	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23007	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23008	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23009	1	1	1	-----	3	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
23011	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
23012	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	2	A	A	A	--	A	--	--	B	96.0
23015	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23017	1	1	1	4	-----	1	-----	2	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
23018	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	2	A	A	--	A	A	--	--	B	96.0
23019	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23020	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	100
23024	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23026	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23029	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
23032	1	1	1	-----	3	-----	3	2	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
23037	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
23038	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23040	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23042	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
24001	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
24002	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
24003	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
25001	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
25003	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26001	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
26003	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26005	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26006	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
26009	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26012	2	1	1	-----	3	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
27001	2	1	1	3	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
27002	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27003	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27004	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
27005	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27006	1	1	1	-----	3	-----	2	-----	2	A	A	--	B	--	A	--	B	92.0

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測定値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
27007	1	1	1	4	-----	-----	2	2	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
27010	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27013	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27014	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
27018	1	1	1	-----	2	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	B	B	--	92.0
27020	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27023	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
27031	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27037	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27038	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27041	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27044	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27045	2	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
27046	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27049	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
27051	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27061	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28001	1	1	1	4	-----	-----	2	2	-----	A	A	B	--	--	A	A	--	96.0
28002	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
28003	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28007	1	1	1	-----	3	-----	2	-----	3	A	A	--	B	--	A	--	A	96.0
28008	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28011	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28014	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
28015	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28016	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
28017	2	1	1	-----	3	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
28018	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28019	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
28024	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28029	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28031	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
28033	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28034	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
30004	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
30005	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
30006	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31002	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
31003	2	1	1	-----	1	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
31005	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
32001	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
32002	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
33001	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33002	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33004	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
33005	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33008	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
33009	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
33014	1	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
34001	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
34002	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
34003	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34004	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
34005	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	2	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
34009	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34010	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100

[14]尿潜血　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値								試料NO別判定値								総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
34011	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34012	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
34013	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34015	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
35001	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
35006	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
37001	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
37004	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37005	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
37007	2	1	1	4	-----	1	-----	-----	4	A	A	B	--	A	--	--	B	92.0
38004	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	4	A	A	--	B	A	--	--	B	92.0
38006	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
38009	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
39001	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
39002	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
39003	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
39004	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40001	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
40002	1	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40005	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40006	1	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40007	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40009	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40011	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40015	1	1	1	3	-----	-----	1	3	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
40021	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40022	2	1	1	3	-----	1	-----	3	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
40025	1	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
40027	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
40028	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
40029	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
40030	2	1	1	4	-----	-----	4	4	-----	A	A	B	--	--	Z	Z	--	56.0
40031	1	1	1	4	-----	1	-----	2	-----	A	A	B	--	A	--	A	--	96.0
40034	2	1	1	-----	1	-----	2	2	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
40035	2	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
41001	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
41002	2	1	1	4	-----	1	-----	-----	3	A	A	B	--	A	--	--	A	96.0
42002	1	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
43001	2	1	1	3	-----	1	-----	3	-----	A	A	A	--	A	--	B	--	96.0
43003	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
43004	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
43007	2	1	1	-----	4	-----	4	-----	4	A	A	--	Z	--	Z	--	B	56.0
44001	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
44002	2	1	1	-----	3	1	-----	-----	3	A	A	--	B	A	--	--	A	96.0
45002	1	1	1	4	-----	1	-----	3	-----	A	A	B	--	A	--	B	--	92.0
46001	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
46004	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47001	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47004	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
47005	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
47006	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
48512	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0

[15]ヘモグロビン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	2	14.6	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
01013	2	14.5	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
01018	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
01023	2	14.6	-----	9.5	12.3	10.0	A	--	A	--	--	100
01025	2	14.5	-----	9.3	12.3	9.7	A	--	A	--	--	100
02004	2	14.6	13.6	-----	12.3	10.0	A	A	--	--	--	100
03001	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
03006	2	14.6	-----	9.4	12.4	10.0	A	--	A	--	--	100
04004	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.7	A	A	--	--	--	100
04008	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
04009	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
04010	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
04015	2	14.4	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
07002	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
07008	2	14.4	13.4	-----	12.3	10.0	A	A	--	--	--	100
08001	1	14.4	13.4	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
08003	2	14.6	-----	9.5	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
08006	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
08009	2	14.2	13.2	-----	12.1	9.9	B	A	--	--	--	92.9
08010	2	14.3	13.3	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
09001	2	14.4	13.4	-----	12.2	10.0	A	A	--	--	--	100
09005	2	14.4	13.4	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
09012	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
09013	2	14.4	-----	9.3	12.2	10.0	A	--	A	--	--	100
10003	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
10004	9	14.8	13.8	-----	12.7	10.2	A	B	--	--	--	92.9
10005	2	14.7	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
10007	2	14.7	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
11006	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
11010	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
11011	2	14.7	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
11016	2	14.6	13.6	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
11020	2	14.6	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
11023	2	14.4	-----	9.5	12.4	10.0	A	--	A	--	--	100
12001	2	14.3	13.3	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
12002	2	14.2	13.3	-----	12.3	9.9	B	A	--	--	--	92.9
12008	2	14.4	-----	9.3	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
12016	2	14.4	13.3	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
13002	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13003	2	14.4	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13017	2	14.7	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13026	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13053	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
13061	2	14.4	-----	9.2	12.0	9.7	A	--	A	--	--	100
13064	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13074	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
13084	2	14.4	13.3	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
13094	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13095	2	14.4	13.5	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
13100	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
13103	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
14001	2	14.3	13.4	-----	12.0	9.8	A	A	--	--	--	100
14003	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
14010	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
14024	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
14025	2	14.5	-----	9.3	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100

[15]ヘモグロビン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	2	14.4	13.3	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
14030	2	14.8	-----	9.5	12.4	9.9	A	--	A	--	--	100
15001	2	14.5	13.5	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100
15004	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
15006	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
15011	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
15012	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
16002	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
16006	2	14.7	-----	9.5	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
17001	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
18001	2	14.3	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
20005	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
20007	2	14.4	13.5	-----	12.1	9.7	A	A	--	--	--	100
21002	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
21005	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
21006	2	14.3	-----	9.2	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
22001	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
22002	2	14.4	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
22003	2	14.5	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
22004	2	14.4	13.4	-----	12.4	10.0	A	A	--	--	--	100
22006	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
22011	2	14.5	-----	9.4	12.2	10.0	A	--	A	--	--	100
22012	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
22017	2	14.2	13.1	-----	12.1	9.9	B	B	--	--	--	78.6
22018	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
23003	2	14.2	13.4	-----	12.1	9.8	B	A	--	--	--	92.9
23008	2	14.2	13.3	-----	12.2	9.9	B	A	--	--	--	92.9
23011	9	14.2	-----	9.2	12.1	9.9	B	--	A	--	--	92.9
23015	2	14.4	13.3	-----	12.1	9.7	A	A	--	--	--	100
23016	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23017	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23019	2	14.2	13.2	-----	12.1	9.8	B	A	--	--	--	92.9
23020	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
23024	2	14.5	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
24003	2	14.4	-----	9.3	12.4	9.9	A	--	A	--	--	100
25003	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
26001	2	14.4	-----	9.2	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
26003	2	14.4	13.3	-----	12.0	9.6	A	A	--	--	--	100
26006	2	14.4	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
26009	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
27001	9	14.3	13.2	-----	12.0	9.7	A	A	--	--	--	100
27004	1	14.1	-----	9.1	12.2	9.8	B	--	B	--	--	71.4
27013	2	14.9	-----	9.8	12.6	10.3	B	--	C	--	--	57.1
27014	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
27020	1	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
27044	2	14.4	13.3	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
27046	1	14.5	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
27049	1	13.9	12.9	-----	12.3	9.8	C	C	--	--	--	42.9
28002	2	14.4	-----	9.3	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
28003	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
28011	2	14.0	13.1	-----	11.6	9.8	B	B	--	--	--	64.3
28016	2	14.7	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
28017	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
28031	2	14.5	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
28033	2	14.7	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
28034	2	14.7	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100

[15]ヘモグロビン　　自施設測定結果一覧

施設		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	2	14.2	-----	9.1	12.1	9.7	B	--	B	--	--	78.6
30005	2	14.3	-----	9.3	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
31005	2	14.6	-----	9.4	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
32001	2	14.5	13.5	-----	12.5	10.1	A	A	--	--	--	100
32002	2	14.5	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
33001	1	14.4	13.3	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
33005	2	14.7	-----	9.4	12.4	10.0	A	--	A	--	--	100
33008	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
33009	1	14.3	13.3	-----	-----	9.8	A	A	--	--	--	100
34004	2	14.5	13.5	-----	12.0	9.8	A	A	--	--	--	100
34009	2	14.4	13.3	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
34010	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.7	A	A	--	--	--	100
34011	9	14.5	13.4	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
34012	2	14.4	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
34015	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
35001	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
37005	2	14.5	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
37007	2	14.4	13.4	-----	12.3	10.1	A	A	--	--	--	100
38004	2	14.8	13.8	-----	12.5	10.2	A	B	--	--	--	92.9
39001	2	14.6	-----	9.5	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
39002	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
39003	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
39004	2	14.6	13.6	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
40005	2	14.7	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40007	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40009	2	14.5	13.5	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100
40011	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40021	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
40027	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
43001	2	14.3	-----	9.2	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
43003	2	14.3	-----	9.3	12.0	9.6	A	--	A	--	--	100
44001	2	14.3	13.3	-----	12.1	9.7	A	A	--	--	--	100
45002	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
46004	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
47001	2	14.2	13.3	-----	12.2	9.8	B	A	--	--	--	92.9
47004	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
47005	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
47006	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.7	A	--	A	--	--	100
48512	2	14.5	-----	9.4	12.3	10.0	A	--	A	--	--	100

[16]赤血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB512	490	-----	355	405	366	A	--	A	--	--	100
01013	JAB517	498	474	-----	417	373	A	B	--	--	--	85.7
01018	JAB512	486	-----	352	407	364	A	--	A	--	--	100
01023	JAB514	486	-----	350	407	366	A	--	A	--	--	100
01025	JAB517	487	-----	345	406	360	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	488	462	-----	405	365	A	A	--	--	--	100
03001	JAB517	486	456	-----	404	361	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	486	-----	345	410	361	A	--	A	--	--	100
04004	JAB512	490	464	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
04008	JAB517	490	-----	353	406	365	A	--	A	--	--	100
04009	JAB512	488	463	-----	407	365	A	A	--	--	--	100
04010	JAB512	490	-----	356	406	365	A	--	A	--	--	100
04015	JAB514	487	462	-----	407	365	A	A	--	--	--	100
07002	JAB512	486	-----	355	407	369	A	--	A	--	--	100
07008	JAB517	493	462	-----	412	369	A	A	--	--	--	100
08001	JAB517	487	461	-----	405	367	A	A	--	--	--	100
08003	JAB512	486	-----	353	408	363	A	--	A	--	--	100
08006	JAJ011	484	460	-----	405	362	--	--	--	--	--	======
08009	JAB517	489	463	-----	409	370	A	A	--	--	--	100
08010	JAB517	488	460	-----	403	364	A	A	--	--	--	100
09001	JAJ012	480	461	-----	404	361	--	--	--	--	--	======
09005	JAB511	468	446	-----	395	359	--	--	--	--	--	======
09012	JAB512	489	-----	352	406	365	A	--	A	--	--	100
09013	JAB514	477	-----	340	395	355	A	--	A	--	--	100
10003	JAB512	488	462	-----	406	366	A	A	--	--	--	100
10004	JAR409	493	467	-----	401	354	--	--	--	--	--	======
10005	JAB512	488	-----	354	404	367	A	--	A	--	--	100
10007	JAB512	493	-----	358	408	368	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	489	-----	355	405	362	A	--	A	--	--	100
11010	JAB512	491	462	-----	404	364	A	A	--	--	--	100
11011	JAB512	487	467	-----	405	369	A	A	--	--	--	100
11016	JAB512	489	462	-----	403	363	A	A	--	--	--	100
11020	JAB512	488	-----	355	404	364	A	--	A	--	--	100
11023	JAB514	486	-----	352	410	367	A	--	A	--	--	100
12001	JAB517	487	461	-----	410	365	A	A	--	--	--	100
12002	JAB517	483	457	-----	413	365	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	488	-----	347	406	361	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	478	451	-----	396	355	A	A	--	--	--	100
13002	JAB514	490	-----	355	412	375	A	--	B	--	--	92.9
13003	JAB517	488	459	-----	403	360	A	A	--	--	--	100
13017	JAB512	496	-----	359	409	370	A	--	A	--	--	100
13026	JAB512	491	-----	356	405	367	A	--	A	--	--	100
13053	JAB512	491	-----	355	408	363	A	--	A	--	--	100
13061	JAB512	484	-----	351	404	364	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	488	464	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
13074	JAB512	490	-----	354	405	363	A	--	A	--	--	100
13084	JAB514	491	462	-----	415	371	A	A	--	--	--	100
13094	JAB512	488	462	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
13095	JAB514	490	465	-----	409	366	A	A	--	--	--	100
13100	JAB512	486	-----	354	407	367	A	--	A	--	--	100
13103	JAB512	489	-----	355	403	367	A	--	A	--	--	100
14001	JAB517	489	468	-----	410	367	A	A	--	--	--	100
14003	JAB512	489	-----	353	405	366	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	489	464	-----	406	363	A	A	--	--	--	100
14024	JAB512	489	-----	354	404	365	A	--	A	--	--	100
14025	JAB517	490	-----	351	410	363	A	--	A	--	--	100

[16]赤血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	JAB517	485	458	-----	402	360	A	A	--	--	--	100
14030	JAB512	486	-----	354	411	365	A	--	A	--	--	100
15001	JAB517	491	458	-----	412	365	A	A	--	--	--	100
15004	JAB512	481	-----	346	398	360	A	--	B	--	--	92.9
15006	JAB512	492	469	-----	411	371	A	A	--	--	--	100
15011	JAB512	483	461	-----	411	362	A	A	--	--	--	100
15012	JAB514	475	-----	340	394	354	A	--	A	--	--	100
16002	JAB512	489	-----	354	402	362	A	--	A	--	--	100
16006	JAB512	491	-----	355	411	368	A	--	A	--	--	100
17001	JAB512	489	460	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	481	455	-----	409	370	A	A	--	--	--	100
20005	JAB512	489	462	-----	403	362	A	A	--	--	--	100
20007	JAB512	487	462	-----	405	364	A	A	--	--	--	100
21002	JAB512	488	462	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
21005	JAB512	488	463	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
21006	JAB517	496	-----	354	414	368	A	--	A	--	--	100
22001	JAB517	490	463	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	481	-----	344	404	358	A	--	A	--	--	100
22003	JAB517	487	-----	347	404	362	A	--	A	--	--	100
22004	JAB511	483	452	-----	407	368	--	--	--	--	--	======
22006	JAB512	486	-----	353	408	368	A	--	A	--	--	100
22011	JAB514	478	-----	342	399	359	A	--	A	--	--	100
22012	JAB512	488	-----	352	405	365	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	486	459	-----	408	367	A	A	--	--	--	100
22018	JAB517	488	460	-----	407	361	A	A	--	--	--	100
23003	JAB514	485	459	-----	404	366	A	A	--	--	--	100
23008	JAJ012	473	451	-----	401	362	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	480	-----	351	405	365	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	492	462	-----	403	361	A	A	--	--	--	100
23016	JAB512	487	-----	352	407	364	A	--	A	--	--	100
23017	JAB512	487	-----	353	406	364	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	501	465	-----	417	368	B	A	--	--	--	92.9
23020	JAB512	505	477	-----	416	371	B	B	--	--	--	71.4
23024	JAB512	488	466	-----	409	367	A	A	--	--	--	100
24003	JAB517	487	-----	347	411	364	A	--	A	--	--	100
25003	JAB512	489	-----	351	405	363	A	--	A	--	--	100
26001	JAC910	479	-----	342	389	355	--	--	--	--	--	======
26003	JAB512	483	461	-----	408	361	A	A	--	--	--	100
26006	JAB512	488	-----	352	410	366	A	--	A	--	--	100
26009	JAB512	489	467	-----	409	369	A	A	--	--	--	100
27001	JAA702	471	451	-----	404	369	--	--	--	--	--	======
27004	JAJ012	480	-----	345	411	370	--	--	--	--	--	======
27013	JAR408	486	-----	352	399	356	--	--	--	--	--	======
27014	JAB512	490	-----	354	405	363	A	--	A	--	--	100
27020	JAB512	489	464	-----	403	365	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	491	465	-----	409	370	A	A	--	--	--	100
27046	JAB514	485	460	-----	402	360	A	A	--	--	--	100
27049	JAJ012	477	454	-----	412	371	--	--	--	--	--	======
28002	JAB517	487	-----	347	405	360	A	--	A	--	--	100
28003	JAB512	494	-----	356	413	367	A	--	A	--	--	100
28011	JAJ803	468	446	-----	389	365	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	490	-----	353	406	367	A	--	A	--	--	100
28017	JAB512	488	463	-----	409	366	A	A	--	--	--	100
28031	JAB514	490	-----	348	406	366	A	--	A	--	--	100
28033	JAB512	495	467	-----	410	373	A	A	--	--	--	100
28034	JAB512	493	-----	357	409	370	A	--	A	--	--	100

[16]赤血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	JAB517	477	-----	338	405	361	B	--	B	--	--	85.7
30005	JAB511	482	-----	348	405	362	--	--	--	--	--	======
31005	JAB512	488	-----	352	408	360	A	--	A	--	--	100
32001	JAB512	486	461	-----	412	371	A	A	--	--	--	100
32002	JAB514	475	449	-----	399	358	A	B	--	--	--	92.9
33001	JAJ011	482	458	-----	407	362	--	--	--	--	--	======
33005	JAB517	486	-----	347	407	367	A	--	A	--	--	100
33008	JAB512	496	464	-----	408	368	A	A	--	--	--	100
33009	JAJ011	486	462	-----	-----	364	--	--	--	--	--	======
34004	JAB512	493	467	-----	409	369	A	A	--	--	--	100
34009	JAB517	491	465	-----	408	368	A	A	--	--	--	100
34010	JAB512	495	470	-----	412	371	A	A	--	--	--	100
34011	JAB514	482	461	-----	403	361	A	A	--	--	--	100
34012	JAB512	483	458	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
34015	JAB512	491	-----	354	408	367	A	--	A	--	--	100
35001	JAB512	491	465	-----	408	366	A	A	--	--	--	100
37005	JAB514	480	457	-----	403	363	A	A	--	--	--	100
37007	JAR409	486	461	-----	395	363	--	--	--	--	--	======
38004	JAR408	477	458	-----	400	356	--	--	--	--	--	======
39001	JAB512	488	-----	351	401	362	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	491	-----	355	408	365	A	--	A	--	--	100
39003	JAB512	493	468	-----	411	370	A	A	--	--	--	100
39004	JAB512	491	462	-----	408	362	A	A	--	--	--	100
40005	JAB512	489	-----	354	402	362	A	--	A	--	--	100
40007	JAB512	491	-----	357	409	368	A	--	A	--	--	100
40009	JAB517	490	462	-----	404	363	A	A	--	--	--	100
40011	JAB512	491	-----	355	412	370	A	--	A	--	--	100
40021	JAB512	491	463	-----	408	367	A	A	--	--	--	100
40027	JAB512	492	-----	356	411	368	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	494	-----	350	408	370	A	--	A	--	--	100
43003	JAB512	496	-----	360	412	370	A	--	A	--	--	100
44001	JAB514	480	456	-----	404	363	A	A	--	--	--	100
45002	JAB512	491	-----	356	410	366	A	--	A	--	--	100
46004	JAB512	489	-----	353	407	367	A	--	A	--	--	100
47001	JAB512	482	454	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
47004	JAB512	493	-----	358	409	366	A	--	A	--	--	100
47005	JAB514	475	-----	341	398	357	A	--	A	--	--	100
47006	JAB512	490	-----	356	406	368	A	--	A	--	--	100
48512	JAB517	487	-----	348	410	368	A	--	A	--	--	100

[17]白血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB512	29	-----	118	70	61	A	--	A	--	--	100
01013	JAB517	28	58	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	28	-----	116	68	59	A	--	A	--	--	100
01023	JAB514	30	-----	120	72	61	A	--	A	--	--	100
01025	JAB517	28	-----	113	70	62	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	30	62	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
03001	JAB517	29	59	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	29	-----	114	50	53	A	--	A	--	--	100
04004	JAB512	30	60	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
04008	JAB517	29	-----	114	70	61	A	--	A	--	--	100
04009	JAB512	29	60	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
04010	JAB512	29	-----	118	68	60	A	--	A	--	--	100
04015	JAB514	29	59	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
07002	JAB512	29	-----	117	69	61	A	--	A	--	--	100
07008	JAB517	28	60	-----	72	62	A	A	--	--	--	100
08001	JAB517	28	58	-----	63	57	A	A	--	--	--	100
08003	JAB512	28	-----	113	38	46	A	--	A	--	--	100
08006	JAJ011	30	59	-----	67	58	--	--	--	--	--	======
08009	JAB517	29	58	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
08010	JAB517	29	59	-----	63	59	A	A	--	--	--	100
09001	JAJ012	30	60	-----	59	55	--	--	--	--	--	======
09005	JAB511	28	56	-----	67	60	--	--	--	--	--	======
09012	JAB512	29	-----	116	67	60	A	--	A	--	--	100
09013	JAB514	31	-----	117	71	59	A	--	A	--	--	100
10003	JAB512	29	60	-----	65	57	A	A	--	--	--	100
10004	JAR409	29	57	-----	56	37	--	--	--	--	--	======
10005	JAB512	29	-----	118	71	61	A	--	A	--	--	100
10007	JAB512	29	-----	118	70	61	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	29	-----	116	69	60	A	--	A	--	--	100
11010	JAB512	29	59	-----	68	62	A	A	--	--	--	100
11011	JAB512	29	60	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
11016	JAB512	29	60	-----	70	63	A	A	--	--	--	100
11020	JAB512	29	-----	118	70	61	A	--	A	--	--	100
11023	JAB514	29	-----	114	68	59	A	--	A	--	--	100
12001	JAB517	29	59	-----	72	62	A	A	--	--	--	100
12002	JAB517	28	58	-----	71	61	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	28	-----	111	70	60	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	30	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
13002	JAB514	29	-----	116	67	59	A	--	A	--	--	100
13003	JAB517	29	58	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
13017	JAB512	30	-----	117	71	62	A	--	A	--	--	100
13026	JAB512	28	-----	116	69	60	A	--	A	--	--	100
13053	JAB512	29	-----	117	70	60	A	--	A	--	--	100
13061	JAB512	28	-----	115	68	60	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	29	58	-----	67	60	A	A	--	--	--	100
13074	JAB512	28	-----	116	70	61	A	--	A	--	--	100
13084	JAB514	29	60	-----	67	59	A	A	--	--	--	100
13094	JAB512	29	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
13095	JAB514	31	60	-----	71	61	A	A	--	--	--	100
13100	JAB512	28	-----	117	70	62	A	--	A	--	--	100
13103	JAB512	29	-----	118	69	59	A	--	A	--	--	100
14001	JAB517	28	58	-----	71	62	A	A	--	--	--	100
14003	JAB512	29	-----	115	69	60	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	28	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
14024	JAB512	30	-----	123	71	63	A	--	A	--	--	100
14025	JAB517	29	-----	117	68	60	A	--	A	--	--	100

[17]白血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	JAB517	29	58	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
14030	JAB512	29	-----	120	38	39	A	--	A	--	--	100
15001	JAB517	29	59	-----	72	62	A	A	--	--	--	100
15004	JAB512	28	-----	112	66	59	A	--	A	--	--	100
15006	JAB512	29	58	-----	67	63	A	A	--	--	--	100
15011	JAB512	30	58	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
15012	JAB514	30	-----	117	63	57	A	--	A	--	--	100
16002	JAB512	29	-----	120	71	61	A	--	A	--	--	100
16006	JAB512	29	-----	120	65	59	A	--	A	--	--	100
17001	JAB512	28	57	-----	68	59	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	30	58	-----	71	63	A	A	--	--	--	100
20005	JAB512	29	59	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
20007	JAB512	28	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
21002	JAB512	29	59	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
21005	JAB512	28	59	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
21006	JAB517	28	-----	112	70	61	A	--	A	--	--	100
22001	JAB517	29	58	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	30	-----	115	69	59	A	--	A	--	--	100
22003	JAB517	29	-----	113	69	60	A	--	A	--	--	100
22004	JAB511	27	55	-----	63	59	--	--	--	--	--	======
22006	JAB512	29	-----	119	70	61	A	--	A	--	--	100
22011	JAB514	30	-----	119	69	61	A	--	A	--	--	100
22012	JAB512	29	-----	114	70	60	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	30	60	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
22018	JAB517	29	59	-----	67	60	A	A	--	--	--	100
23003	JAB514	31	59	-----	68	57	A	A	--	--	--	100
23008	JAJ012	29	58	-----	68	59	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	30	-----	114	67	57	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	28	56	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
23016	JAB512	29	-----	116	69	61	A	--	A	--	--	100
23017	JAB512	29	-----	116	68	61	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	30	58	-----	70	63	A	A	--	--	--	100
23020	JAB512	29	61	-----	72	64	A	A	--	--	--	100
23024	JAB512	27	56	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
24003	JAB517	28	-----	112	70	61	A	--	A	--	--	100
25003	JAB512	28	-----	115	69	60	A	--	A	--	--	100
26001	JAC910	28	-----	112	66	60	--	--	--	--	--	======
26003	JAB512	29	59	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
26006	JAB512	28	-----	114	69	59	A	--	A	--	--	100
26009	JAB512	29	59	-----	53	57	A	A	--	--	--	100
27001	JAA702	28	56	-----	67	60	--	--	--	--	--	======
27004	JAJ012	29	-----	115	69	58	--	--	--	--	--	======
27013	JAR408	29	-----	112	69	61	--	--	--	--	--	======
27014	JAB512	29	-----	120	70	60	A	--	A	--	--	100
27020	JAB512	29	59	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	29	57	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
27046	JAB514	29	60	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
27049	JAJ012	30	59	-----	66	56	--	--	--	--	--	======
28002	JAB517	29	-----	114	71	61	A	--	A	--	--	100
28003	JAB512	29	-----	117	70	61	A	--	A	--	--	100
28011	JAJ803	28	56	-----	61	55	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	29	-----	120	67	62	A	--	A	--	--	100
28017	JAB512	29	58	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
28031	JAB514	30	-----	115	68	58	A	--	A	--	--	100
28033	JAB512	29	60	-----	71	60	A	A	--	--	--	100
28034	JAB512	30	-----	118	72	63	A	--	A	--	--	100

[17]白血球　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	JAB517	29	-----	111	66	61	A	--	A	--	--	100
30005	JAB511	29	-----	117	68	60	--	--	--	--	--	======
31005	JAB512	30	-----	117	70	62	A	--	A	--	--	100
32001	JAB512	26	56	-----	69	61	B	A	--	--	--	85.7
32002	JAB514	30	60	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
33001	JAJ011	30	59	-----	71	60	--	--	--	--	--	======
33005	JAB517	28	-----	113	70	65	A	--	A	--	--	100
33008	JAB512	29	57	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
33009	JAJ011	31	60	-----	-----	60	--	--	--	--	--	======
34004	JAB512	29	59	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
34009	JAB517	29	58	-----	71	62	A	A	--	--	--	100
34010	JAB512	28	60	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
34011	JAB514	29	60	-----	69	62	A	A	--	--	--	100
34012	JAB512	28	55	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
34015	JAB512	29	-----	118	71	61	A	--	A	--	--	100
35001	JAB512	27	57	-----	67	59	A	A	--	--	--	100
37005	JAB514	29	60	-----	70	59	A	A	--	--	--	100
37007	JAR409	29	57	-----	65	45	--	--	--	--	--	======
38004	JAR408	25	57	-----	66	54	--	--	--	--	--	======
39001	JAB512	30	-----	119	73	63	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	29	-----	117	70	62	A	--	A	--	--	100
39003	JAB512	29	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
39004	JAB512	28	57	-----	67	59	A	A	--	--	--	100
40005	JAB512	29	-----	118	69	60	A	--	A	--	--	100
40007	JAB512	28	-----	116	68	60	A	--	A	--	--	100
40009	JAB517	29	58	-----	72	63	A	A	--	--	--	100
40011	JAB512	29	-----	116	68	60	A	--	A	--	--	100
40021	JAB512	28	58	-----	70	59	A	A	--	--	--	100
40027	JAB512	29	-----	115	68	59	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	28	-----	114	70	60	A	--	A	--	--	100
43003	JAB512	27	-----	117	70	59	A	--	A	--	--	100
44001	JAB514	30	60	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
45002	JAB512	29	-----	118	70	61	A	--	A	--	--	100
46004	JAB512	28	-----	117	70	61	A	--	A	--	--	100
47001	JAB512	29	58	-----	72	60	A	A	--	--	--	100
47004	JAB512	28	-----	115	64	60	A	--	A	--	--	100
47005	JAB514	30	-----	115	67	59	A	--	A	--	--	100
47006	JAB512	29	-----	117	71	64	A	--	A	--	--	100
48512	JAB517	29	-----	117	71	62	A	--	A	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB512	41.6	-----	27.9	35.7	30.8	A	--	A	--	--	100
01013	JAB517	42.8	40.1	-----	37.5	32.2	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	41.1	-----	27.3	36.3	31.4	A	--	A	--	--	100
01023	JAB514	41.0	-----	27.5	36.0	31.1	A	--	A	--	--	100
01025	JAB517	41.1	-----	26.9	35.8	30.9	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	40.2	37.4	-----	34.8	30.0	A	A	--	--	--	100
03001	JAB517	41.6	38.6	-----	35.8	30.7	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	41.4	-----	27.6	35.3	30.2	A	--	A	--	--	100
04004	JAB512	41.9	38.9	-----	36.2	31.0	A	A	--	--	--	100
04008	JAB517	42.2	-----	27.4	36.5	31.6	A	--	A	--	--	100
04009	JAB512	41.6	38.5	-----	35.9	30.8	A	A	--	--	--	100
04010	JAB512	41.2	-----	27.5	35.8	30.7	A	--	A	--	--	100
04015	JAB514	41.3	38.4	-----	36.0	31.0	A	A	--	--	--	100
07002	JAB512	41.8	-----	28.0	36.0	30.9	A	--	A	--	--	100
07008	JAB517	42.8	39.1	-----	37.3	31.8	A	A	--	--	--	100
08001	JAB517	41.4	38.7	-----	36.2	31.5	A	A	--	--	--	100
08003	JAB512	41.1	-----	27.5	36.3	30.9	A	--	A	--	--	100
08006	JAJ011	42.6	39.9	-----	36.1	30.2	--	--	--	--	--	======
08009	JAB517	41.7	38.7	-----	36.5	31.6	A	A	--	--	--	100
08010	JAB517	41.8	38.9	-----	36.3	31.6	A	A	--	--	--	100
09001	JAJ012	42.7	39.8	-----	36.7	30.7	--	--	--	--	--	======
09005	JAB511	37.2	34.7	-----	34.4	30.2	--	--	--	--	--	======
09012	JAB512	41.5	-----	27.1	35.9	31.0	A	--	A	--	--	100
09013	JAB514	40.4	-----	26.9	34.9	30.1	A	--	A	--	--	100
10003	JAB512	41.1	38.2	-----	36.1	31.1	A	A	--	--	--	100
10004	JAR409	38.8	35.9	-----	37.5	31.2	--	--	--	--	--	======
10005	JAB512	42.1	-----	28.2	36.4	31.4	A	--	A	--	--	100
10007	JAB512	41.9	-----	28.1	35.7	30.7	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	41.6	-----	27.7	35.8	30.7	A	--	A	--	--	100
11010	JAB512	42.3	39.1	-----	36.0	30.8	A	A	--	--	--	100
11011	JAB512	41.2	38.8	-----	35.8	30.9	A	A	--	--	--	100
11016	JAB512	40.8	38.0	-----	34.9	30.0	A	A	--	--	--	100
11020	JAB512	40.7	-----	27.2	35.3	30.2	A	--	A	--	--	100
11023	JAB514	40.8	-----	27.5	36.2	31.2	A	--	A	--	--	100
12001	JAB517	42.3	39.3	-----	36.5	31.2	A	A	--	--	--	100
12002	JAB517	40.6	38.0	-----	36.5	31.3	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	42.3	-----	27.8	36.4	31.3	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	40.4	37.7	-----	34.8	30.0	A	A	--	--	--	100
13002	JAB514	41.1	-----	27.7	36.3	31.8	A	--	A	--	--	100
13003	JAB517	41.1	38.0	-----	35.6	30.4	A	A	--	--	--	100
13017	JAB512	42.5	-----	28.5	37.0	32.0	A	--	A	--	--	100
13026	JAB512	41.2	-----	27.5	35.0	30.5	A	--	A	--	--	100
13053	JAB512	41.4	-----	27.6	35.5	30.6	A	--	A	--	--	100
13061	JAB512	42.0	-----	28.1	36.2	30.9	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	41.8	38.9	-----	36.0	31.0	A	A	--	--	--	100
13074	JAB512	41.9	-----	27.8	35.1	30.0	A	--	A	--	--	100
13084	JAB514	41.2	38.2	-----	36.8	31.5	A	A	--	--	--	100
13094	JAB512	41.7	38.7	-----	35.5	30.4	A	A	--	--	--	100
13095	JAB514	40.4	37.9	-----	35.5	30.4	A	A	--	--	--	100
13100	JAB512	41.6	-----	27.8	35.9	30.8	A	--	A	--	--	100
13103	JAB512	40.9	-----	27.6	35.5	30.4	A	--	A	--	--	100
14001	JAB517	42.3	39.6	-----	36.6	31.4	A	A	--	--	--	100
14003	JAB512	41.3	-----	27.6	35.7	30.6	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	41.5	38.6	-----	35.6	30.5	A	A	--	--	--	100
14024	JAB512	41.6	-----	27.7	34.9	30.1	A	--	A	--	--	100
14025	JAB517	41.4	-----	27.5	36.3	31.2	A	--	A	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	JAB517	41.0	38.1	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
14030	JAB512	42.7	-----	28.2	35.7	30.6	A	--	A	--	--	100
15001	JAB517	41.7	38.3	-----	36.5	31.5	A	A	--	--	--	100
15004	JAB512	39.9	-----	26.4	33.8	29.3	B	--	B	--	--	85.7
15006	JAB512	42.0	38.9	-----	35.2	30.6	A	A	--	--	--	100
15011	JAB512	41.5	38.8	-----	36.1	30.6	A	A	--	--	--	100
15012	JAB514	40.3	-----	26.8	34.4	29.5	A	--	A	--	--	100
16002	JAB512	40.9	-----	27.2	34.8	30.2	A	--	A	--	--	100
16006	JAB512	41.7	-----	27.8	35.5	30.7	A	--	A	--	--	100
17001	JAB512	41.4	38.3	-----	35.4	30.2	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	40.8	38.0	-----	37.0	31.8	A	A	--	--	--	100
20005	JAB512	41.4	38.4	-----	35.1	30.0	A	A	--	--	--	100
20007	JAB512	41.5	38.4	-----	35.5	30.5	A	A	--	--	--	100
21002	JAB512	41.7	38.6	-----	35.7	30.6	A	A	--	--	--	100
21005	JAB512	41.6	38.5	-----	35.5	30.6	A	A	--	--	--	100
21006	JAB517	41.7	-----	27.5	36.5	31.1	A	--	A	--	--	100
22001	JAB517	41.7	38.6	-----	36.1	31.0	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	40.0	-----	26.7	35.7	30.4	A	--	A	--	--	100
22003	JAB517	41.8	-----	27.3	35.9	30.9	A	--	A	--	--	100
22004	JAB511	38.2	34.9	-----	35.1	30.6	--	--	--	--	--	======
22006	JAB512	40.9	-----	27.3	35.0	30.3	A	--	A	--	--	100
22011	JAB514	39.4	-----	26.3	34.5	29.7	A	--	A	--	--	100
22012	JAB512	41.4	-----	27.5	35.6	30.6	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	40.5	37.3	-----	35.4	30.6	A	A	--	--	--	100
22018	JAB517	41.7	38.6	-----	36.3	31.2	A	A	--	--	--	100
23003	JAB514	39.9	37.2	-----	34.9	30.4	A	A	--	--	--	100
23008	JAJ012	42.5	39.8	-----	36.3	30.4	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	42.7	-----	28.9	36.5	31.0	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	42.5	39.1	-----	36.2	30.9	A	A	--	--	--	100
23016	JAB512	41.8	-----	27.9	36.2	31.1	A	--	A	--	--	100
23017	JAB512	41.8	-----	28.0	35.7	30.5	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	40.9	37.5	-----	36.2	30.6	A	A	--	--	--	100
23020	JAB512	43.8	40.7	-----	36.6	31.3	B	B	--	--	--	85.7
23024	JAB512	41.2	38.8	-----	36.5	31.4	A	A	--	--	--	100
24003	JAB517	41.6	-----	27.2	36.1	31.1	A	--	A	--	--	100
25003	JAB512	42.1	-----	27.9	35.7	30.8	A	--	A	--	--	100
26001	JAC910	39.8	-----	26.4	35.8	30.6	--	--	--	--	--	======
26003	JAB512	42.0	39.3	-----	35.7	30.2	A	A	--	--	--	100
26006	JAB512	42.3	-----	28.1	36.4	31.1	A	--	A	--	--	100
26009	JAB512	41.5	38.9	-----	35.7	30.9	A	A	--	--	--	100
27001	JAA702	43.2	40.5	-----	35.6	30.1	--	--	--	--	--	======
27004	JAJ012	43.2	-----	28.5	37.2	31.6	--	--	--	--	--	======
27013	JAR408	40.1	-----	26.6	36.8	31.3	--	--	--	--	--	======
27014	JAB512	41.9	-----	27.7	36.4	31.5	A	--	A	--	--	100
27020	JAB512	41.7	38.6	-----	35.4	30.3	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	41.2	38.4	-----	35.8	31.1	A	A	--	--	--	100
27046	JAB514	40.7	38.0	-----	35.2	30.3	A	A	--	--	--	100
27049	JAJ012	43.0	40.2	-----	37.6	32.0	--	--	--	--	--	======
28002	JAB517	43.1	-----	28.3	37.0	31.4	A	--	A	--	--	100
28003	JAB512	41.5	-----	27.5	35.7	30.5	A	--	A	--	--	100
28011	JAJ803	37.9	34.9	-----	35.7	32.5	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	41.3	-----	27.5	35.0	30.3	A	--	A	--	--	100
28017	JAB512	42.1	39.2	-----	36.4	31.3	A	A	--	--	--	100
28031	JAB514	40.9	-----	27.1	35.3	30.6	A	--	A	--	--	100
28033	JAB512	42.4	39.2	-----	35.8	31.3	A	A	--	--	--	100
28034	JAB512	42.5	-----	28.0	36.6	31.9	A	--	A	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	JAB517	40.4	-----	26.2	35.7	30.3	A	--	A	--	--	100
30005	JAB511	38.4	-----	25.5	35.1	30.1	--	--	--	--	--	======
31005	JAB512	41.8	-----	27.8	35.7	30.3	A	--	A	--	--	100
32001	JAB512	41.4	38.6	-----	35.9	31.0	A	A	--	--	--	100
32002	JAB514	39.7	36.8	-----	34.5	30.1	A	A	--	--	--	100
33001	JAJ011	41.8	39.1	-----	35.7	29.5	--	--	--	--	--	======
33005	JAB517	41.0	-----	27.0	35.9	31.6	A	--	A	--	--	100
33008	JAB512	42.5	39.1	-----	36.1	31.1	A	A	--	--	--	100
33009	JAJ011	41.7	38.9	-----	-----	30.1	--	--	--	--	--	======
34004	JAB512	41.7	38.8	-----	35.8	30.7	A	A	--	--	--	100
34009	JAB517	41.7	38.6	-----	36.0	30.9	A	A	--	--	--	100
34010	JAB512	41.4	38.6	-----	35.4	30.6	A	A	--	--	--	100
34011	JAB514	39.9	37.5	-----	35.0	30.3	A	A	--	--	--	100
34012	JAB512	41.1	38.3	-----	35.8	31.0	A	A	--	--	--	100
34015	JAB512	41.5	-----	27.5	35.6	30.5	A	--	A	--	--	100
35001	JAB512	41.6	38.7	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
37005	JAB514	40.1	37.6	-----	35.3	30.3	A	A	--	--	--	100
37007	JAR409	37.4	34.7	-----	35.9	31.0	--	--	--	--	--	======
38004	JAR408	39.3	36.7	-----	36.7	31.1	--	--	--	--	--	======
39001	JAB512	42.2	-----	27.9	35.4	30.7	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	41.8	-----	27.8	35.9	30.6	A	--	A	--	--	100
39003	JAB512	41.9	39.0	-----	35.7	30.8	A	A	--	--	--	100
39004	JAB512	41.6	38.4	-----	35.6	30.1	A	A	--	--	--	100
40005	JAB512	41.9	-----	27.8	34.8	30.1	A	--	A	--	--	100
40007	JAB512	42.1	-----	28.3	36.1	30.9	A	--	A	--	--	100
40009	JAB517	41.7	38.5	-----	36.4	31.6	A	A	--	--	--	100
40011	JAB512	42.4	-----	28.2	36.2	31.1	A	--	A	--	--	100
40021	JAB512	42.0	39.0	-----	36.0	30.8	A	A	--	--	--	100
40027	JAB512	42.1	-----	28.1	36.3	31.1	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	41.3	-----	27.2	35.4	30.5	A	--	A	--	--	100
43003	JAB512	42.5	-----	28.3	36.4	31.0	A	--	A	--	--	100
44001	JAB514	40.0	37.6	-----	35.4	30.3	A	A	--	--	--	100
45002	JAB512	41.4	-----	27.6	35.1	30.0	A	--	A	--	--	100
46004	JAB512	41.8	-----	27.7	35.8	30.8	A	--	A	--	--	100
47001	JAB512	40.4	37.5	-----	35.8	31.1	A	A	--	--	--	100
47004	JAB512	42.2	-----	28.0	36.0	30.8	A	--	A	--	--	100
47005	JAB514	40.1	-----	26.8	34.9	30.4	A	--	A	--	--	100
47006	JAB512	42.4	-----	28.4	35.8	31.0	A	--	A	--	--	100
48512	JAB517	41.1	-----	27.1	36.1	31.1	A	--	A	--	--	100

[19]血小板　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB512	35.8	-----	53.1	28.7	28.6	A	--	A	--	--	100
01013	JAB517	37.8	26.7	-----	27.0	25.9	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	34.2	-----	52.4	28.0	28.0	A	--	A	--	--	100
01023	JAB514	34.4	-----	49.1	27.5	26.4	A	--	A	--	--	100
01025	JAB517	36.4	-----	50.0	27.3	25.9	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	35.6	26.5	-----	26.8	26.3	A	A	--	--	--	100
03001	JAB517	36.3	26.7	-----	28.3	26.6	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	37.0	-----	51.7	27.1	25.7	A	--	A	--	--	100
04004	JAB512	35.2	26.6	-----	28.6	27.9	A	A	--	--	--	100
04008	JAB517	37.0	-----	52.3	28.2	27.0	A	--	A	--	--	100
04009	JAB512	35.2	26.9	-----	28.8	28.0	A	A	--	--	--	100
04010	JAB512	35.1	-----	52.1	29.1	28.0	A	--	A	--	--	100
04015	JAB514	35.5	27.0	-----	28.1	28.0	A	A	--	--	--	100
07002	JAB512	36.1	-----	53.7	29.0	27.8	A	--	A	--	--	100
07008	JAB517	35.3	25.9	-----	28.2	27.4	A	A	--	--	--	100
08001	JAB517	36.0	27.4	-----	26.3	24.7	A	A	--	--	--	100
08003	JAB512	36.1	-----	52.6	26.6	26.1	A	--	A	--	--	100
08006	JAJ011	30.8	22.9	-----	24.9	24.4	--	--	--	--	--	======
08009	JAB517	37.3	27.7	-----	27.7	26.3	A	A	--	--	--	100
08010	JAB517	38.7	28.7	-----	27.9	27.3	A	A	--	--	--	100
09001	JAJ012	30.8	23.8	-----	24.1	22.2	--	--	--	--	--	======
09005	JAB511	34.8	27.9	-----	26.9	25.3	--	--	--	--	--	======
09012	JAB512	34.4	-----	53.4	28.2	27.1	A	--	A	--	--	100
09013	JAB514	35.2	-----	50.3	27.3	25.6	A	--	A	--	--	100
10003	JAB512	35.1	26.5	-----	28.4	27.6	A	A	--	--	--	100
10004	JAR409	35.4	28.3	-----	26.3	24.4	--	--	--	--	--	======
10005	JAB512	35.8	-----	52.2	28.6	27.8	A	--	A	--	--	100
10007	JAB512	36.0	-----	53.1	27.4	27.7	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	34.9	-----	52.1	29.0	28.6	A	--	A	--	--	100
11010	JAB512	35.5	27.3	-----	28.2	26.8	A	A	--	--	--	100
11011	JAB512	34.3	26.6	-----	27.6	27.5	A	A	--	--	--	100
11016	JAB512	35.6	26.9	-----	29.1	27.8	A	A	--	--	--	100
11020	JAB512	35.7	-----	53.8	29.0	28.0	A	--	A	--	--	100
11023	JAB514	35.1	-----	52.7	27.2	26.8	A	--	A	--	--	100
12001	JAB517	36.8	26.6	-----	27.6	25.8	A	A	--	--	--	100
12002	JAB517	34.8	26.2	-----	28.6	27.0	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	35.5	-----	48.8	26.8	25.4	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	34.6	26.3	-----	26.7	26.0	A	A	--	--	--	100
13002	JAB514	35.1	-----	52.1	28.0	27.4	A	--	A	--	--	100
13003	JAB517	37.5	28.2	-----	28.6	26.6	A	A	--	--	--	100
13017	JAB512	36.8	-----	54.4	31.2	30.2	A	--	A	--	--	100
13026	JAB512	34.7	-----	51.9	28.0	27.2	A	--	A	--	--	100
13053	JAB512	34.7	-----	52.0	27.3	27.3	A	--	A	--	--	100
13061	JAB512	35.0	-----	52.5	28.5	27.2	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	34.9	27.1	-----	28.2	27.3	A	A	--	--	--	100
13074	JAB512	35.3	-----	52.1	28.2	27.3	A	--	A	--	--	100
13084	JAB514	34.2	27.5	-----	26.4	27.0	A	A	--	--	--	100
13094	JAB512	35.0	27.1	-----	28.2	28.0	A	A	--	--	--	100
13095	JAB514	35.4	26.6	-----	28.3	27.1	A	A	--	--	--	100
13100	JAB512	34.8	-----	51.5	28.0	27.4	A	--	A	--	--	100
13103	JAB512	35.0	-----	53.9	29.2	28.2	A	--	A	--	--	100
14001	JAB517	36.3	27.5	-----	27.9	26.1	A	A	--	--	--	100
14003	JAB512	35.3	-----	52.3	28.2	27.3	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	35.3	26.7	-----	28.8	27.8	A	A	--	--	--	100
14024	JAB512	35.0	-----	51.7	28.5	27.5	A	--	A	--	--	100
14025	JAB517	27.1	-----	52.9	27.6	29.2	D	--	A	--	--	50.0

[19]血小板　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	JAB517	37.7	27.3	-----	28.3	27.0	A	A	--	--	--	100
14030	JAB512	37.0	-----	51.5	24.8	25.5	A	--	A	--	--	100
15001	JAB517	36.9	27.8	-----	28.4	27.2	A	A	--	--	--	100
15004	JAB512	35.8	-----	52.9	27.9	27.0	A	--	A	--	--	100
15006	JAB512	35.7	26.7	-----	28.2	27.3	A	A	--	--	--	100
15011	JAB512	35.3	27.0	-----	28.6	27.0	A	A	--	--	--	100
15012	JAB514	34.9	-----	49.6	26.5	26.0	A	--	A	--	--	100
16002	JAB512	36.3	-----	54.9	29.0	29.2	A	--	A	--	--	100
16006	JAB512	34.4	-----	50.5	28.0	26.2	A	--	A	--	--	100
17001	JAB512	34.0	26.0	-----	27.2	25.7	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	36.6	27.6	-----	27.9	26.8	A	A	--	--	--	100
20005	JAB512	35.8	27.1	-----	28.3	27.9	A	A	--	--	--	100
20007	JAB512	35.1	26.8	-----	28.6	27.9	A	A	--	--	--	100
21002	JAB512	35.5	26.9	-----	28.3	28.0	A	A	--	--	--	100
21005	JAB512	35.4	26.9	-----	28.6	28.3	A	A	--	--	--	100
21006	JAB517	38.0	-----	53.3	28.0	26.9	A	--	A	--	--	100
22001	JAB517	38.2	27.8	-----	27.9	27.1	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	34.4	-----	47.8	25.2	25.3	A	--	A	--	--	100
22003	JAB517	36.5	-----	49.7	28.3	26.6	A	--	A	--	--	100
22004	JAB511	38.0	28.8	-----	28.0	26.5	--	--	--	--	--	======
22006	JAB512	35.3	-----	52.0	28.6	28.3	A	--	A	--	--	100
22011	JAB514	35.1	-----	50.1	26.6	25.3	A	--	A	--	--	100
22012	JAB512	35.3	-----	52.3	28.4	28.0	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	36.4	27.1	-----	27.0	26.5	A	A	--	--	--	100
22018	JAB517	37.5	28.1	-----	28.5	27.3	A	A	--	--	--	100
23003	JAB514	34.8	26.8	-----	27.5	26.8	A	A	--	--	--	100
23008	JAJ012	31.3	23.8	-----	25.0	23.1	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	31.2	-----	47.0	25.0	24.0	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	37.8	28.2	-----	29.4	27.3	A	A	--	--	--	100
23016	JAB512	35.0	-----	51.8	28.3	27.4	A	--	A	--	--	100
23017	JAB512	35.3	-----	50.8	28.0	27.5	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	38.8	28.1	-----	29.3	28.1	A	A	--	--	--	100
23020	JAB512	35.1	27.2	-----	29.0	27.8	A	A	--	--	--	100
23024	JAB512	34.9	26.6	-----	28.2	27.0	A	A	--	--	--	100
24003	JAB517	37.7	-----	50.4	28.5	26.5	A	--	A	--	--	100
25003	JAB512	35.5	-----	52.4	28.9	28.4	A	--	A	--	--	100
26001	JAC910	33.0	-----	46.5	27.2	26.0	--	--	--	--	--	======
26003	JAB512	34.2	25.7	-----	26.1	25.0	A	A	--	--	--	100
26006	JAB512	34.5	-----	53.3	27.4	26.9	A	--	A	--	--	100
26009	JAB512	35.7	26.9	-----	27.7	25.7	A	A	--	--	--	100
27001	JAA702	40.9	30.0	-----	26.7	25.9	--	--	--	--	--	======
27004	JAJ012	33.2	-----	46.5	23.5	22.9	--	--	--	--	--	======
27013	JAR408	34.9	-----	52.4	28.0	27.5	--	--	--	--	--	======
27014	JAB512	35.1	-----	52.5	28.4	27.4	A	--	A	--	--	100
27020	JAB512	35.7	26.7	-----	28.8	28.5	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	35.3	25.9	-----	28.4	27.1	A	A	--	--	--	100
27046	JAB514	36.4	26.7	-----	28.7	27.9	A	A	--	--	--	100
27049	JAJ012	31.0	24.1	-----	23.3	22.5	--	--	--	--	--	======
28002	JAB517	37.7	-----	51.0	27.9	27.5	A	--	A	--	--	100
28003	JAB512	36.6	-----	54.7	28.9	28.4	A	--	A	--	--	100
28011	JAJ803	30.5	23.8	-----	26.4	26.5	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	34.7	-----	52.1	27.9	27.0	A	--	A	--	--	100
28017	JAB512	34.2	26.0	-----	27.7	26.4	A	A	--	--	--	100
28031	JAB514	35.1	-----	49.3	27.6	26.7	A	--	A	--	--	100
28033	JAB512	36.4	27.4	-----	29.0	27.5	A	A	--	--	--	100
28034	JAB512	36.6	-----	54.4	30.4	29.2	A	--	A	--	--	100

[19]血小板　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	JAB517	35.5	-----	45.2	26.7	25.5	A	--	B	--	--	85.7
30005	JAB511	37.0	-----	56.6	28.1	28.0	--	--	--	--	--	======
31005	JAB512	36.4	-----	52.5	25.2	26.9	A	--	A	--	--	100
32001	JAB512	34.2	25.8	-----	28.0	27.1	A	A	--	--	--	100
32002	JAB514	34.6	27.2	-----	26.2	26.4	A	A	--	--	--	100
33001	JAJ011	30.0	22.9	-----	24.9	24.7	--	--	--	--	--	======
33005	JAB517	35.2	-----	49.9	26.6	25.7	A	--	A	--	--	100
33008	JAB512	34.5	26.3	-----	28.0	26.6	A	A	--	--	--	100
33009	JAJ011	31.5	23.5	-----	-----	24.5	--	--	--	--	--	======
34004	JAB512	35.9	26.9	-----	29.5	28.2	A	A	--	--	--	100
34009	JAB517	35.2	26.6	-----	28.2	27.2	A	A	--	--	--	100
34010	JAB512	35.2	27.0	-----	27.7	26.9	A	A	--	--	--	100
34011	JAB514	36.3	27.7	-----	27.3	27.1	A	A	--	--	--	100
34012	JAB512	33.0	25.1	-----	28.3	27.1	A	A	--	--	--	100
34015	JAB512	35.3	-----	52.1	29.6	28.5	A	--	A	--	--	100
35001	JAB512	33.9	25.8	-----	27.0	26.6	A	A	--	--	--	100
37005	JAB514	33.7	25.5	-----	26.6	25.0	A	A	--	--	--	100
37007	JAR409	33.8	26.3	-----	24.3	23.3	--	--	--	--	--	======
38004	JAR408	34.6	27.3	-----	26.9	26.8	--	--	--	--	--	======
39001	JAB512	35.0	-----	50.5	26.8	27.4	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	35.2	-----	52.8	27.9	26.9	A	--	A	--	--	100
39003	JAB512	35.2	26.7	-----	28.1	27.7	A	A	--	--	--	100
39004	JAB512	35.3	26.9	-----	28.2	27.5	A	A	--	--	--	100
40005	JAB512	35.0	-----	51.9	28.1	27.7	A	--	A	--	--	100
40007	JAB512	35.4	-----	53.3	28.5	28.2	A	--	A	--	--	100
40009	JAB517	36.8	27.8	-----	27.4	26.6	A	A	--	--	--	100
40011	JAB512	35.8	-----	51.8	28.3	26.8	A	--	A	--	--	100
40021	JAB512	35.4	27.0	-----	27.9	27.2	A	A	--	--	--	100
40027	JAB512	36.3	-----	53.8	29.3	28.8	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	37.1	-----	50.0	27.4	26.3	A	--	A	--	--	100
43003	JAB512	33.2	-----	50.2	27.5	25.0	A	--	A	--	--	100
44001	JAB514	35.5	25.7	-----	25.8	26.6	A	A	--	--	--	100
45002	JAB512	35.4	-----	51.9	27.6	26.9	A	--	A	--	--	100
46004	JAB512	35.0	-----	52.8	27.9	26.8	A	--	A	--	--	100
47001	JAB512	35.8	26.5	-----	27.5	25.8	A	A	--	--	--	100
47004	JAB512	36.2	-----	53.1	29.6	27.7	A	--	A	--	--	100
47005	JAB514	33.8	-----	48.2	25.7	25.7	A	--	A	--	--	100
47006	JAB512	34.8	-----	52.5	28.1	26.7	A	--	A	--	--	100
48512	JAB517	36.3	-----	51.6	28.8	26.8	A	--	A	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB512	84.9	-----	78.6	88.1	84.2	A	--	A	--	--	100
01013	JAB517	85.9	84.6	-----	89.9	86.3	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	84.6	-----	77.6	89.2	86.3	A	--	A	--	--	100
01023	JAB514	84.4	-----	78.6	88.5	85.0	A	--	A	--	--	100
01025	JAB517	84.3	-----	77.9	88.1	85.8	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	82.0	81.0	-----	86.0	82.0	A	A	--	--	--	100
03001	JAB517	85.6	84.7	-----	88.6	85.0	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	85.2	-----	80.0	86.1	83.7	A	--	A	--	--	100
04004	JAB512	85.5	83.8	-----	88.7	84.9	A	A	--	--	--	100
04008	JAB517	86.2	-----	77.6	89.9	86.6	A	--	A	--	--	100
04009	JAB512	85.2	83.2	-----	88.2	84.4	A	A	--	--	--	100
04010	JAB512	84.1	-----	77.2	88.2	84.1	A	--	A	--	--	100
04015	JAB514	84.8	83.1	-----	88.5	84.9	A	A	--	--	--	100
07002	JAB512	86.0	-----	78.9	88.4	83.7	A	--	A	--	--	100
07008	JAB517	86.8	84.6	-----	90.5	86.2	A	A	--	--	--	100
08001	JAB517	85.0	83.9	-----	89.4	85.8	A	A	--	--	--	100
08003	JAB512	84.6	-----	77.9	89.0	85.1	A	--	A	--	--	100
08006	JAJ011	88.0	86.8	-----	89.1	83.5	--	--	--	--	--	======
08009	JAB517	85.3	83.6	-----	89.2	85.4	A	A	--	--	--	100
08010	JAB517	85.7	84.6	-----	90.1	86.8	A	A	--	--	--	100
09001	JAJ012	89.1	88.1	-----	90.7	84.7	--	--	--	--	--	======
09005	JAB511	79.5	77.8	-----	87.1	84.1	--	--	--	--	--	======
09012	JAB512	84.9	-----	77.0	88.4	84.9	A	--	A	--	--	100
09013	JAB514	84.5	-----	79.0	88.4	84.8	A	--	A	--	--	100
10003	JAB512	84.2	82.7	-----	88.9	85.0	A	A	--	--	--	100
10004	JAR409	78.6	77.0	-----	93.7	88.3	--	--	--	--	--	======
10005	JAB512	86.4	-----	79.7	90.0	85.5	A	--	A	--	--	100
10007	JAB512	85.0	-----	78.5	87.5	83.4	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	85.1	-----	78.0	88.4	84.8	A	--	A	--	--	100
11010	JAB512	86.2	84.6	-----	89.1	84.6	A	A	--	--	--	100
11011	JAB512	84.6	83.1	-----	88.4	83.7	A	A	--	--	--	100
11016	JAB512	83.4	82.3	-----	86.6	82.6	A	A	--	--	--	100
11020	JAB512	83.4	-----	76.6	87.4	83.0	A	--	B	--	--	92.9
11023	JAB514	84.0	-----	78.1	88.3	85.0	A	--	A	--	--	100
12001	JAB517	86.8	85.3	-----	89.0	85.4	A	A	--	--	--	100
12002	JAB517	84.1	83.2	-----	88.4	85.8	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	86.7	-----	80.1	86.7	86.7	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	84.6	83.4	-----	87.9	84.7	A	A	--	--	--	100
13002	JAB514	83.9	-----	78.0	88.1	84.8	A	--	A	--	--	100
13003	JAB517	84.2	82.8	-----	88.3	84.4	A	A	--	--	--	100
13017	JAB512	85.8	-----	79.2	90.6	86.4	A	--	A	--	--	100
13026	JAB512	83.9	-----	77.2	86.4	83.1	A	--	A	--	--	100
13053	JAB512	84.3	-----	77.7	87.0	84.3	A	--	A	--	--	100
13061	JAB512	86.8	-----	80.1	89.6	84.9	A	--	B	--	--	92.9
13064	JAB512	85.7	83.8	-----	88.7	84.9	A	A	--	--	--	100
13074	JAB512	85.5	-----	78.5	86.7	82.6	A	--	A	--	--	100
13084	JAB514	83.9	82.7	-----	88.7	84.9	A	A	--	--	--	100
13094	JAB512	85.5	83.8	-----	87.4	83.5	A	A	--	--	--	100
13095	JAB514	82.6	81.4	-----	86.4	83.0	A	A	--	--	--	100
13100	JAB512	85.6	-----	78.5	88.2	83.9	A	--	A	--	--	100
13103	JAB512	83.6	-----	77.7	88.1	82.8	A	--	A	--	--	100
14001	JAB517	86.5	84.6	-----	89.3	85.6	A	A	--	--	--	100
14003	JAB512	84.5	-----	78.2	88.1	83.6	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	84.9	83.2	-----	87.7	84.0	A	A	--	--	--	100
14024	JAB512	85.1	-----	78.2	86.4	82.5	A	--	A	--	--	100
14025	JAB517	84.5	-----	78.3	88.5	86.0	A	--	A	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
14027	JAB517	84.5	83.2	-----	88.6	85.0	A	A	--	--	--	100
14030	JAB512	87.9	-----	79.7	86.9	83.8	B	--	A	--	--	85.7
15001	JAB517	84.9	83.6	-----	88.6	86.3	A	A	--	--	--	100
15004	JAB512	83.0	-----	76.3	84.9	81.4	B	--	B	--	--	78.6
15006	JAB512	85.4	83.2	-----	85.6	82.5	A	A	--	--	--	100
15011	JAB512	85.9	84.2	-----	87.8	84.5	A	A	--	--	--	100
15012	JAB514	84.8	-----	78.8	87.3	83.3	A	--	A	--	--	100
16002	JAB512	83.6	-----	76.8	86.6	83.4	A	--	B	--	--	92.9
16006	JAB512	84.9	-----	78.3	86.4	83.4	A	--	A	--	--	100
17001	JAB512	84.7	83.2	-----	87.0	82.9	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	84.8	83.5	-----	90.5	85.9	A	A	--	--	--	100
20005	JAB512	84.6	83.1	-----	87.1	82.9	A	A	--	--	--	100
20007	JAB512	85.2	83.1	-----	87.7	83.8	A	A	--	--	--	100
21002	JAB512	85.5	83.5	-----	87.9	83.8	A	A	--	--	--	100
21005	JAB512	85.2	83.2	-----	87.4	83.8	A	A	--	--	--	100
21006	JAB517	84.2	-----	77.6	88.2	84.6	A	--	A	--	--	100
22001	JAB517	85.8	84.1	-----	89.2	85.2	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	83.2	-----	77.6	88.4	84.9	A	--	A	--	--	100
22003	JAB517	85.8	-----	78.8	89.0	85.3	A	--	A	--	--	100
22004	JAB511	79.1	77.2	-----	86.2	83.2	--	--	--	--	--	======
22006	JAB512	84.2	-----	77.3	85.8	82.3	A	--	A	--	--	100
22011	JAB514	82.4	-----	76.9	86.5	82.7	A	--	A	--	--	100
22012	JAB512	84.8	-----	78.1	87.9	83.8	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	83.3	81.3	-----	86.8	83.4	A	A	--	--	--	100
22018	JAB517	85.5	84.0	-----	89.1	86.6	A	A	--	--	--	100
23003	JAB514	82.3	81.0	-----	86.4	83.1	A	A	--	--	--	100
23008	JAJ012	89.8	88.3	-----	90.5	84.1	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	89.0	-----	82.3	90.0	85.0	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	86.4	84.6	-----	89.8	85.6	A	A	--	--	--	100
23016	JAB512	85.8	-----	79.3	88.9	85.4	A	--	A	--	--	100
23017	JAB512	85.8	-----	79.3	87.9	83.8	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	81.7	80.6	-----	86.8	83.2	C	B	--	--	--	50.0
23020	JAB512	86.7	85.3	-----	88.0	84.4	A	B	--	--	--	92.9
23024	JAB512	84.4	83.2	-----	88.7	84.5	A	A	--	--	--	100
24003	JAB517	85.3	-----	78.5	87.8	85.5	A	--	A	--	--	100
25003	JAB512	86.1	-----	79.5	88.1	84.8	A	--	A	--	--	100
26001	JAC910	83.1	-----	77.2	92.0	86.2	--	--	--	--	--	======
26003	JAB512	87.0	84.7	-----	87.5	83.7	B	A	--	--	--	92.9
26006	JAB512	86.7	-----	79.8	88.8	85.0	A	--	A	--	--	100
26009	JAB512	84.9	83.3	-----	87.3	83.7	A	A	--	--	--	100
27001	JAA702	91.9	89.6	-----	88.1	81.6	--	--	--	--	--	======
27004	JAJ012	90.1	-----	82.7	90.6	85.4	--	--	--	--	--	======
27013	JAR408	82.6	-----	75.5	92.2	87.8	--	--	--	--	--	======
27014	JAB512	85.5	-----	78.2	89.9	86.8	A	--	A	--	--	100
27020	JAB512	85.3	83.2	-----	87.8	83.0	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	83.8	82.6	-----	87.9	84.1	A	A	--	--	--	100
27046	JAB514	83.9	82.6	-----	87.6	84.2	A	A	--	--	--	100
27049	JAJ012	90.1	88.6	-----	91.2	86.2	--	--	--	--	--	======
28002	JAB517	88.5	-----	81.6	91.4	87.2	B	--	B	--	--	57.1
28003	JAB512	84.0	-----	77.2	86.4	85.8	A	--	A	--	--	100
28011	JAJ803	80.8	78.6	-----	91.6	89.1	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	84.3	-----	77.9	86.2	82.6	A	--	A	--	--	100
28017	JAB512	86.3	84.7	-----	88.9	85.6	A	A	--	--	--	100
28031	JAB514	83.5	-----	77.9	86.9	83.6	A	--	A	--	--	100
28033	JAB512	85.7	83.9	-----	87.3	83.9	A	A	--	--	--	100
28034	JAB512	86.1	-----	78.4	89.5	86.2	A	--	A	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　自施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
30004	JAB517	84.9	-----	77.7	88.1	83.9	A	--	A	--	--	100
30005	JAB511	79.6	-----	73.4	86.5	83.3	--	--	--	--	--	======
31005	JAB512	85.7	-----	79.0	87.5	84.2	A	--	A	--	--	100
32001	JAB512	85.2	83.7	-----	87.1	83.6	A	A	--	--	--	100
32002	JAB514	83.6	82.0	-----	86.5	84.1	A	A	--	--	--	100
33001	JAJ011	86.7	85.3	-----	87.8	81.4	--	--	--	--	--	======
33005	JAB517	84.4	-----	77.8	88.2	86.1	A	--	A	--	--	100
33008	JAB512	85.8	84.3	-----	88.6	84.5	A	A	--	--	--	100
33009	JAJ011	85.8	84.2	-----	-----	82.8	--	--	--	--	--	======
34004	JAB512	85.1	83.6	-----	88.3	84.0	A	A	--	--	--	100
34009	JAB517	84.8	83.1	-----	88.2	84.0	A	A	--	--	--	100
34010	JAB512	83.6	82.1	-----	85.9	82.5	A	A	--	--	--	100
34011	JAB514	82.8	81.3	-----	86.8	83.9	A	A	--	--	--	100
34012	JAB512	85.1	83.7	-----	88.0	84.6	A	A	--	--	--	100
34015	JAB512	84.5	-----	77.7	87.3	83.1	A	--	A	--	--	100
35001	JAB512	84.7	83.2	-----	87.3	83.6	A	A	--	--	--	100
37005	JAB514	83.5	82.3	-----	87.6	83.5	A	A	--	--	--	100
37007	JAR409	77.0	75.2	-----	90.9	85.6	--	--	--	--	--	======
38004	JAR408	82.3	80.2	-----	91.7	87.4	--	--	--	--	--	======
39001	JAB512	86.5	-----	79.5	88.3	84.8	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	85.1	-----	78.3	88.0	83.8	A	--	A	--	--	100
39003	JAB512	85.0	83.3	-----	86.9	83.2	A	A	--	--	--	100
39004	JAB512	84.7	83.1	-----	87.3	83.1	A	A	--	--	--	100
40005	JAB512	85.7	-----	78.5	86.6	83.1	A	--	A	--	--	100
40007	JAB512	85.7	-----	79.3	88.3	84.0	A	--	A	--	--	100
40009	JAB517	85.4	83.5	-----	90.1	86.3	A	A	--	--	--	100
40011	JAB512	86.4	-----	79.4	87.9	84.1	A	--	A	--	--	100
40021	JAB512	85.5	85.7	-----	88.2	83.9	A	B	--	--	--	85.7
40027	JAB512	85.6	-----	78.9	88.3	84.5	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	85.0	-----	78.4	86.7	83.0	A	--	A	--	--	100
43003	JAB512	85.7	-----	78.6	88.3	83.8	A	--	A	--	--	100
44001	JAB514	83.3	82.5	-----	87.6	83.5	A	A	--	--	--	100
45002	JAB512	84.3	-----	77.5	85.6	82.0	A	--	A	--	--	100
46004	JAB512	85.5	-----	78.5	88.0	83.9	A	--	A	--	--	100
47001	JAB512	83.8	82.6	-----	88.0	85.0	A	A	--	--	--	100
47004	JAB512	85.6	-----	78.2	88.0	84.2	A	--	A	--	--	100
47005	JAB514	84.4	-----	78.6	87.7	85.2	A	--	A	--	--	100
47006	JAB512	86.5	-----	79.8	88.2	84.2	A	--	A	--	--	100
48512	JAB517	84.5	-----	77.9	88.2	84.7	A	--	A	--	--	100

第25回臨床検査精度管理調査

外部施設測定施設評価結果

測定評価結果一覧

・測定値評価
・解析値評価点
・総合評価点

[1]総コレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	77	-----	115	-----	147	165	184	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
01007	008	11	78	97	-----	-----	146	165	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
01019	052	11	78	-----	115	-----	147	167	184	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
01027	052	11	78	96	-----	-----	147	166	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
02001	008	11	77	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	11	77	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
03004	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	11	-----	97	117	136	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	11	77	-----	116	-----	147	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04012	002	11	77	97	-----	-----	147	168	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	11	77	-----	115	135	-----	-----	184	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	11	-----	97	116	-----	147	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	11	77	-----	117	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	11	-----	97	116	-----	149	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	11	77	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	11	-----	95	114	133	-----	163	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
09007	168	21	78	97	-----	-----	148	165	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
09008	062	11	78	-----	116	136	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	11	77	-----	116	-----	149	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	11	78	-----	116	-----	149	167	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	11	-----	96	116	-----	149	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	11	76	-----	113	132	-----	-----	183	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100	53.3	76.7
10001	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	11	78	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	11	78	97	-----	-----	148	168	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	11	78	-----	116	-----	149	169	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11005	175	11	-----	98	117	137	-----	169	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11007	008	11	78	-----	116	135	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	11	-----	97	117	-----	149	-----	189	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11025	100	11	-----	98	117	-----	149	-----	189	208	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12003	006	11	78	97	-----	135	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12006	008	11	77	-----	116	-----	147	166	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	11	77	97	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	11	-----	97	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	11	78	-----	116	135	-----	-----	187	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	11	-----	97	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	11	76	94	-----	-----	145	164	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	80.0	90.0
12015	041	21	-----	97	116	-----	149	-----	186	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12018	041	21	-----	97	117	136	-----	167	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13001	050	21	78	-----	116	134	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13004	200	11	-----	96	115	-----	149	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	11	78	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	11	78	-----	116	-----	149	167	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	11	78	96	-----	-----	149	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	11	-----	96	116	-----	149	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	11	-----	97	116	-----	148	-----	187	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	11	78	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	11	78	-----	116	135	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	11	76	-----	115	-----	146	166	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	21	78	-----	116	-----	148	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13021	002	11	78	-----	116	135	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	11	78	97	-----	136	-----	168	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	11	78	96	-----	135	-----	167	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	11	-----	97	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	11	77	97	-----	-----	148	167	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	11	-----	96	118	-----	150	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
13038	002	11	-----	96	116	-----	149	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	10	100

[1]総コレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	11	-----	96	116	-----	149	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	11	78	97	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	11	78	-----	116	-----	149	167	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13063	050	21	79	96	-----	-----	147	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13067	008	11	-----	97	116	135	-----	165	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13071	075	11	77	-----	114	133	-----	-----	181	201	A	--	A	A	--	--	A	A	100	40.0	70.0
13077	008	11	78	-----	116	-----	147	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	11	-----	96	117	-----	150	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13079	041	21	78	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13080	008	11	78	-----	116	-----	148	166	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	11	78	-----	116	-----	147	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	11	78	-----	116	135	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13088	154	11	79	97	-----	-----	149	169	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	11	78	-----	116	135	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	11	77	97	-----	134	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	11	78	96	-----	-----	149	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	11	78	-----	116	136	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	11	-----	97	116	135	-----	167	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13109	008	11	78	-----	116	134	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	21	78	-----	117	-----	149	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14002	008	11	78	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	11	-----	97	116	135	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14005	137	11	77	-----	116	-----	147	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14006	006	11	-----	96	117	135	-----	169	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14007	041	21	78	-----	117	136	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	11	-----	97	115	135	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	11	-----	97	116	-----	148	-----	186	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	11	78	-----	118	136	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14024	008	11	77	-----	115	134	-----	-----	185	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	11	77	98	-----	135	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	21	-----	97	116	-----	149	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
15007	008	11	78	-----	116	-----	149	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	11	78	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	11	78	96	-----	-----	149	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	11	77	96	-----	135	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	11	-----	96	117	136	-----	169	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	11	-----	96	114	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	11	77	-----	116	-----	148	167	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
18003	008	11	-----	97	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	11	78	96	-----	136	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20002	128	11	78	97	-----	136	-----	168	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	11	77	-----	116	135	-----	-----	185	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	11	77	96	-----	135	-----	166	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	11	78	97	-----	-----	149	168	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	21	-----	96	115	-----	146	-----	185	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22007	144	21	78	-----	115	-----	147	165	184	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22010	006	11	78	-----	118	135	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	11	77	-----	116	-----	148	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22019	006	11	-----	97	117	-----	150	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22023	129	11	78	97	-----	136	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	21	-----	96	113	134	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23002	172	11	-----	97	116	136	-----	168	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	11	-----	97	116	-----	149	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	11	77	-----	116	-----	148	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	10	100

[1]総コレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	11	78	97	-----	136	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	11	78	98	-----	-----	149	169	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	11	-----	97	116	-----	148	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23022	006	11	-----	96	117	-----	150	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23026	088	11	-----	97	116	-----	149	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	11	78	97	-----	-----	149	169	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	11	78	97	-----	-----	150	169	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	11	-----	97	116	-----	149	-----	188	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	11	77	96	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	11	77	-----	116	-----	148	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	11	-----	97	115	-----	148	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	11	77	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	11	77	97	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	11	77	97	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	11	-----	97	116	-----	148	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	11	-----	96	115	134	-----	166	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	21	77	96	-----	-----	147	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	11	77	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	11	78	97	-----	136	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27002	008	11	77	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	11	-----	97	115	135	-----	166	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	11	77	-----	115	-----	149	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	21	-----	96	115	135	-----	166	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	11	77	97	-----	-----	149	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	11	-----	97	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27018	060	11	-----	97	115	135	-----	166	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	11	77	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	11	77	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27037	200	11	77	-----	115	-----	149	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	11	78	-----	116	134	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	11	77	-----	116	-----	149	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	11	78	97	-----	136	-----	168	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27045	200	11	77	-----	115	-----	149	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	11	77	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	11	78	96	-----	135	-----	167	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	11	-----	96	115	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	11	77	-----	115	-----	149	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	11	-----	97	117	136	-----	166	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
28007	197	11	-----	96	114	-----	148	-----	187	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
28008	090	11	-----	97	116	-----	148	-----	187	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28014	008	11	77	-----	116	-----	148	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	11	-----	96	116	135	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	11	-----	97	117	-----	151	-----	189	209	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28019	002	11	78	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	11	78	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	11	78	-----	117	135	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	11	77	-----	115	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	11	78	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	11	77	-----	116	135	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	11	78	97	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33002	065	11	77	96	-----	134	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	11	78	97	-----	-----	147	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	11	79	-----	118	-----	150	167	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34001	008	11	-----	98	116	136	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	11	-----	97	116	-----	147	-----	186	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34003	008	11	78	97	-----	-----	148	166	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[1]総コレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	11	79	98	-----	-----	149	168	-----	208	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34013	112	11	-----	98	117	137	-----	168	-----	208	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
35006	109	11	78	-----	118	138	-----	-----	189	209	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
36002	161	11	77	-----	116	136	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	11	-----	96	115	-----	147	-----	185	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	11	77	96	-----	134	-----	164	184	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
38006	054	11	77	-----	115	135	-----	-----	185	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	11	78	97	-----	136	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40001	193	11	-----	96	114	-----	146	-----	184	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40002	193	11	-----	97	115	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	21	77	-----	116	136	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	21	77	97	-----	135	-----	166	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	11	-----	98	118	137	-----	168	-----	209	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
40015	008	11	-----	96	115	-----	147	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	21	-----	96	115	-----	147	-----	185	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	11	78	98	-----	137	-----	169	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	21	-----	97	115	-----	148	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40028	200	11	77	-----	115	-----	149	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	11	77	-----	114	134	-----	-----	184	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	11	78	-----	117	-----	149	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40031	151	11	77	95	-----	-----	146	166	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40034	193	11	77	-----	114	-----	146	164	184	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
40035	165	21	77	96	-----	-----	148	166	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	11	77	97	-----	135	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	11	-----	96	115	134	-----	166	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	21	-----	97	116	136	-----	166	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42002	008	11	-----	96	115	-----	147	-----	186	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	21	78	-----	116	134	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	11	77	-----	115	-----	148	165	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
44002	193	11	77	96	-----	-----	146	164	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
46001	193	11	76	-----	114	134	-----	-----	184	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[2]中性脂肪　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	21	54	-----	79	-----	100	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01007	008	21	54	66	-----	-----	99	112	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01019	052	21	54	-----	79	-----	100	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01027	052	21	54	66	-----	-----	100	112	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	21	53	65	-----	-----	98	110	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	21	53	-----	78	90	-----	-----	124	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
03004	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	21	-----	66	78	91	-----	112	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	21	53	-----	79	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04012	002	21	54	67	-----	-----	100	112	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	21	53	-----	77	89	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	21	-----	66	77	-----	98	-----	121	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	21	53	-----	77	89	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	21	-----	64	76	-----	97	-----	121	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	21	54	-----	78	90	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	21	-----	65	77	89	-----	109	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09007	168	21	54	66	-----	-----	100	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	21	54	-----	77	-----	98	109	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
09010	002	21	54	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	21	-----	66	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	21	53	-----	77	89	-----	-----	121	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
10001	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	21	54	66	-----	91	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	21	54	66	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	21	52	-----	77	-----	98	110	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11005	175	21	-----	65	77	91	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11007	008	21	54	-----	77	89	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	21	-----	64	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11025	100	21	-----	65	78	-----	98	-----	123	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12003	006	21	53	67	-----	91	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
12006	008	21	54	-----	77	-----	97	108	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
12010	122	21	54	66	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	21	-----	65	77	90	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	21	53	-----	77	90	-----	-----	122	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	21	-----	65	77	90	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	21	53	65	-----	-----	97	108	-----	132	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
12015	041	21	-----	65	78	-----	99	-----	125	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12018	041	21	-----	65	78	91	-----	111	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13001	050	21	53	-----	79	90	-----	-----	126	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
13004	200	21	-----	65	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	21	54	66	-----	91	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	21	54	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	21	54	66	-----	-----	99	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	21	-----	66	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	21	-----	65	77	-----	98	-----	122	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	21	54	-----	77	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	21	54	-----	79	-----	100	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	21	53	-----	78	-----	98	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13021	002	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	21	53	65	-----	89	-----	110	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	21	54	66	-----	91	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	21	-----	65	77	90	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	21	53	65	-----	-----	97	109	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	21	-----	66	78	-----	99	-----	124	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13038	002	21	-----	66	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[2]中性脂肪　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	21	-----	66	78	-----	99	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	21	53	65	-----	89	-----	110	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	21	54	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	11	-----	66	78	91	-----	113	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13063	050	21	53	65	-----	-----	98	112	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13067	008	21	-----	65	77	90	-----	109	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13071	075	21	53	-----	77	89	-----	-----	121	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13077	008	21	53	-----	77	-----	97	110	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	21	-----	66	78	-----	99	-----	124	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13079	041	21	53	65	-----	-----	99	111	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
13080	008	21	53	-----	78	-----	98	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	21	54	-----	78	-----	98	109	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
13083	008	21	53	-----	77	90	-----	-----	120	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
13088	154	11	54	66	-----	-----	100	113	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	53.3	76.7
13089	002	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	21	53	65	-----	90	-----	110	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	21	54	66	-----	-----	99	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	21	-----	65	77	90	-----	109	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13109	008	21	53	-----	77	89	-----	-----	121	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	21	53	-----	78	-----	99	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14002	008	21	53	-----	77	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	21	-----	66	77	90	-----	109	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14005	137	21	54	-----	78	-----	98	111	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14006	006	21	-----	66	78	91	-----	112	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14007	041	21	53	-----	78	90	-----	-----	124	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	21	-----	66	78	90	-----	110	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	21	-----	65	77	-----	97	-----	122	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	21	54	-----	79	91	-----	-----	124	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14024	008	21	53	-----	77	90	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	21	53	65	-----	89	-----	109	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	21	-----	65	78	-----	100	-----	124	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
15007	008	21	53	-----	78	-----	97	109	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	21	54	66	-----	-----	99	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	21	-----	66	79	92	-----	112	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	21	-----	66	78	-----	100	-----	124	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	21	53	-----	77	-----	97	110	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
18003	008	21	-----	66	78	90	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	21	54	67	-----	91	-----	112	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20002	128	21	53	65	-----	89	-----	110	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	21	53	-----	79	91	-----	-----	125	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	21	53	66	-----	91	-----	112	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	21	53	65	-----	-----	98	110	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	21	-----	66	78	-----	98	-----	125	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
22007	144	21	54	-----	79	-----	99	112	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22010	006	21	54	-----	79	91	-----	-----	124	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	21	53	-----	78	-----	98	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22019	006	21	-----	67	78	-----	99	-----	125	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
22023	129	21	53	65	-----	89	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	21	-----	65	78	90	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23002	172	21	-----	65	77	89	-----	110	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	21	-----	65	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	21	53	-----	78	-----	98	111	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[2]中性脂肪　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	21	-----	66	78	-----	98	-----	122	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23022	006	21	-----	67	79	-----	100	-----	124	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23026	088	21	-----	65	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	21	-----	65	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	21	53	65	-----	-----	98	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	21	53	-----	78	-----	98	111	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	21	-----	66	77	-----	98	-----	123	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	21	-----	65	78	90	-----	111	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	21	53	65	-----	90	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	21	54	66	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	21	54	66	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	21	-----	65	78	-----	97	-----	122	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	21	-----	65	78	90	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	21	53	65	-----	-----	99	111	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	21	53	65	-----	89	-----	109	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
27002	008	21	54	-----	78	89	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	21	-----	65	78	90	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	21	-----	66	79	90	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	21	53	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	21	-----	66	79	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	21	53	65	-----	-----	98	109	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	21	-----	65	78	91	-----	109	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27018	060	21	-----	66	79	90	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	21	53	65	-----	-----	98	110	-----	133	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	21	52	-----	78	90	-----	-----	123	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
27037	200	21	53	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	21	54	-----	78	90	-----	-----	122	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	21	53	-----	77	-----	98	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	21	52	64	-----	87	-----	107	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	53.3	76.7
27045	200	21	53	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	21	53	65	-----	90	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	21	54	66	-----	91	-----	111	123	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	21	-----	65	78	90	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	21	53	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	21	-----	66	78	90	-----	111	-----	133	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
28007	197	21	-----	65	77	-----	97	-----	122	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
28008	090	21	-----	65	77	-----	98	-----	124	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
28014	008	21	54	-----	77	-----	97	110	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	21	-----	66	78	91	-----	111	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	21	-----	64	77	-----	96	-----	119	131	--	A	A	--	A	--	A	A	100	53.3	76.7
28019	002	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	21	54	-----	78	91	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	21	54	-----	78	91	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	21	53	-----	78	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	21	53	65	-----	-----	97	110	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	21	54	-----	78	90	-----	-----	123	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	21	53	66	-----	-----	97	109	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
33002	065	21	53	65	-----	89	-----	110	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	21	53	65	-----	-----	97	110	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	21	56	-----	80	-----	100	112	125	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	73.3	83.3
34001	008	21	-----	66	78	90	-----	109	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	21	-----	66	77	-----	98	-----	123	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34003	008	21	54	65	-----	-----	98	110	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7

[2]中性脂肪　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	21	54	66	-----	-----	99	111	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34013	112	21	-----	66	78	90	-----	111	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
35006	109	21	53	-----	77	89	-----	-----	122	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
36002	161	21	53	-----	77	90	-----	-----	124	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
37001	058	21	-----	64	76	-----	97	-----	121	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	21	54	66	-----	91	-----	111	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	21	53	-----	78	90	-----	-----	124	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	21	54	66	-----	91	-----	112	124	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40001	193	21	-----	66	79	-----	100	-----	124	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40002	193	21	-----	66	79	-----	100	-----	123	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
40004	165	21	53	-----	78	91	-----	-----	125	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	21	53	66	-----	91	-----	112	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	21	-----	65	77	90	-----	110	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40015	008	21	-----	66	78	-----	99	-----	124	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	21	-----	66	79	-----	99	-----	124	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	21	53	65	-----	89	-----	110	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	21	-----	65	79	-----	100	-----	125	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
40028	200	21	53	-----	78	-----	99	111	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	21	54	-----	79	91	-----	-----	124	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	21	52	-----	77	-----	97	109	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40031	151	21	54	65	-----	-----	95	108	-----	133	A	A	--	--	A	A	--	A	100	60.0	80.0
40034	193	21	54	-----	79	-----	100	112	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40035	165	21	53	66	-----	-----	100	112	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	21	53	65	-----	90	-----	109	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	21	-----	66	79	91	-----	112	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	21	-----	66	79	91	-----	113	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
42002	008	21	-----	66	77	-----	99	-----	124	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	21	53	-----	77	89	-----	-----	123	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	21	53	-----	77	-----	97	109	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
44002	193	21	54	66	-----	-----	100	112	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	21	54	-----	79	91	-----	-----	124	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[3]尿酸　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
01007	008	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
01019	052	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01027	052	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	31	5.1	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
03004	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04012	002	31	5.2	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
09004	075	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09007	168	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
10001	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
11004	160	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11005	175	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11007	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	31	-----	5.4	5.9	-----	6.7	-----	7.4	8	--	A	A	--	A	--	B	A	93.3	80.0	86.7
11025	100	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12003	006	31	5	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
12006	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12015	041	31	-----	5.6	6.1	-----	6.9	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	B	--	A	A	93.3	73.3	83.3
12018	041	31	-----	5.6	6.1	6.5	-----	7.2	-----	8.2	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
13001	050	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	7.9	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13004	200	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
13016	041	31	5.2	-----	6	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
13021	002	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	31	5.1	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.7	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.8	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
13036	006	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
13038	002	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[3]尿酸　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	31	5.1	5.5	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13063	050	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13067	008	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13071	075	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13077	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13079	041	31	5.2	5.6	-----	-----	6.8	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
13080	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	31	5.1	-----	6	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13088	154	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	31	5.1	5.6	-----	6.5	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	31	-----	5.5	5.9	6.5	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13109	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	31	5.2	-----	6.1	-----	6.8	7.3	7.7	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	93.3	73.3	83.3
14002	008	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	31	-----	5.6	6.1	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
14005	137	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.7	-----	B	--	A	--	B	B	A	--	80.0	60.0	70.0
14006	006	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
14007	041	31	5.2	-----	6.1	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
14018	008	31	-----	5.5	6	6.5	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14024	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	31	-----	5.6	6.1	-----	6.9	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	B	--	A	A	93.3	73.3	83.3
15007	008	31	5.1	-----	6.1	-----	6.8	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
15008	002	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
18003	008	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20002	128	31	5	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.7	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22007	144	31	5.2	-----	6	-----	6.8	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
22010	006	31	5.1	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.7	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
22019	006	31	-----	5.5	6	-----	6.8	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22023	129	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
23002	172	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[3]尿酸　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	31	5.1	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	31	-----	5.6	6	-----	6.8	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23022	006	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23026	088	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27002	008	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	31	-----	5.6	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27006	200	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27018	060	31	-----	5.6	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27023	090	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27037	200	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27045	200	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	31	-----	5.6	6	6.5	-----	7.1	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28007	197	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28008	090	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28014	008	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28019	002	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.7	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
28024	006	31	5.1	-----	5.9	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8.1	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33002	065	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	31	5.3	-----	6.1	-----	6.9	7.3	7.8	-----	B	--	A	--	B	B	B	--	73.3	60.0	66.7
34001	008	31	-----	5.6	6	6.4	-----	7.2	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34003	008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.2	-----	8.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3

[3]尿酸　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	31	5.1	5.6	-----	-----	6.8	7.3	-----	8.2	A	A	--	--	A	B	--	A	93.3	53.3	73.3
34013	112	31	-----	5.6	6.1	6.6	-----	7.3	-----	8.2	--	A	A	B	--	B	--	A	86.7	46.7	66.7
35006	109	31	5.2	-----	6	6.4	-----	-----	7.5	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
36002	161	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40001	193	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8.1	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40002	193	31	-----	5.6	6	-----	6.7	-----	7.6	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	31	-----	5.6	6	6.4	-----	7.1	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
40015	008	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	31	-----	5.5	6	-----	6.7	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	31	5.1	5.6	-----	6.4	-----	7.2	7.6	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	31	-----	5.5	5.9	-----	6.6	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40028	200	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.1	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	31	5.1	-----	6	6.5	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	31	5.2	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40031	151	31	5.1	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
40034	193	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7.2	7.6	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40035	165	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	31	5.1	5.5	-----	6.4	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	31	-----	5.5	5.9	6.4	-----	7	-----	8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	31	-----	5.5	6	6.4	-----	7.1	-----	8.1	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42002	008	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	31	5.1	-----	6	-----	6.7	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
44002	193	31	5.1	5.6	-----	-----	6.7	7.2	-----	8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	31	5.1	-----	6	6.4	-----	-----	7.6	8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[4]クレアチニン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	21	1	-----	2.19	-----	3.2	3.8	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01007	008	21	1	1.6	-----	-----	3.19	3.8	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01019	052	21	1	-----	2.19	-----	3.19	3.8	4.39	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01027	052	21	1	1.6	-----	-----	3.19	3.8	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	21	1.03	1.62	-----	-----	3.23	3.83	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	21	1.05	-----	2.26	2.87	-----	-----	4.48	5.09	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
03004	002	21	-----	1.61	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	21	-----	1.6	2.19	2.81	-----	3.81	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	21	0.99	-----	2.19	-----	3.2	3.8	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04012	002	21	1	1.6	-----	-----	3.21	3.84	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	21	1	-----	2.19	2.82	-----	-----	4.44	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	21	-----	1.61	2.19	-----	3.2	-----	4.42	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	21	1.01	-----	2.23	2.83	-----	-----	4.43	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	21	-----	1.6	2.23	-----	3.23	-----	4.48	5.09	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	21	1	-----	2.22	2.83	-----	-----	4.42	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	21	-----	1.61	2.21	2.83	-----	3.81	-----	4.99	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09007	168	21	1	1.59	-----	-----	3.19	3.79	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	21	1.02	-----	2.22	2.82	-----	-----	4.44	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	21	1.02	-----	2.22	-----	3.22	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.82	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	21	-----	1.61	2.22	-----	3.23	-----	4.44	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	21	1	-----	2.19	2.8	-----	-----	4.37	4.98	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
10001	002	21	-----	1.61	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	21	1.01	1.61	-----	2.81	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	21	1.03	1.62	-----	-----	3.24	3.87	-----	5.09	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	21	0.97	-----	2.17	-----	3.19	3.82	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11005	175	21	-----	1.62	2.25	2.87	-----	3.91	-----	5	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
11007	008	21	1.02	-----	2.22	2.81	-----	-----	4.41	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	21	-----	1.6	2.2	-----	3.24	-----	4.5	5.14	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
11025	100	21	-----	1.6	2.18	-----	3.23	-----	4.4	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
12003	006	21	0.98	1.58	-----	2.79	-----	3.77	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
12006	008	21	1.01	-----	2.2	-----	3.22	3.83	4.45	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	21	1.02	1.62	-----	2.84	-----	3.85	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	21	-----	1.6	2.2	2.8	-----	3.82	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	21	1.01	-----	2.21	2.85	-----	-----	4.45	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	21	-----	1.61	2.22	2.84	-----	3.86	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	21	1	1.6	-----	-----	3.22	3.8	-----	5	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12015	041	21	-----	1.58	2.17	-----	3.21	-----	4.39	4.99	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12018	041	21	-----	1.58	2.18	2.78	-----	3.79	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13001	050	21	1	-----	2.18	2.77	-----	-----	4.42	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
13004	200	21	-----	1.61	2.21	-----	3.23	-----	4.43	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	21	1.01	1.61	-----	2.81	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	21	1.01	-----	2.22	-----	3.23	3.82	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	21	1.01	1.61	-----	-----	3.23	3.82	-----	5.06	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	21	-----	1.61	2.21	-----	3.23	-----	4.44	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	21	-----	1.63	2.22	-----	3.24	-----	4.42	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	21	1	1.6	-----	-----	3.21	3.82	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	21	1.03	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.42	5.03	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	21	1.01	-----	2.23	-----	3.27	3.88	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	21	0.99	-----	2.17	-----	3.19	3.8	4.41	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13021	002	21	1.01	-----	2.22	2.81	-----	-----	4.44	5.07	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	21	1.02	1.63	-----	2.84	-----	3.86	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	21	1.01	1.61	-----	2.81	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	21	-----	1.61	2.22	2.84	-----	3.86	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	21	1.01	1.6	-----	-----	3.22	3.82	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	21	-----	1.58	2.18	-----	3.18	-----	4.38	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13038	002	21	-----	1.61	2.22	-----	3.23	-----	4.44	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	21	-----	1.61	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[4]クレアチニン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	21	-----	1.61	2.22	2.81	-----	3.82	-----	5.06	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	21	-----	1.61	2.21	-----	3.23	-----	4.44	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	21	1.02	1.62	-----	2.82	-----	3.8	4.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	21	1.01	-----	2.22	-----	3.23	3.82	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	21	-----	1.61	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	21	-----	1.57	2.17	2.78	-----	3.78	-----	4.99	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13063	050	21	0.99	1.59	-----	-----	3.19	3.77	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
13067	008	21	-----	1.63	2.22	2.83	-----	3.84	-----	5.03	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13071	075	21	0.99	-----	2.22	2.81	-----	-----	4.41	4.99	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13077	008	21	1.03	-----	2.2	-----	3.2	3.84	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	21	-----	1.58	2.18	-----	3.17	-----	4.37	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
13079	041	21	0.99	1.58	-----	-----	3.19	3.78	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13080	008	21	1.02	-----	2.19	-----	3.22	3.8	4.41	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	21	1.01	-----	2.21	-----	3.2	3.81	4.45	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	21	1.01	-----	2.21	2.83	-----	-----	4.46	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
13088	154	21	1	1.6	-----	-----	3.22	3.85	-----	5.07	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	21	1.01	-----	2.22	2.81	-----	-----	4.44	5.07	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	21	1.02	1.62	-----	2.82	-----	3.81	4.46	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	21	1.01	1.61	-----	-----	3.23	3.82	-----	5.07	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	21	1.03	-----	2.2	2.83	-----	-----	4.44	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	21	-----	1.62	2.2	2.86	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13109	008	21	1.03	-----	2.22	2.82	-----	-----	4.44	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	21	0.99	-----	2.19	-----	3.2	3.8	4.38	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14002	008	21	1.01	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.4	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	21	-----	1.6	2.19	2.83	-----	3.83	-----	5.02	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14005	137	21	1.05	-----	2.28	-----	3.25	3.86	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
14006	006	21	-----	1.58	2.18	2.79	-----	3.78	-----	4.97	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14007	041	21	0.99	-----	2.19	2.79	-----	-----	4.41	5	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	21	-----	1.62	2.19	2.83	-----	3.87	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	21	-----	1.6	2.23	-----	3.22	-----	4.45	5.07	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	21	0.99	-----	2.19	2.79	-----	-----	4.37	4.97	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14024	008	21	1.03	-----	2.21	2.83	-----	-----	4.41	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	21	1.01	1.61	-----	2.83	-----	3.84	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	21	-----	1.58	2.18	-----	3.19	-----	4.38	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
15007	008	21	1.01	-----	2.2	-----	3.25	3.84	4.44	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	21	1.01	-----	2.21	2.81	-----	-----	4.44	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	21	1.01	1.61	-----	-----	3.23	3.82	-----	5.07	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	21	1	1.6	-----	2.82	-----	3.81	4.42	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	21	-----	1.58	2.18	2.79	-----	3.78	-----	4.97	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	21	-----	1.6	2.21	-----	3.24	-----	4.46	5.08	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	21	1.02	-----	2.24	-----	3.26	3.85	4.49	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
18003	008	21	-----	1.63	2.21	2.83	-----	3.83	-----	5.06	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	21	0.98	1.58	-----	2.79	-----	3.77	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
20002	128	21	1.02	1.62	-----	2.83	-----	3.81	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	21	1	-----	2.17	2.8	-----	-----	4.41	5.03	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	21	1	1.58	-----	2.8	-----	3.79	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	21	1.02	1.62	-----	-----	3.21	3.81	-----	5.02	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	21	-----	1.6	2.18	-----	3.19	-----	4.41	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22007	144	21	1	-----	2.18	-----	3.2	3.77	4.39	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22010	006	21	0.98	-----	2.18	2.79	-----	-----	4.37	4.97	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	21	1.01	-----	2.2	-----	3.24	3.84	4.39	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
22019	006	21	-----	1.58	2.18	-----	3.18	-----	4.37	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22023	129	21	1.02	1.62	-----	2.82	-----	3.81	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	21	-----	1.59	2.17	2.81	-----	3.78	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
23002	172	21	-----	1.61	2.21	2.81	-----	3.8	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	21	-----	1.61	2.22	2.81	-----	3.82	-----	5.06	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	21	-----	1.61	2.21	-----	3.21	-----	4.43	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	21	1	-----	2.22	-----	3.24	3.84	4.45	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[4]クレアチニン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	21	1.02	1.61	-----	2.83	-----	3.81	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	21	1.02	1.61	-----	-----	3.18	3.77	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23018	008	21	-----	1.63	2.23	-----	3.23	-----	4.45	5.07	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23022	006	21	-----	1.58	2.18	-----	3.17	-----	4.37	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
23026	088	21	-----	1.61	2.21	-----	3.21	-----	4.43	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	21	1.02	1.61	-----	-----	3.21	3.81	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	21	1.02	1.61	-----	-----	3.19	3.81	-----	5	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	21	-----	1.61	2.21	-----	3.21	-----	4.43	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	21	1	1.61	-----	-----	3.24	3.84	-----	5.08	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	21	1	-----	2.22	-----	3.24	3.84	4.45	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	21	-----	1.62	2.2	-----	3.22	-----	4.41	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	21	-----	1.61	2.21	2.82	-----	3.83	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	21	1	1.61	-----	2.82	-----	3.84	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	21	1.02	1.62	-----	2.84	-----	3.85	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	21	1.02	1.62	-----	2.84	-----	3.85	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	21	-----	1.61	2.21	-----	3.22	-----	4.44	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	21	-----	1.62	2.2	2.84	-----	3.85	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	21	0.99	1.58	-----	-----	3.2	3.78	-----	5	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	21	1.01	1.61	-----	2.82	-----	3.83	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	21	1.03	1.64	-----	2.89	-----	3.89	4.52	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
27002	008	21	1.03	-----	2.23	2.85	-----	-----	4.46	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	21	-----	1.61	2.21	2.82	-----	3.83	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
27005	122	21	-----	1.62	2.21	2.84	-----	3.85	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	21	-----	1.59	2.17	2.78	-----	3.8	-----	5	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	21	1.03	1.61	-----	-----	3.25	3.84	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	21	-----	1.61	2.22	2.83	-----	3.81	-----	5.03	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27018	060	21	-----	1.62	2.21	2.84	-----	3.85	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	21	1	1.63	-----	-----	3.25	3.87	-----	5.11	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
27031	090	21	1	-----	2.25	2.86	-----	-----	4.48	5.11	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27037	200	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	21	1.04	-----	2.2	2.81	-----	-----	4.45	5.03	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	21	1.04	-----	2.22	-----	3.29	3.9	4.52	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	66.7	83.3
27042	102	21	1	1.61	-----	2.82	-----	3.85	4.48	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27045	200	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	21	1.01	1.61	-----	2.82	-----	3.83	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	21	1.01	1.61	-----	2.81	-----	3.82	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	21	-----	1.61	2.21	2.82	-----	3.83	-----	5.05	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	21	-----	1.63	2.25	2.85	-----	3.88	-----	5.12	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28007	197	21	-----	1.61	2.21	-----	3.23	-----	4.45	5.09	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28008	090	21	-----	1.62	2.24	-----	3.26	-----	4.49	5.12	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
28014	008	21	1.03	-----	2.2	-----	3.23	3.84	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	21	-----	1.61	2.22	2.81	-----	3.82	-----	5.07	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	21	-----	1.61	2.22	-----	3.25	-----	4.48	5.08	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28019	002	21	1.01	-----	2.21	2.81	-----	-----	4.44	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	21	0.99	-----	2.21	2.84	-----	-----	4.47	5.06	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	21	0.98	-----	2.18	2.79	-----	-----	4.37	4.97	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	21	1.01	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.43	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	21	1.01	1.61	-----	-----	3.22	3.82	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	21	1.01	-----	2.22	2.84	-----	-----	4.45	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	21	1.02	1.61	-----	-----	3.22	3.8	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33002	065	21	0.99	1.58	-----	2.79	-----	3.84	4.43	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	21	1.02	1.61	-----	-----	3.22	3.81	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	21	1.01	-----	2.22	-----	3.22	3.8	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34001	008	21	-----	1.62	2.21	2.81	-----	3.82	-----	5.08	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
34002	008	21	-----	1.62	2.21	-----	3.19	-----	4.45	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
34003	008	21	1.01	1.61	-----	-----	3.22	3.83	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[4]クレアチニン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	21	0.99	1.58	-----	-----	3.2	3.8	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34013	112	21	-----	1.58	2.18	2.79	-----	3.8	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
35006	109	21	1.01	-----	2.24	2.87	-----	-----	4.48	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
36002	161	21	1	-----	2.22	2.84	-----	-----	4.49	5.09	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	21	-----	1.59	2.21	-----	3.24	-----	4.48	5.09	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
37004	008	21	1.03	1.63	-----	2.87	-----	3.88	4.47	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	21	1.01	-----	2.2	2.83	-----	-----	4.42	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	21	0.98	1.58	-----	2.79	-----	3.77	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
40001	193	21	-----	1.6	2.21	-----	3.24	-----	4.45	5.07	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40002	193	21	-----	1.6	2.21	-----	3.23	-----	4.45	5.06	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	21	0.98	-----	2.18	2.82	-----	-----	4.4	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	21	0.99	1.57	-----	2.78	-----	3.8	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	21	-----	1.64	2.23	2.86	-----	3.85	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40015	008	21	-----	1.63	2.23	-----	3.27	-----	4.47	5.09	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	21	-----	1.58	2.17	-----	3.22	-----	4.38	4.98	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
40025	109	21	1.01	1.64	-----	2.85	-----	3.85	4.45	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	21	-----	1.56	2.16	-----	3.2	-----	4.4	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40028	200	21	1.01	-----	2.21	-----	3.23	3.83	4.43	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	21	1	-----	2.21	2.83	-----	-----	4.45	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	21	1.01	-----	2.25	-----	3.27	3.85	4.46	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
40031	151	21	1.04	1.65	-----	-----	3.24	3.84	-----	5.06	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40034	193	21	1	-----	2.22	-----	3.23	3.84	4.47	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40035	165	21	0.98	1.58	-----	-----	3.21	3.81	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	21	1	1.62	-----	2.84	-----	3.84	4.44	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	21	-----	1.64	2.23	2.87	-----	3.88	-----	5.09	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	21	-----	1.6	2.15	2.8	-----	3.81	-----	5.03	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
42002	008	21	-----	1.62	2.23	-----	3.27	-----	4.47	5.09	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	21	1.04	-----	2.26	2.86	-----	-----	4.54	5.15	A	--	A	A	--	--	A	A	100	60.0	80.0
43007	095	21	1.04	-----	2.24	-----	3.26	3.89	4.49	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
44002	193	21	1	1.6	-----	-----	3.24	3.84	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	21	1	-----	2.21	2.82	-----	-----	4.45	5.05	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[5]AST　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	21	-----	57	-----	85	104	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01007	008	11	21	39	-----	-----	87	105	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01019	052	11	21	-----	57	-----	86	104	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
01027	052	11	21	39	-----	-----	85	105	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
02001	008	11	20	38	-----	-----	86	106	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
02003	110	11	21	-----	59	79	-----	-----	128	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
03004	002	11	-----	40	59	78	-----	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04001	185	11	-----	38	55	74	-----	104	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04006	185	11	20	-----	55	-----	83	100	119	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
04012	002	11	21	38	-----	-----	79	97	-----	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
06001	136	11	21	-----	57	75	-----	-----	124	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
06004	008	11	-----	38	57	-----	85	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
07004	062	11	21	-----	58	78	-----	-----	125	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
07007	174	11	-----	39	57	-----	87	-----	124	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
08002	008	11	20	-----	57	75	-----	-----	124	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09004	075	11	-----	37	55	71	-----	101	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09007	168	11	22	41	-----	-----	92	112	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09008	062	11	21	-----	58	77	-----	-----	126	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09009	008	11	21	-----	57	-----	85	105	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09010	002	11	21	-----	59	-----	89	107	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09011	002	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
09014	075	11	20	-----	53	70	-----	-----	118	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10001	002	11	-----	40	59	78	-----	107	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
10002	002	11	21	40	-----	78	-----	106	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11002	008	11	21	38	-----	-----	87	107	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11004	160	11	21	-----	59	-----	89	108	127	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11005	175	11	-----	40	58	77	-----	106	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11007	008	11	20	-----	57	74	-----	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11021	176	11	-----	41	60	-----	92	-----	132	151	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
11025	100	11	-----	37	54	-----	84	-----	118	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12003	006	11	19	38	-----	72	-----	99	120	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12006	008	11	20	-----	58	-----	86	105	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12010	122	11	21	39	-----	75	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12011	111	11	-----	38	55	73	-----	103	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12012	008	11	21	-----	57	76	-----	-----	124	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12013	087	11	-----	39	57	76	-----	105	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12014	075	11	20	37	-----	-----	83	102	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12015	041	11	-----	44	63	-----	97	-----	137	157	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
12018	041	11	-----	44	63	83	-----	116	-----	156	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13001	050	11	23	-----	62	83	-----	-----	135	154	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13004	200	11	-----	39	57	-----	88	-----	124	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13005	002	11	21	40	-----	78	-----	107	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13006	002	11	21	-----	59	-----	89	107	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13007	002	11	21	40	-----	-----	89	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13008	002	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13010	008	11	-----	38	57	-----	86	-----	124	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13013	111	11	21	38	-----	-----	84	103	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13014	008	11	21	-----	57	76	-----	-----	124	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13015	008	11	21	-----	58	-----	87	108	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13016	041	11	23	-----	63	-----	97	117	137	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13021	002	11	21	-----	59	78	-----	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13022	008	11	21	38	-----	75	-----	108	125	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13024	002	11	21	40	-----	78	-----	107	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13033	087	11	-----	39	57	76	-----	105	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13035	008	11	20	37	-----	-----	87	106	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13036	006	11	-----	37	54	-----	81	-----	118	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13038	002	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13039	002	11	-----	40	59	78	-----	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[5]AST　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	11	-----	40	59	78	-----	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13049	002	11	-----	40	59	-----	89	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13051	008	11	21	38	-----	75	-----	104	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13052	002	11	21	-----	59	-----	89	107	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13055	002	11	-----	40	59	78	-----	107	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13056	012	11	-----	41	60	80	-----	111	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13063	050	11	23	43	-----	-----	95	114	-----	153	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13067	008	11	-----	39	59	75	-----	105	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13071	075	11	20	-----	53	71	-----	-----	119	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13077	008	11	21	-----	57	-----	85	104	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13078	006	11	-----	37	53	-----	80	-----	117	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13079	041	11	24	43	-----	-----	97	116	-----	156	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13080	008	11	21	-----	57	-----	87	108	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13082	008	11	21	-----	57	-----	87	108	125	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13083	008	11	21	-----	57	74	-----	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13088	154	11	21	39	-----	-----	88	107	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13089	002	11	21	-----	59	78	-----	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13090	008	11	21	38	-----	74	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13101	002	11	21	40	-----	-----	89	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13107	008	11	21	-----	57	74	-----	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13108	008	11	-----	38	57	74	-----	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13109	008	11	20	-----	57	74	-----	-----	125	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
13115	041	11	24	-----	64	-----	97	117	137	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14002	008	11	20	-----	57	74	-----	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14004	008	11	-----	39	58	75	-----	105	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14005	137	11	22	-----	59	-----	89	108	129	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14006	006	11	-----	36	53	72	-----	97	-----	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14007	041	11	23	-----	63	83	-----	-----	136	155	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14018	008	11	-----	37	57	74	-----	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14022	008	11	-----	39	58	-----	87	-----	126	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14023	006	11	19	-----	53	73	-----	-----	118	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14024	008	11	20	-----	57	74	-----	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14026	008	11	21	38	-----	76	-----	106	125	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
14029	041	11	-----	44	63	-----	97	-----	136	155	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15007	008	11	21	-----	57	-----	87	105	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15008	002	11	21	-----	59	78	-----	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
15010	002	11	21	40	-----	-----	89	107	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
16004	171	11	21	38	-----	74	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
16005	006	11	-----	37	53	72	-----	97	-----	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
16008	089	11	-----	39	57	-----	85	-----	124	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
17003	190	11	21	-----	57	-----	87	107	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
18003	008	11	-----	38	58	75	-----	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20001	006	11	19	37	-----	72	-----	96	117	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20002	128	11	21	40	-----	77	-----	109	127	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20003	081	11	22	-----	62	81	-----	-----	136	152	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
20004	081	11	22	41	-----	81	-----	115	136	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
21001	172	11	21	40	-----	-----	90	108	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
21004	057	11	-----	41	61	-----	94	-----	132	151	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22007	144	11	23	-----	62	-----	92	112	134	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22010	006	11	20	-----	54	74	-----	-----	121	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22015	008	11	20	-----	57	-----	87	106	125	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22019	006	11	-----	38	54	-----	79	-----	118	136	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
22023	129	11	21	40	-----	78	-----	108	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23001	057	11	-----	41	60	80	-----	112	-----	150	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23002	172	11	-----	40	59	77	-----	107	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23005	002	11	-----	40	59	78	-----	107	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23006	088	11	-----	40	59	-----	90	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23007	169	11	21	-----	58	-----	86	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[5]AST　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	11	21	40	-----	77	-----	107	127	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23012	083	11	21	40	-----	-----	89	106	-----	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23018	008	11	-----	39	58	-----	87	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23022	006	11	-----	38	53	-----	80	-----	117	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23026	088	11	-----	40	59	-----	90	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23030	088	11	21	40	-----	-----	90	107	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23032	083	11	21	39	-----	-----	89	108	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23037	088	11	-----	40	59	-----	90	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23038	169	11	21	39	-----	-----	86	105	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23039	169	11	21	-----	58	-----	86	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23040	008	11	-----	39	58	-----	87	-----	125	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
23042	200	11	-----	39	57	76	-----	106	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
24001	169	11	21	39	-----	76	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
24002	122	11	21	39	-----	75	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
25001	122	11	21	39	-----	75	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
25002	126	11	-----	39	55	-----	86	-----	122	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26002	024	11	-----	37	54	71	-----	102	-----	137	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26005	009	11	23	43	-----	-----	95	114	-----	151	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
26012	200	11	21	39	-----	76	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27001	029	11	22	39	-----	75	-----	105	122	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27002	008	11	21	-----	57	75	-----	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27003	200	11	-----	39	57	76	-----	106	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27005	122	11	-----	39	58	75	-----	105	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27006	200	11	21	-----	57	-----	88	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27007	009	11	-----	43	62	82	-----	115	-----	153	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27009	008	11	20	39	-----	-----	86	104	-----	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27010	094	11	-----	39	57	76	-----	105	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27018	060	11	-----	39	58	75	-----	105	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27023	090	11	21	38	-----	-----	86	104	-----	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27031	090	11	21	-----	56	74	-----	-----	123	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27037	200	11	21	-----	57	-----	88	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27038	008	11	21	-----	57	75	-----	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27041	029	11	22	-----	58	-----	87	105	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27042	102	11	22	39	-----	73	-----	103	121	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27045	200	11	21	-----	57	-----	88	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27048	200	11	21	39	-----	76	-----	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27051	002	11	21	40	-----	78	-----	106	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27052	200	11	-----	39	57	76	-----	106	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
27061	200	11	21	-----	57	-----	88	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28001	090	11	-----	38	56	74	-----	104	-----	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28007	197	11	-----	41	59	-----	88	-----	127	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28008	090	11	-----	38	56	-----	86	-----	122	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28014	008	11	20	-----	57	-----	85	104	123	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28015	002	11	-----	40	59	78	-----	106	-----	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28018	102	11	-----	39	57	-----	86	-----	121	140	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28019	002	11	21	-----	59	78	-----	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28022	198	11	21	-----	59	78	-----	-----	126	149	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28024	006	11	19	-----	53	72	-----	-----	117	135	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
28029	200	11	21	-----	57	76	-----	-----	124	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
30006	126	11	21	39	-----	-----	86	104	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
31002	008	11	21	-----	58	76	-----	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
31003	008	11	20	37	-----	-----	86	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33002	065	11	22	39	-----	75	-----	105	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33004	008	11	20	39	-----	-----	87	108	-----	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
33014	112	11	22	-----	56	-----	87	104	126	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34001	008	11	-----	38	57	75	-----	104	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34002	008	11	-----	38	57	-----	86	-----	124	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34003	008	11	21	38	-----	-----	87	107	-----	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[5]AST　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	11	21	37	-----	-----	85	103	-----	140	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
34013	112	11	-----	37	55	72	-----	103	-----	140	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
35006	109	11	21	-----	54	73	-----	-----	119	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
36002	161	11	21	-----	57	74	-----	-----	123	139	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
37001	058	11	-----	39	57	-----	87	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
37004	008	11	21	39	-----	76	-----	106	127	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
38006	054	11	21	-----	57	76	-----	-----	124	143	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
38009	006	11	19	38	-----	72	-----	96	117	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40001	193	11	-----	39	57	-----	86	-----	123	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40002	193	11	-----	39	57	-----	86	-----	124	144	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40004	165	11	22	-----	59	78	-----	-----	127	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40006	165	11	22	41	-----	78	-----	109	128	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40013	109	11	-----	38	55	74	-----	101	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40015	008	11	-----	39	59	-----	87	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40022	165	11	-----	41	59	-----	91	-----	128	147	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40025	109	11	21	37	-----	73	-----	101	118	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40026	165	11	-----	41	60	-----	91	-----	128	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40028	200	11	21	-----	57	-----	88	106	124	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40029	069	11	21	-----	58	76	-----	-----	126	145	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40030	109	11	21	-----	54	-----	82	100	118	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40031	151	11	20	37	-----	-----	83	99	-----	138	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40034	193	11	21	-----	59	-----	87	108	127	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
40035	165	11	22	41	-----	-----	91	110	-----	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
41001	073	11	21	37	-----	71	-----	102	120	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
41002	008	11	-----	39	59	76	-----	108	-----	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
42001	165	11	-----	41	60	79	-----	111	-----	148	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
42002	008	11	-----	39	58	-----	87	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
43004	146	11	21	-----	56	74	-----	-----	123	140	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
43007	095	11	23	-----	62	-----	96	116	136	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
44002	193	11	21	38	-----	-----	86	104	-----	142	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----
46001	193	11	21	-----	59	76	-----	-----	127	146	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

[6]ALT　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	20	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01007	008	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01019	052	11	20	-----	55	-----	84	103	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01027	052	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	11	19	37	-----	-----	83	101	-----	132	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	66.7	83.3
02003	110	11	20	-----	55	72	-----	-----	120	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
03004	002	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	11	-----	39	57	75	-----	105	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
04006	185	11	20	-----	57	-----	87	105	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
04012	002	11	20	38	-----	-----	86	103	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	11	-----	37	54	-----	84	-----	116	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	11	-----	38	54	-----	85	-----	119	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	11	-----	38	56	73	-----	105	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	73.3	86.7
09007	168	11	20	37	-----	-----	85	104	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	11	19	-----	55	-----	84	103	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	11	20	-----	55	-----	85	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	11	18	-----	55	74	-----	-----	122	140	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	80.0	86.7
10001	002	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	11	20	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	11	19	37	-----	-----	84	101	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	11	18	-----	54	-----	83	102	114	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	46.7	70.0
11005	175	11	-----	38	56	72	-----	98	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	60.0	80.0
11007	008	11	19	-----	54	73	-----	-----	117	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
11021	176	11	-----	36	56	-----	86	-----	121	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11025	100	11	-----	37	56	-----	85	-----	120	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12003	006	11	20	38	-----	73	-----	104	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12006	008	11	20	-----	55	-----	84	102	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	11	20	37	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	11	20	-----	55	73	-----	-----	118	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	11	-----	38	55	74	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	11	18	37	-----	-----	87	105	-----	104	B	A	--	--	A	A	--	D	73.3	0.0	36.7
12015	041	11	-----	38	57	-----	87	-----	119	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
12018	041	11	-----	38	55	75	-----	105	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	86.7	93.3
13001	050	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13004	200	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	11	20	37	-----	73	-----	102	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	11	20	-----	55	-----	85	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	11	20	37	-----	-----	85	103	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	11	-----	38	55	-----	84	-----	120	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	11	20	-----	57	-----	87	105	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	93.3	96.7
13021	002	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	11	19	38	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	11	20	37	-----	73	-----	102	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	11	-----	38	55	74	-----	103	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13038	002	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[6]ALT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	11	-----	37	55	-----	85	-----	120	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	11	19	37	-----	72	-----	101	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	11	20	-----	55	-----	85	102	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	11	-----	38	55	72	-----	99	-----	137	--	A	A	A	--	A	--	A	100.0	93.3	96.7
13063	050	11	19	37	-----	-----	85	102	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13067	008	11	-----	37	54	72	-----	100	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13071	075	11	19	-----	55	75	-----	-----	123	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100.0	86.7	93.3
13077	008	11	19	-----	54	-----	84	102	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	11	-----	38	55	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13079	041	11	20	38	-----	-----	87	105	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13080	008	11	19	-----	55	-----	84	101	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	11	19	-----	55	-----	84	101	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13088	154	11	19	37	-----	-----	84	101	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	11	19	37	-----	72	-----	101	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	11	20	37	-----	-----	85	103	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	11	-----	37	54	73	-----	101	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13109	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	134	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	11	20	-----	57	-----	86	101	123	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
14002	008	11	19	-----	54	73	-----	-----	118	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	11	-----	37	55	72	-----	102	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14005	137	11	19	-----	55	-----	84	102	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14006	006	11	-----	38	56	73	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14007	041	11	20	-----	57	75	-----	-----	123	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	11	-----	37	55	72	-----	101	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	11	-----	37	55	-----	84	-----	119	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	11	20	-----	55	73	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14024	008	11	20	-----	55	73	-----	-----	118	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	11	19	37	-----	72	-----	102	118	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	11	-----	38	57	-----	87	-----	123	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	93.3	96.7
15007	008	11	20	-----	55	-----	84	102	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	11	19	37	-----	73	-----	100	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	11	-----	38	56	73	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	11	-----	37	55	-----	84	-----	120	135	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	11	19	-----	55	-----	85	103	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
18003	008	11	-----	37	55	71	-----	100	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	11	20	38	-----	73	-----	104	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20002	128	11	20	38	-----	74	-----	102	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	11	20	-----	56	74	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	11	20	38	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	11	-----	38	54	-----	86	-----	119	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22007	144	11	20	-----	56	-----	86	103	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22010	006	11	20	-----	55	73	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	11	19	-----	55	-----	83	102	119	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22019	006	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22023	129	11	20	38	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	11	-----	38	55	74	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23002	172	11	-----	38	56	74	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	11	-----	38	56	-----	85	-----	121	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	11	20	-----	56	-----	85	103	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[6]ALT　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	11	20	38	-----	73	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	11	20	38	-----	-----	84	102	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	11	-----	37	55	-----	84	-----	118	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
23022	006	11	-----	38	55	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23026	088	11	-----	38	56	-----	85	-----	121	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	11	20	37	-----	-----	85	103	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	11	-----	38	56	-----	85	-----	121	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	11	20	38	-----	-----	85	103	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	11	20	-----	56	-----	85	104	121	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	11	-----	37	54	-----	85	-----	118	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	11	20	38	-----	74	-----	104	122	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	11	20	37	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	11	20	37	-----	73	-----	102	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	11	-----	37	55	-----	85	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	11	-----	37	54	73	-----	103	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	11	20	38	-----	-----	86	102	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	11	19	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	11	20	38	-----	74	-----	105	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27002	008	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	11	-----	38	56	74	-----	103	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	11	19	37	-----	-----	84	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27018	060	11	-----	37	55	73	-----	102	-----	135	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	11	20	38	-----	-----	86	104	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	11	20	-----	56	74	-----	-----	122	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27037	200	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	11	19	-----	54	73	-----	-----	119	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	11	19	-----	56	-----	86	104	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	11	20	38	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27045	200	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	11	19	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	11	20	37	-----	73	-----	103	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	11	-----	38	56	74	-----	104	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28007	197	11	-----	37	54	-----	84	-----	119	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28008	090	11	-----	38	56	-----	86	-----	121	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28014	008	11	19	-----	54	-----	84	102	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	11	-----	37	55	73	-----	103	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	11	-----	38	55	-----	86	-----	121	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28019	002	11	20	-----	55	73	-----	-----	120	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	11	19	-----	54	73	-----	-----	120	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	11	20	-----	55	73	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	11	19	-----	55	73	-----	-----	120	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	11	20	37	-----	-----	85	103	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	11	19	-----	54	73	-----	-----	119	133	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	11	19	38	-----	-----	83	99	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	80.0	90.0
33002	065	11	19	38	-----	73	-----	102	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	11	19	37	-----	-----	83	100	-----	135	A	A	--	--	A	A	--	A	100.0	86.7	93.3
33014	112	11	21	-----	58	-----	89	105	123	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
34001	008	11	-----	37	55	73	-----	101	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	11	-----	38	55	-----	84	-----	118	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34003	008	11	19	37	-----	-----	84	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[6]ALT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	11	20	38	-----	-----	86	104	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34013	112	11	-----	38	56	75	-----	104	-----	139	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
35006	109	11	20	-----	56	74	-----	-----	121	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
36002	161	11	20	-----	56	74	-----	-----	121	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	11	-----	37	56	-----	86	-----	122	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	11	19	38	-----	73	-----	100	120	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	11	19	-----	54	73	-----	-----	121	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	11	20	38	-----	73	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40001	193	11	-----	37	55	-----	83	-----	118	134	--	A	A	--	A	--	A	A	100.0	86.7	93.3
40002	193	11	-----	37	55	-----	84	-----	118	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	11	20	-----	55	73	-----	-----	118	137	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	11	20	38	-----	73	-----	100	118	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100.0	86.7	93.3
40013	109	11	-----	37	57	75	-----	104	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40015	008	11	-----	38	55	-----	85	-----	120	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	11	-----	37	54	-----	85	-----	119	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	11	20	37	-----	74	-----	103	121	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	11	-----	38	55	-----	85	-----	119	138	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40028	200	11	19	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	11	19	-----	55	73	-----	-----	119	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	11	20	-----	56	-----	86	103	122	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40031	151	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40034	193	11	20	-----	55	-----	84	100	118	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100.0	86.7	93.3
40035	165	11	20	38	-----	-----	84	101	-----	137	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	11	19	37	-----	73	-----	103	119	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	11	-----	38	55	73	-----	103	-----	136	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	11	-----	37	55	74	-----	102	-----	138	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42002	008	11	-----	38	55	-----	85	-----	120	136	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	11	20	-----	56	74	-----	-----	121	138	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	11	20	-----	55	-----	85	103	120	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
44002	193	11	20	37	-----	-----	85	102	-----	136	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	11	20	-----	55	73	-----	-----	119	135	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[7] γ－GT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	11	31	-----	67	-----	98	117	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01007	008	11	31	49	-----	-----	98	117	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01019	052	11	31	-----	67	-----	98	117	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01027	052	11	31	49	-----	-----	98	117	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	11	29	-----	65	85	-----	-----	135	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
03004	002	11	-----	49	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	11	31	-----	67	-----	98	115	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
04012	002	11	30	49	-----	-----	98	117	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	11	30	-----	66	84	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	11	30	-----	66	85	-----	-----	133	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	11	-----	49	67	-----	98	-----	136	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	11	-----	48	66	84	-----	114	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09007	168	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	11	30	-----	66	85	-----	-----	133	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	11	30	-----	66	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	11	29	-----	66	85	-----	-----	132	150	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
10001	002	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	11	30	49	-----	85	-----	115	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	11	30	49	-----	-----	97	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11005	175	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11007	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	135	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11025	100	11	-----	48	65	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12003	006	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12006	008	11	30	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	11	30	49	-----	86	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	11	-----	48	67	86	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	11	-----	48	67	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	11	30	48	-----	-----	96	114	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12015	041	11	-----	48	66	-----	97	-----	133	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12018	041	11	-----	48	66	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13001	050	11	31	-----	67	86	-----	-----	135	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13004	200	11	-----	48	67	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	11	30	49	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	11	30	49	-----	-----	98	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
13013	111	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
13015	008	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	11	30	-----	66	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13021	002	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	11	30	49	-----	86	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	11	30	49	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	11	-----	48	67	85	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	11	-----	48	66	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13038	002	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	11	-----	49	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[7] γ－GT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	11	-----	49	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	11	30	49	-----	85	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	11	-----	48	65	84	-----	114	-----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13063	050	11	30	48	-----	-----	98	115	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
13067	008	11	-----	49	65	85	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13071	075	11	30	-----	66	85	-----	-----	133	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13077	008	11	30	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	11	-----	48	67	-----	98	-----	135	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13079	041	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13080	008	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	11	30	-----	67	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13088	154	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	154	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	11	30	49	-----	85	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	11	30	49	-----	-----	98	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13109	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	11	30	-----	67	-----	98	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
14002	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14005	137	11	30	-----	66	-----	97	116	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14006	006	11	-----	48	67	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14007	041	11	30	-----	66	84	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	11	-----	49	67	-----	97	-----	134	154	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14023	006	11	30	-----	68	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
14024	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14026	008	11	30	49	-----	85	-----	115	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
14029	041	11	-----	47	66	-----	97	-----	133	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
15007	008	11	30	-----	67	-----	97	115	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
16005	006	11	-----	48	66	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
16008	089	11	-----	48	67	-----	97	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	11	31	-----	68	-----	100	117	137	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
18003	008	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	11	30	48	-----	85	-----	117	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20002	128	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	11	30	48	-----	85	-----	115	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	11	30	49	-----	-----	97	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	11	-----	48	67	-----	97	-----	136	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
22007	144	11	30	-----	66	-----	97	114	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22010	006	11	30	-----	67	86	-----	-----	133	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22015	008	11	30	-----	67	-----	97	115	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
22019	006	11	-----	48	66	-----	98	-----	135	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22023	129	11	30	49	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	11	-----	48	67	85	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23002	172	11	-----	49	67	86	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	11	30	-----	67	-----	98	116	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7

[7] γ－GT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	11	30	49	-----	86	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
23022	006	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23026	088	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	11	30	48	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	11	30	-----	67	-----	98	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	11	-----	48	67	85	-----	116	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
24001	169	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	11	30	49	-----	86	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	11	30	49	-----	86	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	11	-----	48	66	-----	97	-----	135	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	11	-----	48	66	85	-----	115	-----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	11	30	47	-----	-----	96	115	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	11	30	48	-----	85	-----	116	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	11	31	50	-----	87	-----	117	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
27002	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	135	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	11	-----	48	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	11	30	-----	67	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	11	-----	48	66	84	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	11	30	49	-----	-----	98	115	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
27010	094	11	-----	48	67	86	-----	117	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27018	060	11	-----	49	67	86	-----	117	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27037	200	11	30	-----	67	-----	97	116	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	11	30	-----	67	85	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	11	31	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	11	31	50	-----	87	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
27045	200	11	30	-----	67	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	11	30	48	-----	85	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	11	30	49	-----	85	-----	115	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	11	-----	48	67	85	-----	116	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27061	200	11	30	-----	67	-----	97	116	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	11	-----	48	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28007	197	11	-----	49	66	-----	98	-----	134	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28008	090	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28014	008	11	30	-----	67	-----	97	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	11	-----	49	67	85	-----	115	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	11	-----	50	68	-----	99	-----	135	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
28019	002	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	11	30	-----	66	86	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	11	30	48	-----	-----	97	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	11	30	-----	67	86	-----	-----	135	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	11	30	49	-----	-----	97	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33002	065	11	31	49	-----	86	-----	117	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	152	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	11	31	-----	69	-----	100	119	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	46.7	73.3
34001	008	11	-----	49	67	85	-----	116	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
34003	008	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[7] γ－GT　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	11	31	49	-----	-----	100	118	-----	155	A	A	--	--	A	A	--	A	100	73.3	86.7
34013	112	11	-----	49	68	87	-----	118	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
35006	109	11	32	-----	69	88	-----	-----	137	154	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	66.7	80.0
36002	161	11	30	-----	67	85	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	11	-----	49	67	-----	99	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	11	30	48	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	11	30	-----	66	85	-----	-----	133	150	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
38009	006	11	30	48	-----	86	-----	116	135	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40001	193	11	-----	49	67	-----	98	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
40002	193	11	-----	49	67	-----	98	-----	134	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	11	30	-----	66	85	-----	-----	132	151	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40006	165	11	30	48	-----	84	-----	116	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	11	-----	50	69	87	-----	118	-----	154	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
40015	008	11	-----	48	67	-----	98	-----	134	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	11	-----	48	67	-----	96	-----	133	151	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	11	31	50	-----	87	-----	118	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
40026	165	11	-----	48	66	-----	98	-----	133	152	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
40028	200	11	30	-----	67	-----	97	116	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	11	32	-----	69	-----	100	118	137	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	60.0	76.7
40031	151	11	30	49	-----	-----	98	116	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40034	193	11	30	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40035	165	11	30	48	-----	-----	97	115	-----	151	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	11	31	48	-----	85	-----	115	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
41002	008	11	-----	48	67	86	-----	117	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	11	-----	48	66	84	-----	115	-----	151	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42002	008	11	-----	48	67	-----	98	-----	136	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	11	30	-----	67	86	-----	-----	136	154	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	11	31	-----	67	-----	98	116	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
44002	193	11	30	49	-----	-----	98	117	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	11	30	-----	67	86	-----	-----	134	152	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[8]血糖　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01002	008	21	92	-----	125	-----	153	170	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
01007	008	21	92	108	-----	-----	154	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
01019	052	21	92	-----	125	-----	153	170	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
01027	052	21	92	108	-----	-----	153	170	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02001	008	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
02003	110	12	91	-----	125	142	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
03004	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04001	185	21	-----	110	127	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04006	185	12	92	-----	126	-----	153	170	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
04012	002	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
06001	136	12	91	-----	125	142	-----	-----	186	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
06004	008	21	-----	109	126	-----	154	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
07004	062	21	93	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
07007	174	21	-----	109	125	-----	154	-----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
08002	008	21	92	-----	126	142	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09004	075	21	-----	109	126	143	-----	172	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09007	168	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09008	062	21	93	-----	126	144	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
09009	008	21	92	-----	126	-----	154	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09010	002	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09011	002	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09014	075	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
10001	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10002	002	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
11002	008	21	93	109	-----	-----	155	172	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
11004	160	12	90	-----	123	-----	152	169	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
11005	175	21	-----	107	126	143	-----	170	-----	202	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
11007	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
11021	176	21	-----	109	126	-----	155	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11025	100	21	-----	111	127	-----	156	-----	190	208	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	66.7	80.0
12003	006	21	92	110	-----	144	-----	176	190	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	93.3	6.7	50.0
12006	008	21	92	-----	125	-----	155	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12010	122	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12011	111	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12012	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
12013	087	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
12014	075	21	92	109	-----	-----	154	173	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
12015	041	21	-----	109	125	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12018	041	21	-----	109	125	142	-----	170	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13001	050	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13004	200	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13005	002	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13006	002	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13007	002	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13008	002	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13010	008	21	-----	109	126	-----	154	-----	190	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13013	111	21	92	109	-----	-----	155	171	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13014	008	21	92	-----	125	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13015	008	21	92	-----	126	-----	154	171	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13016	041	21	92	-----	125	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13021	002	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13022	008	21	93	109	-----	144	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13024	002	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13033	087	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13035	008	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13036	006	21	-----	109	127	-----	155	-----	190	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
13038	002	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13039	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[8]血糖　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
13045	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13049	002	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13051	008	21	92	109	-----	143	-----	170	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13052	002	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13055	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13056	012	21	-----	108	124	141	-----	169	-----	201	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
13063	050	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13067	008	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13071	075	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
13077	008	21	92	-----	126	-----	154	171	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13078	006	21	-----	110	127	-----	155	-----	190	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
13079	041	21	92	109	-----	-----	153	170	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13080	008	21	92	-----	125	-----	155	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13082	008	21	92	-----	126	-----	154	170	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13083	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13088	154	21	92	107	-----	-----	152	169	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13089	002	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13090	008	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13101	002	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13107	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13108	008	21	-----	109	126	142	-----	171	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13109	008	21	92	-----	125	142	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13115	041	21	92	-----	125	-----	154	171	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
14002	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14004	008	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
14005	137	21	91	-----	125	-----	150	169	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
14006	006	21	-----	110	127	144	-----	170	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
14007	041	21	92	-----	126	143	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14018	008	21	-----	109	126	142	-----	171	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
14022	008	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14023	006	21	92	-----	127	144	-----	-----	190	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
14024	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100.0	100.0
14026	008	21	93	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14029	041	21	-----	109	125	-----	153	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
15007	008	21	92	-----	126	-----	155	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
15008	002	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15010	002	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16004	171	21	93	109	-----	142	-----	170	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
16005	006	21	-----	110	127	144	-----	170	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
16008	089	21	-----	110	126	-----	155	-----	189	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
17003	190	21	91	-----	124	-----	155	170	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
18003	008	21	-----	110	127	143	-----	172	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
20001	006	21	92	110	-----	144	-----	170	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
20002	128	21	91	108	-----	142	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
20003	081	21	92	-----	125	142	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
20004	081	21	92	109	-----	142	-----	171	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
21001	172	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
21004	057	21	-----	109	126	-----	154	-----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
22007	144	21	92	-----	125	-----	153	170	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
22010	006	21	92	-----	127	144	-----	-----	190	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
22015	008	21	92	-----	126	-----	155	172	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22019	006	21	-----	110	127	-----	155	-----	190	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
22023	129	21	91	108	-----	142	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23001	057	21	-----	109	125	143	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23002	172	21	-----	108	125	142	-----	170	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23005	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23006	088	21	-----	108	126	-----	153	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23007	169	21	91	-----	126	-----	154	170	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[8]血糖　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
23009	088	21	91	108	-----	142	-----	170	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23012	083	21	91	108	-----	-----	153	169	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23018	008	21	-----	109	127	-----	155	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23022	006	21	-----	110	127	-----	155	-----	190	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23026	088	21	-----	108	126	-----	153	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23030	088	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23032	083	21	91	108	-----	-----	153	170	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23037	088	21	-----	108	126	-----	153	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23038	169	21	91	108	-----	-----	154	169	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23039	169	21	91	-----	126	-----	154	170	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
23040	008	21	-----	109	126	-----	155	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23042	200	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
24001	169	21	91	108	-----	143	-----	169	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24002	122	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25001	122	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
25002	126	21	-----	109	126	-----	155	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26002	024	21	-----	109	125	143	-----	170	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26005	009	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
26012	200	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27001	029	21	91	109	-----	142	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27002	008	21	93	-----	126	143	-----	-----	190	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27003	200	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27005	122	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27006	200	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27007	009	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27009	008	21	92	109	-----	-----	155	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27010	094	21	-----	108	126	143	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27018	060	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
27023	090	21	91	108	-----	-----	153	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27031	090	21	91	-----	127	144	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
27037	200	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27038	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27041	029	21	91	-----	125	-----	153	169	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27042	102	21	91	109	-----	142	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27045	200	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27048	200	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27051	002	21	92	109	-----	143	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27052	200	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
27061	200	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28001	090	21	-----	109	127	143	-----	172	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28007	197	12	-----	107	124	-----	153	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28008	090	21	-----	109	126	-----	154	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28014	008	21	92	-----	125	-----	154	172	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28015	002	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28018	102	21	-----	109	126	-----	153	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28019	002	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28022	198	21	93	-----	125	143	-----	-----	187	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28024	006	21	92	-----	127	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28029	200	21	92	-----	126	143	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30006	126	21	92	109	-----	-----	155	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
31002	008	21	92	-----	126	143	-----	-----	189	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31003	008	21	92	109	-----	-----	155	172	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33002	065	21	92	109	-----	142	-----	171	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
33004	008	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
33014	112	21	94	-----	128	-----	157	171	190	-----	B	--	A	--	B	A	A	--	86.7	60.0	73.3
34001	008	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
34002	008	21	-----	109	126	-----	154	-----	189	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
34003	008	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[8]血糖　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								測定値	解析値	総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
34005	112	21	92	109	-----	-----	154	171	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34013	112	21	-----	109	126	143	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
35006	109	21	93	-----	126	144	-----	-----	190	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
36002	161	21	91	-----	126	143	-----	-----	187	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
37001	058	21	-----	109	126	-----	153	-----	187	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
37004	008	21	92	109	-----	143	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
38006	054	21	93	-----	127	144	-----	-----	190	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
38009	006	21	92	110	-----	144	-----	170	190	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
40001	193	21	-----	110	127	-----	155	-----	189	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40002	193	21	-----	109	127	-----	155	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40004	165	21	91	-----	123	140	-----	-----	188	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
40006	165	21	91	107	-----	140	-----	170	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40013	109	21	-----	109	126	145	-----	171	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40015	008	21	-----	109	126	-----	153	-----	188	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40022	165	21	-----	108	123	-----	152	-----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40025	109	21	93	108	-----	144	-----	172	189	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40026	165	21	-----	108	124	-----	153	-----	187	203	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
40028	200	21	92	-----	126	-----	154	171	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40029	069	21	92	-----	127	143	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
40030	109	21	92	-----	127	-----	155	171	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40031	151	21	91	109	-----	-----	154	170	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40034	193	21	92	-----	126	-----	155	172	189	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
40035	165	21	91	107	-----	-----	153	171	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
41001	073	21	92	109	-----	143	-----	170	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
41002	008	21	-----	109	125	142	-----	170	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42001	165	21	-----	108	125	141	-----	171	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
42002	008	21	-----	108	126	-----	153	-----	188	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
43004	146	21	93	-----	126	143	-----	-----	188	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43007	095	21	91	-----	124	-----	151	169	182	-----	A	--	A	--	A	A	B	--	93.3	26.7	60.0
44002	193	21	92	109	-----	-----	155	171	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
46001	193	21	92	-----	126	144	-----	-----	190	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100

[9]HDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
01007	008	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
01019	052	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
01027	052	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
02001	008	01-1201	-----	53	57	49	-----	--	A	A	--	--	100
02003	110	01-0403	32	-----	51	-----	73	A	--	A	--	--	100
03004	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
04001	185	01-0403	32	43	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
04006	185	01-0403	-----	44	49	47	-----	--	A	A	--	--	100
04012	002	01-0403	31	43	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
06001	136	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
06004	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
07004	062	01-1201	-----	51	55	50	-----	--	A	B	--	--	92.9
07007	174	01-0403	-----	43	49	-----	72	--	A	A	--	--	100
08002	008	01-1201	-----	52	57	-----	74	--	A	A	--	--	100
09004	075	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
09007	168	01-1201	36	52	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
09008	062	01-1201	-----	51	55	-----	76	--	A	B	--	--	92.9
09009	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
09010	002	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
09011	002	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
09014	075	01-0403	32	45	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
10001	002	01-0403	-----	44	51	48	-----	--	A	A	--	--	100
10002	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
11002	008	01-1201	36	-----	58	49	-----	A	--	A	--	--	100
11004	160	01-0403	-----	43	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
11005	175	01-0403	31	-----	50	-----	74	A	--	A	--	--	100
11007	008	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
11021	176	01-0403	32	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
11025	100	01-0403	-----	44	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
12003	006	01-0403	-----	94	126	-----	101	--	D	D	--	--	0
12006	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
12010	122	01-1201	-----	52	57	-----	75	--	A	A	--	--	100
12011	111	01-0403	32	-----	50	72	-----	A	--	A	--	--	100
12012	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
12013	087	01-0403	-----	45	51	49	-----	--	A	A	--	--	100
12014	075	01-0403	32	45	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
12015	041	01-1201	37	52	-----	51	-----	A	A	--	--	--	100
12018	041	01-1201	-----	52	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
13001	050	01-1201	36	51	-----	-----	77	A	A	--	--	--	100
13004	200	01-0403	-----	44	50	-----	73	--	A	A	--	--	100
13005	002	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
13006	002	01-0403	-----	44	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
13007	002	01-0403	32	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
13008	002	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
13010	008	01-1201	36	52	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100
13013	111	01-0403	-----	44	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
13014	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
13015	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
13016	041	01-1201	37	52	-----	-----	78	A	A	--	--	--	100
13021	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
13022	008	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13024	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
13033	087	01-0403	32	-----	51	-----	74	A	--	A	--	--	100
13035	008	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
13036	006	01-0403	-----	94	126	150	-----	--	D	D	--	--	0

[9]HDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
13039	002	01-0403	-----	44	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
13045	002	01-0403	-----	44	51	48	-----	--	A	A	--	--	100
13049	002	01-0403	-----	44	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
13051	008	01-1201	36	-----	58	-----	74	A	--	A	--	--	100
13052	002	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
13055	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
13056	012	01-1201	-----	51	56	48	-----	--	A	A	--	--	100
13063	050	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
13067	008	01-1201	-----	53	57	-----	74	--	A	A	--	--	100
13071	075	01-0403	32	45	-----	-----	73	A	A	--	--	--	100
13077	008	01-1201	36	-----	57	-----	74	A	--	A	--	--	100
13078	006	01-0403	67	94	-----	-----	101	D	D	--	--	--	0
13079	041	01-1201	-----	52	57	-----	78	--	A	A	--	--	100
13080	008	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13082	008	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
13083	008	01-1201	36	-----	58	49	-----	A	--	A	--	--	100
13088	154	01-0403	-----	44	51	48	-----	--	A	A	--	--	100
13089	002	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
13090	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
13101	002	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
13107	008	01-1201	36	53	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
13108	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
13109	008	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
13115	041	01-1201	-----	52	57	-----	78	--	A	A	--	--	100
14002	008	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
14004	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
14005	137	01-1201	-----	54	57	-----	76	--	B	A	--	--	78.6
14006	006	01-0403	67	-----	126	150	-----	D	--	D	--	--	0
14007	041	01-1201	37	-----	57	-----	77	A	--	A	--	--	100
14018	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
14022	008	01-1201	-----	52	57	-----	74	--	A	A	--	--	100
14023	006	01-0403	67	94	-----	150	-----	D	D	--	--	--	0
14024	008	01-1201	36	-----	58	-----	74	A	--	A	--	--	100
14026	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
14029	041	01-1201	37	-----	57	51	-----	A	--	A	--	--	100
15007	008	01-1201	36	53	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
15008	002	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
15010	002	01-0403	-----	44	51	-----	72	--	A	A	--	--	100
16004	171	01-1201	-----	52	57	-----	75	--	A	A	--	--	100
16005	006	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	D	D	--	--	0
16008	089	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
17003	190	01-1201	36	-----	55	-----	77	A	--	B	--	--	92.9
18003	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
20001	006	01-0403	67	94	-----	150	-----	D	D	--	--	--	0
20002	128	01-0403	32	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
20003	081	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
20004	081	01-1201	36	52	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
21001	172	01-0403	32	44	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
21004	057	01-1201	36	51	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
22007	144	01-1201	36	-----	56	-----	77	A	--	A	--	--	100
22010	006	01-0403	67	94	-----	150	-----	D	D	--	--	--	0
22015	008	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
22019	006	01-0403	67	94	-----	150	-----	D	D	--	--	--	0
22023	129	01-0403	32	-----	50	-----	72	A	--	A	--	--	100
23001	057	01-1201	-----	51	56	49	-----	--	A	A	--	--	100

[9]HDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23002	172	01-0403	32	-----	51	49	-----	A	--	A	--	--	100
23005	002	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
23006	088	01-0403	-----	44	50	50	-----	--	A	A	--	--	100
23007	169	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
23009	088	01-0403	-----	44	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
23012	083	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
23018	008	01-1201	37	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
23022	006	01-0403	67	-----	126	-----	101	D	--	D	--	--	0
23026	088	01-0403	-----	44	50	50	-----	--	A	A	--	--	100
23030	088	01-0403	32	-----	50	50	-----	A	--	A	--	--	100
23032	083	01-0403	32	44	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
23037	088	01-0403	32	-----	50	-----	72	A	--	A	--	--	100
23038	169	01-0403	31	-----	50	49	-----	A	--	A	--	--	100
23039	169	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
23040	008	01-1201	36	-----	58	-----	74	A	--	A	--	--	100
23042	200	01-0403	32	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
24001	169	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
24002	122	01-1201	36	52	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100
25001	122	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
25002	126	01-0403	-----	44	51	49	-----	--	A	A	--	--	100
26002	024	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
26005	009	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
26012	200	01-0403	32	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
27001	029	01-1201	37	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
27002	008	01-1201	36	-----	58	49	-----	A	--	A	--	--	100
27003	200	01-0403	32	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
27005	122	01-1201	36	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
27006	200	01-0403	32	44	-----	48	-----	A	A	--	--	--	100
27007	009	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
27009	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
27010	094	01-0403	32	-----	51	-----	72	A	--	A	--	--	100
27018	060	01-1201	36	52	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
27023	090	01-0403	-----	45	51	50	-----	--	A	A	--	--	100
27031	090	01-0403	-----	45	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
27037	200	01-0403	32	-----	50	-----	73	A	--	A	--	--	100
27038	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
27041	029	01-1201	36	52	-----	-----	76	A	A	--	--	--	100
27042	102	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
27045	200	01-0403	-----	44	50	48	-----	--	A	A	--	--	100
27048	200	01-0403	32	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
27051	002	01-0403	-----	44	51	48	-----	--	A	A	--	--	100
27052	200	01-0403	32	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
27061	200	01-0403	-----	44	50	-----	73	--	A	A	--	--	100
28001	090	01-0403	-----	45	51	50	-----	--	A	A	--	--	100
28007	197	01-1201	36	51	-----	-----	76	A	A	--	--	--	100
28008	090	01-0403	31	45	-----	-----	73	A	A	--	--	--	100
28014	008	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
28015	002	01-0403	32	-----	51	48	-----	A	--	A	--	--	100
28018	102	01-0403	-----	44	51	-----	73	--	A	A	--	--	100
28019	002	01-0403	32	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
28022	198	01-1201	-----	51	56	-----	76	--	A	A	--	--	100
28024	006	01-0403	67	94	-----	150	-----	D	D	--	--	--	0
28029	200	01-0403	32	-----	50	48	-----	A	--	A	--	--	100
30006	126	01-0403	32	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
31002	008	01-1201	-----	52	58	49	-----	--	A	A	--	--	100
31003	008	01-1201	-----	52	57	49	-----	--	A	A	--	--	100

[9]HDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
33002	065	01-1201	36	51	-----	50	-----	A	A	--	--	--	100
33004	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
33014	112	01-0403	32	-----	52	-----	74	A	--	B	--	--	92.9
34001	008	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
34002	008	01-1201	36	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
34003	008	01-1201	-----	52	58	-----	74	--	A	A	--	--	100
34005	112	01-0403	-----	44	50	-----	72	--	A	A	--	--	100
34013	112	01-0403	31	44	-----	-----	72	A	A	--	--	--	100
35006	109	01-0403	-----	43	49	47	-----	--	A	A	--	--	100
36002	161	01-0403	32	-----	51	49	-----	A	--	A	--	--	100
37001	058	01-1201	36	51	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
37004	008	01-1201	37	52	-----	-----	74	A	A	--	--	--	100
38006	054	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	A	A	--	--	100
38009	006	01-0403	67	94	-----	-----	101	D	D	--	--	--	0
40001	193	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
40002	193	01-1201	-----	52	57	50	-----	--	A	A	--	--	100
40004	165	01-1201	36	-----	57	49	-----	A	--	A	--	--	100
40006	165	01-1201	36	-----	56	-----	74	A	--	A	--	--	100
40013	109	01-0403	-----	43	50	47	-----	--	A	A	--	--	100
40015	008	01-1201	37	-----	58	-----	74	A	--	A	--	--	100
40022	165	01-1201	36	-----	56	48	-----	A	--	A	--	--	100
40025	109	01-0403	-----	43	49	-----	71	--	A	A	--	--	100
40026	165	01-1201	-----	51	56	-----	73	--	A	A	--	--	100
40028	200	01-0403	32	44	-----	-----	73	A	A	--	--	--	100
40029	069	01-1201	36	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
40030	109	01-0403	-----	43	49	47	-----	--	A	A	--	--	100
40031	151	01-2304	-----	45	53	48	-----	--	A	A	--	--	100
40034	193	01-1201	36	-----	57	-----	75	A	--	A	--	--	100
40035	165	01-1201	36	-----	56	49	-----	A	--	A	--	--	100
41001	073	01-0403	-----	44	51	49	-----	--	A	A	--	--	100
41002	008	01-1201	37	52	-----	49	-----	A	A	--	--	--	100
42001	165	01-1201	36	-----	56	-----	74	A	--	A	--	--	100
42002	008	01-1201	-----	52	58	-----	75	--	A	A	--	--	100
43004	146	01-1201	37	-----	57	50	-----	A	--	A	--	--	100
43007	095	01-2304	-----	45	53	47	-----	--	A	A	--	--	100
44002	193	01-1201	-----	52	57	-----	75	--	A	A	--	--	100
46001	193	01-1201	36	52	-----	-----	75	A	A	--	--	--	100

[10]LDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	01-1201	71	-----	131	157	-----	A	--	A	--	--	100
01007	008	01-1201	71	-----	130	-----	107	A	--	A	--	--	100
01019	052	01-1201	71	101	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
01027	052	01-1201	71	-----	130	157	-----	A	--	A	--	--	100
02001	008	01-1201	-----	103	133	156	-----	--	A	A	--	--	100
02003	110	01-0403	66	-----	125	-----	100	A	--	A	--	--	100
03004	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
04001	185	01-0403	66	93	-----	-----	99	A	A	--	--	--	100
04006	185	01-0403	-----	92	123	146	-----	--	A	A	--	--	100
04012	002	01-0403	66	92	-----	-----	100	A	A	--	--	--	100
06001	136	01-1201	70	-----	132	-----	105	A	--	A	--	--	100
06004	008	01-1201	-----	102	132	156	-----	--	A	A	--	--	100
07004	062	01-1201	-----	101	128	155	-----	--	A	A	--	--	100
07007	174	01-0403	-----	94	125	-----	101	--	A	A	--	--	100
08002	008	01-1201	-----	103	133	-----	107	--	A	A	--	--	100
09004	075	01-0403	66	-----	126	-----	101	A	--	A	--	--	100
09007	168	01-1201	72	102	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
09008	062	01-1201	-----	100	128	-----	104	--	A	A	--	--	100
09009	008	01-1201	70	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
09010	002	01-0403	67	94	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
09011	002	01-0403	67	94	-----	150	-----	A	A	--	--	--	100
09014	075	01-0403	66	94	-----	150	-----	A	A	--	--	--	100
10001	002	01-0403	-----	94	127	150	-----	--	A	A	--	--	100
10002	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
11002	008	01-1201	70	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
11004	160	01-0403	-----	91	125	-----	100	--	A	A	--	--	100
11005	175	01-0403	66	-----	125	-----	101	A	--	A	--	--	100
11007	008	01-1201	71	102	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
11021	176	01-0403	67	-----	129	-----	101	A	--	A	--	--	100
11025	100	01-0403	-----	93	126	148	-----	--	A	A	--	--	100
12003	006	01-0403	-----	44	50	-----	73	--	D	D	--	--	0
12006	008	01-1201	-----	103	133	156	-----	--	A	A	--	--	100
12010	122	01-1201	-----	102	132	-----	107	--	A	A	--	--	100
12011	111	01-0403	66	-----	126	100	-----	A	--	A	--	--	100
12012	008	01-1201	-----	103	133	155	-----	--	A	A	--	--	100
12013	087	01-0403	-----	94	128	150	-----	--	A	A	--	--	100
12014	075	01-0403	67	94	-----	-----	103	A	A	--	--	--	100
12015	041	01-1201	73	103	-----	159	-----	A	A	--	--	--	100
12018	041	01-1201	-----	103	134	158	-----	--	A	A	--	--	100
13001	050	01-1201	71	100	-----	-----	105	A	A	--	--	--	100
13004	200	01-0403	-----	93	126	-----	101	--	A	A	--	--	100
13005	002	01-0403	67	-----	127	149	-----	A	--	A	--	--	100
13006	002	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
13007	002	01-0403	67	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
13008	002	01-0403	67	-----	127	149	-----	A	--	A	--	--	100
13010	008	01-1201	70	102	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
13013	111	01-0403	-----	94	126	-----	100	--	A	A	--	--	100
13014	008	01-1201	70	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
13015	008	01-1201	-----	103	134	-----	107	--	A	A	--	--	100
13016	041	01-1201	72	103	-----	-----	108	A	A	--	--	--	100
13021	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
13022	008	01-1201	70	101	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
13024	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
13033	087	01-0403	67	-----	128	-----	102	A	--	A	--	--	100
13035	008	01-1201	71	102	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
13036	006	01-0403	-----	44	50	49	-----	--	D	D	--	--	0

[10]LDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	01-0403	67	-----	127	149	-----	A	--	A	--	--	100
13039	002	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
13045	002	01-0403	-----	94	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
13049	002	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
13051	008	01-1201	70	-----	133	-----	106	A	--	A	--	--	100
13052	002	01-0403	67	94	-----	150	-----	A	A	--	--	--	100
13055	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
13056	012	01-1201	-----	101	133	153	-----	--	A	A	--	--	100
13063	050	01-1201	71	100	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
13067	008	01-1201	-----	103	133	-----	106	--	A	A	--	--	100
13071	075	01-0403	66	95	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
13077	008	01-1201	71	-----	133	-----	107	A	--	A	--	--	100
13078	006	01-0403	32	44	-----	-----	73	D	D	--	--	--	0
13079	041	01-1201	-----	103	134	-----	109	--	A	A	--	--	100
13080	008	01-1201	70	102	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
13082	008	01-1201	71	102	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
13083	008	01-1201	71	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
13088	154	01-0403	-----	94	128	150	-----	--	A	A	--	--	100
13089	002	01-0403	67	94	-----	150	-----	A	A	--	--	--	100
13090	008	01-1201	-----	102	132	-----	107	--	A	A	--	--	100
13101	002	01-0403	67	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
13107	008	01-1201	70	103	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
13108	008	01-1201	-----	101	133	-----	106	--	A	A	--	--	100
13109	008	01-1201	70	102	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
13115	041	01-1201	-----	103	133	-----	109	--	A	A	--	--	100
14002	008	01-1201	71	103	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
14004	008	01-1201	-----	101	132	156	-----	--	A	A	--	--	100
14005	137	01-1201	-----	104	133	-----	103	--	A	A	--	--	100
14006	006	01-0403	31	-----	50	49	-----	D	--	D	--	--	0
14007	041	01-1201	72	-----	132	-----	107	A	--	A	--	--	100
14018	008	01-1201	-----	102	132	-----	106	--	A	A	--	--	100
14022	008	01-1201	-----	102	132	-----	107	--	A	A	--	--	100
14023	006	01-0403	32	44	-----	49	-----	D	D	--	--	--	0.0
14024	008	01-1201	71	-----	133	-----	106	A	--	A	--	--	100
14026	008	01-1201	70	-----	133	154	-----	A	--	A	--	--	100
14029	041	01-1201	73	-----	133	159	-----	A	--	A	--	--	100
15007	008	01-1201	71	102	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
15008	002	01-0403	67	94	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
15010	002	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
16004	171	01-1201	-----	101	131	-----	106	--	A	A	--	--	100
16005	006	01-0403	-----	43	50	-----	72	--	D	D	--	--	0
16008	089	01-1201	71	101	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
17003	190	01-1201	70	-----	128	-----	102	A	--	A	--	--	100
18003	008	01-1201	-----	102	133	156	-----	--	A	A	--	--	100
20001	006	01-0403	32	44	-----	49	-----	D	D	--	--	--	0
20002	128	01-0403	66	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
20003	081	01-1201	72	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
20004	081	01-1201	72	102	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
21001	172	01-0403	66	94	-----	148	-----	A	A	--	--	--	100
21004	057	01-1201	72	101	-----	155	-----	A	A	--	--	--	100
22007	144	01-1201	72	-----	133	-----	108	A	--	A	--	--	100
22010	006	01-0403	32	44	-----	49	-----	D	D	--	--	--	0
22015	008	01-1201	71	102	-----	156	-----	A	A	--	--	--	100
22019	006	01-0403	31	44	-----	49	-----	D	D	--	--	--	0
22023	129	01-0403	66	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
23001	057	01-1201	-----	101	130	154	-----	--	A	A	--	--	100

[10]LDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23002	172	01-0403	66	-----	127	150	-----	A	--	A	--	--	100
23005	002	01-0403	67	-----	127	150	-----	A	--	A	--	--	100
23006	088	01-0403	-----	94	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
23007	169	01-0403	-----	95	128	150	-----	--	A	A	--	--	100
23009	088	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
23012	083	01-0403	-----	94	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
23018	008	01-1201	70	102	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
23022	006	01-0403	31	-----	50	-----	73	D	--	D	--	--	0
23026	088	01-0403	-----	94	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
23030	088	01-0403	66	-----	127	149	-----	A	--	A	--	--	100
23032	083	01-0403	67	94	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
23037	088	01-0403	66	-----	127	-----	101	A	--	A	--	--	100
23038	169	01-0403	67	-----	128	150	-----	A	--	A	--	--	100
23039	169	01-0403	-----	95	128	150	-----	--	A	A	--	--	100
23040	008	01-1201	70	-----	131	-----	107	A	--	A	--	--	100
23042	200	01-0403	67	-----	126	-----	101	A	--	A	--	--	100
24001	169	01-0403	-----	95	128	150	-----	--	A	A	--	--	100
24002	122	01-1201	71	102	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
25001	122	01-1201	71	-----	132	-----	107	A	--	A	--	--	100
25002	126	01-0403	-----	94	126	148	-----	--	A	A	--	--	100
26002	024	01-1201	72	101	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
26005	009	01-1201	72	-----	132	-----	103	A	--	A	--	--	100
26012	200	01-0403	67	-----	126	149	-----	A	--	A	--	--	100
27001	029	01-1201	73	-----	134	158	-----	A	--	A	--	--	100
27002	008	01-1201	70	-----	132	155	-----	A	--	A	--	--	100
27003	200	01-0403	67	-----	126	-----	101	A	--	A	--	--	100
27005	122	01-1201	71	-----	132	157	-----	A	--	A	--	--	100
27006	200	01-0403	67	93	-----	149	-----	A	A	--	--	--	100
27007	009	01-1201	72	-----	133	154	-----	A	--	A	--	--	100
27009	008	01-1201	71	-----	133	155	-----	A	--	A	--	--	100
27010	094	01-0403	66	-----	126	-----	101	A	--	A	--	--	100
27018	060	01-1201	71	102	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
27023	090	01-0403	-----	93	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
27031	090	01-0403	-----	93	127	-----	101	--	A	A	--	--	100
27037	200	01-0403	67	-----	126	-----	101	A	--	A	--	--	100
27038	008	01-1201	-----	102	132	155	-----	--	A	A	--	--	100
27041	029	01-1201	73	104	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
27042	102	01-0403	-----	92	125	-----	100	--	A	A	--	--	100
27045	200	01-0403	-----	93	126	149	-----	--	A	A	--	--	100
27048	200	01-0403	67	-----	126	149	-----	A	--	A	--	--	100
27051	002	01-0403	-----	94	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
27052	200	01-0403	67	-----	126	149	-----	A	--	A	--	--	100
27061	200	01-0403	-----	93	126	-----	101	--	A	A	--	--	100
28001	090	01-0403	-----	93	127	149	-----	--	A	A	--	--	100
28007	197	01-1201	70	100	-----	-----	103	A	A	--	--	--	100
28008	090	01-0403	66	93	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
28014	008	01-1201	70	102	-----	154	-----	A	A	--	--	--	100
28015	002	01-0403	67	-----	127	150	-----	A	--	A	--	--	100
28018	102	01-0403	-----	92	125	-----	100	--	A	A	--	--	100
28019	002	01-0403	67	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
28022	198	01-1201	-----	100	131	-----	106	--	A	A	--	--	100
28024	006	01-0403	31	44	-----	48	-----	D	D	--	--	--	0
28029	200	01-0403	67	-----	126	149	-----	A	--	A	--	--	100
30006	126	01-0403	66	94	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
31002	008	01-1201	-----	101	133	154	-----	--	A	A	--	--	100
31003	008	01-1201	-----	102	133	155	-----	--	A	A	--	--	100

[10]LDLコレステロール　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
33002	065	01-1201	71	101	-----	158	-----	A	A	--	--	--	100
33004	008	01-1201	-----	102	134	-----	107	--	A	A	--	--	100
33014	112	01-0403	68	-----	128	-----	103	A	--	A	--	--	100
34001	008	01-1201	70	-----	133	154	-----	A	--	A	--	--	100
34002	008	01-1201	70	102	-----	-----	106	A	A	--	--	--	100
34003	008	01-1201	-----	102	132	-----	106	--	A	A	--	--	100
34005	112	01-0403	-----	92	126	-----	101	--	A	A	--	--	100
34013	112	01-0403	66	92	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
35006	109	01-0403	-----	92	123	146	-----	--	A	A	--	--	100
36002	161	01-0403	67	-----	128	151	-----	A	--	A	--	--	100
37001	058	01-1201	71	102	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
37004	008	01-1201	71	103	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100
38006	054	01-0403	-----	93	126	146	-----	--	A	A	--	--	100
38009	006	01-0403	31	44	-----	-----	73	D	D	--	--	--	0
40001	193	01-1201	71	-----	130	-----	107	A	--	A	--	--	100
40002	193	01-1201	-----	101	133	157	-----	--	A	A	--	--	100
40004	165	01-1201	71	-----	132	152	-----	A	--	A	--	--	100
40006	165	01-1201	70	-----	130	-----	102	A	--	A	--	--	100
40013	109	01-0403	-----	92	125	147	-----	--	A	A	--	--	100
40015	008	01-1201	71	-----	133	-----	106	A	--	A	--	--	100
40022	165	01-1201	71	-----	131	153	-----	A	--	A	--	--	100
40025	109	01-0403	-----	92	122	-----	99	--	A	B	--	--	92.9
40026	165	01-1201	-----	100	131	-----	102	--	A	A	--	--	100
40028	200	01-0403	67	93	-----	-----	101	A	A	--	--	--	100
40029	069	01-1201	71	102	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
40030	109	01-0403	-----	92	123	146	-----	--	A	A	--	--	100
40031	151	01-2302	-----	107	137	146	-----	--	A	A	--	--	100
40034	193	01-1201	71	-----	131	-----	107	A	--	A	--	--	100
40035	165	01-1201	70	-----	131	153	-----	A	--	A	--	--	100
41001	073	01-0403	-----	94	127	151	-----	--	A	A	--	--	100
41002	008	01-1201	70	103	-----	157	-----	A	A	--	--	--	100
42001	165	01-1201	71	-----	131	-----	103	A	--	A	--	--	100
42002	008	01-1201	-----	102	131	-----	107	--	A	A	--	--	100
43004	146	01-1201	72	-----	132	157	-----	A	--	A	--	--	100
43007	095	01-2302	-----	111	140	149	-----	--	A	A	--	--	100
44002	193	01-1201	-----	101	131	-----	107	--	A	A	--	--	100
46001	193	01-1201	71	101	-----	-----	107	A	A	--	--	--	100

[11]HbA1C　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	02-0401	5.6	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
01007	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
01019	052	02-0401	5.6	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
01027	052	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
02001	008	02-0401	5.6	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
02003	110	01-2901	5.6	-----	7.6	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
03004	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
04001	185	03-2701	-----	6.4	7.4	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
04006	185	01-2701	5.5	-----	7.4	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
04012	002	03-2701	5.5	6.5	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
06001	008	02-0401	5.6	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
06004	008	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
07004	062	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
07007	174	02-0401	5.5	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
08002	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
09004	075	03-0401	-----	6.6	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
09007	168	02-2401	5.5	-----	7.7	5.3	6.1	A	--	A	--	--	100
09008	062	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
09009	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
09010	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
09011	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
09014	075	03-0401	-----	6.6	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
10001	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
10002	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
11002	008	01-2901	5.6	-----	7.6	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
11004	160	01-2901	5.6	-----	7.6	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
11005	175	01-2701	5.5	-----	7.4	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
11007	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
11021	176	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
11025	100	03-0401	5.7	-----	7.8	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
12003	006	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.1	A	--	A	--	--	100
12006	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
12010	122	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
12011	111	02-0403	5.6	-----	8.0	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
12012	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
12013	087	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
12014	075	03-0401	5.7	-----	7.6	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
12015	041	02-2401	5.6	-----	7.8	5.3	6.1	A	--	A	--	--	100
12018	041	02-2401	-----	6.7	7.8	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13001	050	02-2401	5.4	6.6	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
13004	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13005	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13006	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13007	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13008	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13010	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13013	111	02-0403	5.6	6.8	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
13014	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13015	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13016	041	02-2401	5.5	-----	7.8	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
13021	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
13022	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
13024	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
13033	087	02-0403	5.6	6.8	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
13035	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13036	006	03-0401	-----	6.7	7.7	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100

[11]HbA1C　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
13039	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
13045	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
13049	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
13051	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13052	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13055	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
13056	012	03-2701	5.4	-----	7.4	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
13063	050	02-2401	5.5	6.6	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
13067	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13071	075	03-0401	-----	6.6	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13077	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
13078	006	03-0401	5.6	-----	7.7	5.3	6.1	A	--	A	--	--	100
13079	041	02-2401	-----	6.8	7.8	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
13080	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
13082	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13083	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
13088	154	03-0401	5.7	6.6	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13089	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
13090	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
13101	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
13107	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
13108	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
13109	008	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
13115	041	02-2401	5.6	6.8	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
14002	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
14004	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
14005	137	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
14006	006	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
14007	041	02-2401	-----	6.8	7.8	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
14018	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
14022	008	02-0401	5.7	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
14023	006	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
14024	008	02-0401	5.6	6.9	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100
14026	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
14029	041	02-2401	-----	6.7	7.8	5.3	6.1	--	A	A	--	--	100
15007	008	02-0401	5.7	-----	8.0	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
15008	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
15010	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
16004	171	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
16005	006	03-0401	5.6	6.7	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
16008	089	02-0404	5.6	6.9	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
17003	190	03-2701	-----	6.3	7.3	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
18003	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
20001	006	03-0401	-----	6.7	7.7	5.4	6.1	--	A	A	--	--	100
20002	128	02-0404	5.6	6.8	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
20003	081	02-2401	5.5	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
20004	081	01-2901	5.5	6.5	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
21001	172	02-0401	5.6	6.8	-----	5.3	6.1	A	A	--	--	--	100
21004	057	01-2701	5.5	-----	7.5	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
22007	144	02-2401	5.5	6.7	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
22010	006	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.1	A	A	--	--	--	100
22015	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
22019	006	03-0401	5.6	-----	7.7	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
22023	129	02-0401	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
23001	057	01-2701	5.5	6.4	-----	5.3	6.1	A	A	--	--	--	100

[11]HbA1C　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23002	172	02-0401	5.6	-----	8.0	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
23005	002	03-2701	5.3	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
23006	088	02-0403	5.5	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
23007	169	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
23009	088	02-0403	-----	6.8	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
23012	083	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
23018	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
23022	006	03-0401	5.7	-----	7.7	5.4	6.1	A	--	A	--	--	100
23026	088	02-0403	5.5	6.8	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
23029	172	02-0401	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
23030	088	02-0403	5.5	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
23032	083	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
23037	088	02-0403	5.5	6.8	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
23038	169	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
23039	169	03-0401	5.7	6.7	-----	5.4	6.0	A	A	--	--	--	100
23040	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
23042	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
24001	169	03-0401	-----	6.7	7.7	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100
24002	122	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
25001	122	02-0401	5.6	6.9	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
25002	126	02-0403	5.6	6.6	-----	5.4	6.0	A	B	--	--	--	92.9
26002	024	03-2701	-----	6.5	7.5	5.4	6.0	--	A	A	--	--	100
26005	009	02-2401	5.5	6.7	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
26012	200	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27001	029	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27002	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
27003	200	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27005	122	02-0401	5.6	-----	8.0	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27006	200	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27007	009	02-2401	5.5	-----	7.8	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
27009	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
27010	094	02-0403	-----	6.7	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27018	060	02-0401	-----	6.9	8.0	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27023	090	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27031	090	03-0401	5.7	-----	7.7	6.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27037	200	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27038	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
27041	029	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.1	A	--	A	--	--	100
27042	102	03-0401	-----	6.6	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
27045	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
27048	200	03-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
27051	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
27052	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
27061	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
28001	090	02-0401	5.7	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	B	--	--	85.7
28007	197	01-2901	-----	6.5	7.5	5.4	6.2	--	A	A	--	--	100
28008	090	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
28014	008	02-0401	5.7	6.9	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
28015	002	03-2701	5.3	-----	7.4	5.3	5.9	A	--	A	--	--	100
28018	102	03-0401	-----	6.6	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
28019	002	03-2701	-----	6.3	7.4	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100
28022	198	03-2701	5.3	6.4	-----	5.3	6.1	A	A	--	--	--	100
28024	006	03-0401	-----	6.6	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
28029	200	03-0401	5.7	6.7	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
30006	126	02-0403	-----	6.6	7.8	5.4	6.0	--	B	A	--	--	92.9
31002	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.3	5.9	--	A	A	--	--	100

[11]HbA1C　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
31003	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
33002	065	03-2701	5.5	6.5	-----	5.6	6.1	A	A	--	--	--	100
33004	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
33014	112	02-0401	5.6	6.8	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
34001	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
34002	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
34003	008	02-0401	5.6	-----	8.1	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
34005	112	02-0401	-----	6.8	8.0	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
34013	112	02-0401	-----	6.8	8.0	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
35006	109	03-0401	-----	6.7	7.7	5.2	5.8	--	A	A	--	--	100
36002	161	03-0401	5.7	6.6	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
37001	058	03-2701	5.4	6.3	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
37004	008	02-0401	-----	6.9	8.1	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
38006	054	02-0404	5.5	6.7	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
38009	006	03-0401	5.7	-----	7.7	5.4	6.0	A	--	A	--	--	100
40001	193	02-0403	5.6	-----	8.0	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
40002	193	02-0403	5.6	-----	8.0	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
40004	165	02-2401	5.5	6.7	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
40006	165	02-2401	-----	6.7	7.6	5.2	6.0	--	A	A	--	--	100
40013	109	03-0401	5.6	6.6	-----	5.2	5.8	A	A	--	--	--	100
40015	008	02-0401	5.7	-----	8.1	5.2	6.0	A	--	A	--	--	100
40022	165	02-2401	5.5	6.7	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
40025	109	03-0401	5.6	-----	7.7	5.2	5.8	A	--	A	--	--	100
40026	165	02-2401	5.5	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
40028	200	03-0401	-----	6.7	7.7	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
40029	069	02-0403	-----	6.9	8.0	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
40030	109	03-0401	5.6	-----	7.8	5.2	5.8	A	--	A	--	--	100
40031	151	02-0404	5.6	6.7	-----	5.3	5.9	A	A	--	--	--	100
40034	193	02-0403	-----	6.9	8.0	5.2	5.9	--	A	A	--	--	100
40035	165	02-2401	5.5	6.7	-----	5.2	6.0	A	A	--	--	--	100
41001	073	02-0404	5.5	-----	7.7	5.3	6.0	A	--	A	--	--	100
41002	008	02-0401	5.7	7.0	-----	5.3	6.0	A	A	--	--	--	100
42001	165	02-2401	5.5	6.6	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
42002	008	02-0401	5.6	6.9	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100
43004	146	01-2901	5.6	6.6	-----	5.5	6.3	A	A	--	--	--	100
43007	095	01-2901	-----	6.5	7.6	5.3	6.0	--	A	A	--	--	100
44002	193	02-0403	5.6	-----	8.0	5.2	5.9	A	--	A	--	--	100
46001	193	02-0403	5.6	6.9	-----	5.2	5.9	A	A	--	--	--	100

[12]尿糖　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01019	052	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09004	075	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13013	111	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13022	008	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13052	002	2	1	3	-----	3	4	-----	-----	4	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13071	075	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13089	002	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13115	041	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22007	144	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23030	088	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23039	169	2	1	3	3	-----	4	-----	1	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
25002	126	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26002	024	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27009	008	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27042	102	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27048	200	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27052	200	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28022	198	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
36002	161	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40004	165	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40013	109	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40026	165	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
42001	165	2	1	3	3	-----	4	-----	-----	4	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[13]尿蛋白　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01019	052	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09004	075	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13013	111	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13022	008	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13052	002	2	3	1	-----	4	3	-----	-----	1	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13071	075	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13089	002	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13115	041	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22007	144	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23030	088	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23039	169	2	3	1	3	-----	3	-----	4	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
25002	126	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26002	024	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27009	008	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27042	102	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27048	200	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27052	200	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28022	198	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
36002	161	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40004	165	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40013	109	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40026	165	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
42001	165	2	3	1	3	-----	3	-----	-----	1	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[14]尿潜血　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値								試料NO別判定値								総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
01019	052	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
09004	075	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13013	111	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
13022	008	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
13052	002	2	1	1	-----	2	1	-----	-----	3	A	A	--	A	A	--	--	A	100
13071	075	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
13089	002	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13115	041	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
22007	144	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
23030	088	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23039	169	2	1	1	3	-----	1	-----	2	-----	A	A	A	--	A	--	A	--	100
25002	126	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
26002	024	2	1	1	-----	2	-----	2	2	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27009	008	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27042	102	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
27048	200	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27052	200	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
28022	198	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
36002	161	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40004	165	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40013	109	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100
40026	165	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
42001	165	2	1	1	3	-----	1	-----	-----	3	A	A	A	--	A	--	--	A	100

[15]ヘモグロビン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
01007	008	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
01019	052	2	14.4	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
01027	052	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
02001	008	2	14.5	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
02003	110	2	14.5	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
03004	002	2	14.6	13.6	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100
04001	185	2	14.7	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
04006	185	2	14.7	13.6	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100
04012	002	2	14.7	-----	9.5	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
06001	136	2	14.5	13.5	-----	12.3	10.0	A	A	--	--	--	100
06004	008	2	14.4	-----	9.5	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
07004	062	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
07007	174	2	14.6	13.5	-----	12.2	10.0	A	A	--	--	--	100
08002	008	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
09004	075	2	14.6	-----	9.4	12.4	9.9	A	--	A	--	--	100
09007	168	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
09008	062	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
09009	008	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
09010	002	2	14.7	-----	9.5	12.4	9.9	A	--	A	--	--	100
09011	002	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
09014	075	2	14.5	13.4	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
10001	002	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
10002	002	2	14.7	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
11002	008	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
11004	160	2	14.6	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
11005	175	2	14.6	-----	9.5	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
11007	008	2	14.5	13.4	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
11021	176	2	14.6	-----	9.4	12.4	10.1	A	--	A	--	--	100
11025	100	2	14.6	13.5	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
12003	006	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
12006	008	2	14.5	-----	9.5	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
12010	122	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
12011	111	2	14.3	13.2	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
12012	008	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
12013	087	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
12014	075	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
12015	041	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
12018	041	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13001	050	2	14.6	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
13004	200	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
13005	002	2	14.7	-----	9.5	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13006	002	2	14.7	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13007	002	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13008	002	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13010	008	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
13013	111	2	14.2	13.2	-----	12.1	9.9	B	A	--	--	--	92.9
13014	008	2	14.4	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
13015	008	2	14.5	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
13016	041	2	14.6	13.4	-----	12.1	9.7	A	A	--	--	--	100
13021	002	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13022	008	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
13024	002	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13033	087	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
13035	008	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13036	006	2	14.6	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100

[15]ヘモグロビン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13039	002	2	14.7	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13045	002	2	14.6	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13049	002	2	14.6	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13051	008	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
13052	002	2	14.6	-----	9.5	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13055	002	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
13056	012	2	14.5	-----	9.3	12.0	9.7	A	--	A	--	--	100
13063	050	2	14.6	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
13067	008	2	14.4	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
13071	075	2	14.5	13.4	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
13077	008	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
13078	006	2	14.6	-----	9.4	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
13079	041	2	14.6	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
13080	008	2	14.4	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13082	008	2	14.4	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13083	008	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13088	154	2	14.6	13.5	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
13089	002	2	14.7	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
13090	008	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
13101	002	2	14.7	-----	9.5	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13107	008	2	14.6	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
13109	008	2	14.5	-----	9.3	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
13115	041	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.7	A	A	--	--	--	100
14002	008	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
14004	008	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
14005	137	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
14006	006	2	14.6	-----	9.4	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
14007	041	2	14.6	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
14018	008	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
14022	008	2	14.4	-----	9.4	12.1	10.0	A	--	A	--	--	100
14023	006	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
14026	008	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
14029	041	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
15007	008	2	14.4	13.5	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
15008	002	2	14.7	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
15010	002	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
16004	171	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
16005	006	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
16008	089	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
17003	190	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
18003	008	2	14.4	13.5	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
20001	006	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
20002	128	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
20003	081	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
20004	081	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
21001	172	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
21004	057	2	14.5	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
22007	144	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
22010	006	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
22015	008	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
22019	006	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
22023	129	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
23001	057	2	14.5	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
23002	172	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23005	002	2	14.6	13.6	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100

[15]ヘモグロビン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
23007	169	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
23009	088	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23012	083	2	14.4	13.4	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
23018	008	2	14.4	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
23022	006	2	14.6	13.5	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
23026	088	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23029	172	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
23030	088	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
23032	083	2	14.4	13.4	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
23037	088	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
23038	169	2	14.6	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
23039	169	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
23040	008	2	14.4	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
23042	200	2	14.5	13.4	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
24001	169	2	14.6	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
24002	122	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
25001	122	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
25002	126	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
26002	024	9	14.4	13.4	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
26005	009	2	14.9	-----	9.8	12.6	10.3	B	--	C	--	--	57.1
26012	200	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27002	008	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
27003	200	2	14.5	-----	9.3	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
27005	122	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27006	200	2	14.4	13.5	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
27007	009	2	14.9	13.9	-----	12.6	10.3	B	B	--	--	--	71.4
27009	008	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27010	094	1	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27018	060	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27023	090	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
27031	090	2	14.5	-----	9.3	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100
27037	200	2	14.4	13.4	-----	12.3	9.7	A	A	--	--	--	100
27038	008	2	14.5	13.4	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
27041	029	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
27042	102	2	14.7	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
27045	200	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
27048	200	2	14.6	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
27051	002	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
27052	200	2	14.6	13.4	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
27061	200	2	14.4	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
28001	090	2	14.5	13.6	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
28007	197	2	14.7	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
28008	090	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.7	A	--	A	--	--	100
28014	008	2	14.5	13.5	-----	12.3	9.8	A	A	--	--	--	100
28015	002	2	14.6	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
28018	102	2	14.7	13.6	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
28019	002	2	14.7	-----	9.4	12.4	9.9	A	--	A	--	--	100
28022	198	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
28029	200	2	14.6	-----	9.3	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
30006	126	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
31002	008	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
31003	008	2	14.5	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
33002	065	9	14.4	-----	9.3	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
33004	008	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
33014	112	2	14.5	-----	9.3	12.3	9.8	A	--	A	--	--	100

[15]ヘモグロビン　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関		測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	測定法	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
34002	008	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
34003	008	2	14.4	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
34005	112	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
34013	112	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
35006	109	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
36002	161	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
37001	058	2	14.5	13.5	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
37004	008	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.9	A	A	--	--	--	100
38006	054	1	14.4	13.3	-----	12.1	9.9	A	A	--	--	--	100
38009	006	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40001	193	2	14.4	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100
40002	193	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
40004	165	2	14.7	-----	9.5	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
40006	165	2	14.8	-----	9.5	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
40013	109	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
40015	008	2	14.6	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
40022	165	2	14.7	13.7	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
40025	109	2	14.6	-----	9.4	12.1	9.9	A	--	A	--	--	100
40026	165	2	14.7	13.7	-----	12.2	10.0	A	A	--	--	--	100
40028	200	2	14.5	-----	9.4	12.1	9.7	A	--	A	--	--	100
40029	069	2	14.4	13.5	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
40030	109	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40031	151	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.8	A	--	A	--	--	100
40034	193	2	14.5	-----	9.3	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
40035	165	2	14.8	13.7	-----	12.4	9.9	A	A	--	--	--	100
41001	073	2	14.7	13.6	-----	12.3	9.9	A	A	--	--	--	100
41002	008	2	14.6	-----	9.4	12.3	9.9	A	--	A	--	--	100
42001	165	2	14.7	-----	9.5	12.1	9.8	A	--	A	--	--	100
42002	008	2	14.6	-----	9.4	12.2	9.9	A	--	A	--	--	100
43004	146	2	14.5	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
43007	095	2	14.5	13.5	-----	12.2	9.7	A	A	--	--	--	100
44002	193	2	14.5	13.4	-----	12.2	9.8	A	A	--	--	--	100
46001	193	2	14.5	13.4	-----	12.1	9.8	A	A	--	--	--	100

[16]赤血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	JAB512	488	465	-----	404	364	A	A	--	--	--	100
01007	008	JAB512	486	-----	354	406	362	A	--	A	--	--	100
01019	052	JAB512	488	463	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
01027	052	JAB512	491	464	-----	408	368	A	A	--	--	--	100
02001	008	JAB512	489	464	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
02003	110	JAB517	480	-----	343	401	359	A	--	A	--	--	100
03004	002	JAB512	490	467	-----	410	368	A	A	--	--	--	100
04001	185	JAB512	491	-----	356	413	371	A	--	A	--	--	100
04006	185	JAB512	493	463	-----	413	373	A	A	--	--	--	100
04012	002	JAB512	492	-----	355	409	370	A	--	A	--	--	100
06001	136	JAB514	488	460	-----	408	366	A	A	--	--	--	100
06004	008	JAB512	488	-----	352	408	368	A	--	A	--	--	100
07004	062	JAB512	490	-----	353	405	365	A	--	A	--	--	100
07007	174	JAB512	487	463	-----	406	367	A	A	--	--	--	100
08002	008	JAB512	488	-----	353	405	365	A	--	A	--	--	100
09004	075	JAB517	488	-----	348	411	368	A	--	A	--	--	100
09007	168	JAB512	489	-----	354	405	365	A	--	A	--	--	100
09008	062	JAB512	488	464	-----	406	363	A	A	--	--	--	100
09009	008	JAB512	491	-----	354	409	367	A	--	A	--	--	100
09010	002	JAB512	498	-----	361	411	370	A	--	A	--	--	100
09011	002	JAB512	495	466	-----	409	370	A	A	--	--	--	100
09014	075	JAB517	487	462	-----	412	369	A	A	--	--	--	100
10001	002	JAB512	494	471	-----	412	370	A	A	--	--	--	100
10002	002	JAB512	495	-----	359	408	368	A	--	A	--	--	100
11002	008	JAB512	488	-----	353	405	364	A	--	A	--	--	100
11004	160	JAB512	487	460	-----	405	362	A	A	--	--	--	100
11005	175	JAB512	487	-----	352	404	365	A	--	A	--	--	100
11007	008	JAB512	489	464	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
11021	176	JAB517	484	-----	343	406	366	A	--	A	--	--	100
11025	100	JAB512	489	462	-----	409	363	A	A	--	--	--	100
12003	006	JAB512	489	-----	355	408	365	A	--	A	--	--	100
12006	008	JAB512	487	-----	351	408	364	A	--	A	--	--	100
12010	122	JAB512	489	-----	354	407	365	A	--	A	--	--	100
12011	111	JAB517	491	466	-----	409	370	A	A	--	--	--	100
12012	008	JAB512	489	464	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
12013	087	JAB512	488	462	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
12014	075	JAB517	488	-----	347	408	367	A	--	A	--	--	100
12015	041	JAB512	487	461	-----	407	367	A	A	--	--	--	100
12018	041	JAB512	493	464	-----	407	367	A	A	--	--	--	100
13001	050	JAB512	487	465	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
13004	200	JAB512	494	-----	355	410	366	A	--	A	--	--	100
13005	002	JAB512	497	-----	359	409	372	A	--	A	--	--	100
13006	002	JAB512	496	-----	356	411	370	A	--	A	--	--	100
13007	002	JAB512	496	464	-----	412	368	A	A	--	--	--	100
13008	002	JAB512	493	467	-----	410	368	A	A	--	--	--	100
13010	008	JAB512	489	465	-----	405	365	A	A	--	--	--	100
13013	111	JAB517	490	462	-----	410	370	A	A	--	--	--	100
13014	008	JAB512	487	-----	355	406	367	A	--	A	--	--	100
13015	008	JAB512	489	463	-----	404	364	A	A	--	--	--	100
13016	041	JAB512	490	463	-----	405	361	A	A	--	--	--	100
13021	002	JAB512	493	470	-----	414	371	A	A	--	--	--	100
13022	008	JAB512	489	-----	357	407	367	A	--	A	--	--	100
13024	002	JAB512	498	469	-----	412	371	A	A	--	--	--	100
13033	087	JAB512	488	-----	354	406	364	A	--	A	--	--	100
13035	008	JAB512	487	-----	353	406	364	A	--	A	--	--	100
13036	006	JAB512	489	463	-----	405	365	A	A	--	--	--	100

[16]赤血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	JAB512	497	467	-----	413	369	A	A	--	--	--	100
13039	002	JAB512	493	-----	358	411	372	A	--	A	--	--	100
13045	002	JAB512	494	-----	360	409	369	A	--	A	--	--	100
13049	002	JAB512	494	-----	357	409	371	A	--	A	--	--	100
13051	008	JAB512	489	-----	355	403	365	A	--	A	--	--	100
13052	002	JAB512	495	-----	359	414	371	A	--	A	--	--	100
13055	002	JAB512	497	469	-----	410	369	A	A	--	--	--	100
13056	012	JAB512	488	-----	353	403	367	A	--	A	--	--	100
13063	050	JAB512	487	-----	354	408	366	A	--	A	--	--	100
13067	008	JAB512	490	-----	354	406	365	A	--	A	--	--	100
13071	075	JAB517	489	461	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
13077	008	JAB512	488	462	-----	405	364	A	A	--	--	--	100
13078	006	JAB512	490	-----	354	408	365	A	--	A	--	--	100
13079	041	JAB512	482	-----	356	405	363	A	--	A	--	--	100
13080	008	JAB512	487	464	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
13082	008	JAB512	488	464	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
13083	008	JAB512	487	459	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
13088	154	JAB512	495	472	-----	414	369	A	A	--	--	--	100
13089	002	JAB512	491	-----	358	413	368	A	--	A	--	--	100
13090	008	JAB512	489	464	-----	408	365	A	A	--	--	--	100
13101	002	JAB512	497	-----	357	411	370	A	--	A	--	--	100
13107	008	JAB512	490	464	-----	406	365	A	A	--	--	--	100
13109	008	JAB512	488	-----	354	406	366	A	--	A	--	--	100
13115	041	JAB512	486	463	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
14002	008	JAB512	489	463	-----	407	367	A	A	--	--	--	100
14004	008	JAB512	490	-----	354	409	368	A	--	A	--	--	100
14005	137	JAB512	490	-----	351	402	365	A	--	A	--	--	100
14006	006	JAB512	489	-----	354	407	364	A	--	A	--	--	100
14007	041	JAB512	489	-----	357	405	363	A	--	A	--	--	100
14018	008	JAB512	487	-----	354	404	364	A	--	A	--	--	100
14022	008	JAB512	492	-----	354	408	367	A	--	A	--	--	100
14023	006	JAB512	488	-----	353	408	363	A	--	A	--	--	100
14026	008	JAB512	489	464	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
14029	041	JAB512	487	461	-----	405	368	A	A	--	--	--	100
15007	008	JAB512	491	462	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
15008	002	JAB512	495	-----	361	411	367	A	--	A	--	--	100
15010	002	JAB512	495	468	-----	409	371	A	A	--	--	--	100
16004	171	JAB512	490	-----	353	407	365	A	--	A	--	--	100
16005	006	JAB512	489	463	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
16008	089	JAB514	490	462	-----	407	365	A	A	--	--	--	100
17003	190	JAB512	487	-----	352	405	364	A	--	A	--	--	100
18003	008	JAB512	490	463	-----	404	365	A	A	--	--	--	100
20001	006	JAB512	490	-----	353	408	365	A	--	A	--	--	100
20002	128	JAB512	488	463	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
20003	081	JAB512	488	463	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
20004	081	JAB512	488	463	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
21001	172	JAB512	488	-----	352	405	365	A	--	A	--	--	100
21004	057	JAB512	488	-----	357	409	369	A	--	A	--	--	100
22007	144	JAB512	487	-----	353	406	365	A	--	A	--	--	100
22010	006	JAB512	491	463	-----	408	366	A	A	--	--	--	100
22015	008	JAB512	493	-----	352	410	365	A	--	A	--	--	100
22019	006	JAB512	491	-----	354	405	365	A	--	A	--	--	100
22023	129	JAB512	488	462	-----	405	365	A	A	--	--	--	100
23001	057	JAB512	486	465	-----	409	368	A	A	--	--	--	100
23002	172	JAB512	489	-----	351	406	364	A	--	A	--	--	100
23005	002	JAB512	493	468	-----	412	368	A	A	--	--	--	100

[16]赤血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	JAB512	489	464	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
23007	169	JAB512	490	-----	355	405	363	A	--	A	--	--	100
23009	088	JAB512	489	-----	352	406	364	A	--	A	--	--	100
23012	083	JAB517	487	460	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
23018	008	JAB512	491	-----	356	410	367	A	--	A	--	--	100
23022	006	JAB512	491	463	-----	407	363	A	A	--	--	--	100
23026	088	JAB512	489	-----	352	406	364	A	--	A	--	--	100
23029	172	JAB512	488	-----	353	405	364	A	--	A	--	--	100
23030	088	JAB512	489	464	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
23032	083	JAB517	487	460	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
23037	088	JAB512	489	-----	352	406	364	A	--	A	--	--	100
23038	169	JAB512	490	463	-----	402	364	A	A	--	--	--	100
23039	169	JAB512	488	463	-----	405	365	A	A	--	--	--	100
23040	008	JAB512	489	-----	355	408	368	A	--	A	--	--	100
23042	200	JAB512	497	469	-----	389	348	A	A	--	--	--	100
24001	169	JAB512	489	-----	353	407	363	A	--	A	--	--	100
24002	122	JAB512	489	-----	354	407	365	A	--	A	--	--	100
25001	122	JAB512	489	-----	354	407	365	A	--	A	--	--	100
25002	126	JAB512	488	462	-----	403	362	A	A	--	--	--	100
26002	024	JAB517	489	459	-----	408	368	A	A	--	--	--	100
26005	009	JAR408	486	-----	349	398	355	--	--	--	--	--	100
26012	200	JAB512	492	464	-----	409	367	A	A	--	--	--	100
27002	008	JAB512	488	-----	354	406	363	A	--	A	--	--	100
27003	200	JAB512	490	-----	357	408	367	A	--	A	--	--	100
27005	122	JAB512	489	463	-----	407	365	A	A	--	--	--	100
27006	200	JAB512	495	468	-----	412	369	A	A	--	--	--	100
27007	009	JAR408	486	460	-----	398	361	--	--	--	--	--	100
27009	008	JAB512	488	459	-----	404	363	A	A	--	--	--	100
27010	094	JAB512	488	462	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
27018	060	JAB512	489	463	-----	407	365	A	A	--	--	--	100
27023	090	JAB512	489	463	-----	406	366	A	A	--	--	--	100
27031	090	JAB512	485	-----	354	408	366	A	--	A	--	--	100
27037	200	JAB512	490	464	-----	407	363	A	A	--	--	--	100
27038	008	JAB512	488	461	-----	409	367	A	A	--	--	--	100
27041	029	JAB512	492	465	-----	407	364	A	A	--	--	--	100
27042	102	JAB512	490	466	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
27045	200	JAB512	495	-----	355	410	367	A	--	A	--	--	100
27048	200	JAB512	496	464	-----	409	363	A	A	--	--	--	100
27051	002	JAB512	494	473	-----	411	369	A	A	--	--	--	100
27052	200	JAB512	496	466	-----	407	368	A	A	--	--	--	100
27061	200	JAB512	489	-----	355	406	364	A	--	A	--	--	100
28001	090	JAB512	484	459	-----	403	367	A	A	--	--	--	100
28007	197	JAB512	493	-----	359	410	371	A	--	A	--	--	100
28008	090	JAB512	486	-----	349	408	369	A	--	A	--	--	100
28014	008	JAB512	488	464	-----	411	364	A	A	--	--	--	100
28015	002	JAB512	491	470	-----	412	370	A	A	--	--	--	100
28018	102	JAB512	490	466	-----	404	365	A	A	--	--	--	100
28019	002	JAB512	498	-----	357	412	371	A	--	A	--	--	100
28022	198	JAB512	495	466	-----	410	368	A	A	--	--	--	100
28029	200	JAB512	490	-----	352	406	368	A	--	A	--	--	100
30006	126	JAB512	488	-----	353	406	365	A	--	A	--	--	100
31002	008	JAB512	489	-----	355	405	366	A	--	A	--	--	100
31003	008	JAB512	488	-----	357	408	366	A	--	A	--	--	100
33002	065	JAB517	486	-----	346	405	362	A	--	A	--	--	100
33004	008	JAB512	490	460	-----	410	365	A	A	--	--	--	100
33014	112	JAB519	487	-----	346	405	360	--	--	--	--	--	======

[16]赤血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	JAB512	489	-----	357	405	366	A	--	A	--	--	100
34002	008	JAB512	491	462	-----	405	366	A	A	--	--	--	100
34003	008	JAB512	490	-----	354	407	365	A	--	A	--	--	100
34005	112	JAB512	491	464	-----	408	367	A	A	--	--	--	100
34013	112	JAB512	491	464	-----	408	367	A	A	--	--	--	100
35006	109	JAB512	491	464	-----	410	366	A	A	--	--	--	100
36002	161	JAB512	488	-----	354	407	363	A	--	A	--	--	100
37001	058	JAB512	490	465	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
37004	008	JAB512	488	463	-----	404	364	A	A	--	--	--	100
38006	054	JAJ011	484	460	-----	404	358	--	--	--	--	--	======
38009	006	JAB512	489	-----	355	405	365	A	--	A	--	--	100
40001	193	JAB512	490	464	-----	403	361	A	A	--	--	--	100
40002	193	JAB512	494	-----	350	404	362	A	--	A	--	--	100
40004	165	JAB512	489	-----	356	408	366	A	--	A	--	--	100
40006	165	JAB512	487	-----	357	407	364	A	--	A	--	--	100
40013	109	JAB512	491	-----	358	410	370	A	--	A	--	--	100
40015	008	JAB512	490	462	-----	406	364	A	A	--	--	--	100
40022	165	JAB512	492	466	-----	405	363	A	A	--	--	--	100
40025	109	JAB512	493	-----	357	409	367	A	--	A	--	--	100
40026	165	JAB512	491	469	-----	406	366	A	A	--	--	--	100
40028	200	JAB512	492	-----	353	404	370	A	--	A	--	--	100
40029	069	JAB512	491	465	-----	406	366	A	A	--	--	--	100
40030	109	JAB512	492	-----	356	407	370	A	--	A	--	--	100
40031	151	JAB512	492	-----	358	410	371	A	--	A	--	--	100
40034	193	JAB512	491	-----	351	403	361	A	--	A	--	--	100
40035	165	JAB512	492	463	-----	408	363	A	A	--	--	--	100
41001	073	JAB512	490	468	-----	413	369	A	A	--	--	--	100
41002	008	JAB512	488	-----	354	410	364	A	--	A	--	--	100
42001	165	JAB512	492	-----	356	407	364	A	--	A	--	--	100
42002	008	JAB512	486	-----	351	406	366	A	--	A	--	--	100
43004	146	JAB512	492	465	-----	407	366	A	A	--	--	--	100
43007	095	JAB512	488	464	-----	408	364	A	A	--	--	--	100
44002	193	JAB512	487	465	-----	403	361	A	A	--	--	--	100
46001	193	JAB512	491	464	-----	405	362	A	A	--	--	--	100

[17]白血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	JAB512	28	59	-----	67	58	A	A	--	--	--	100
01007	008	JAB512	28	-----	116	66	58	A	--	A	--	--	100
01019	052	JAB512	28	59	-----	67	58	A	A	--	--	--	100
01027	052	JAB512	28	59	-----	65	57	A	A	--	--	--	100
02001	008	JAB512	30	60	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
02003	110	JAB517	28	-----	111	58	54	A	--	A	--	--	100
03004	002	JAB512	29	60	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
04001	185	JAB512	28	-----	117	70	60	A	--	A	--	--	100
04006	185	JAB512	29	59	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
04012	002	JAB512	29	-----	117	69	60	A	--	A	--	--	100
06001	136	JAB514	29	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
06004	008	JAB512	29	-----	119	69	61	A	--	A	--	--	100
07004	062	JAB512	28	-----	116	68	59	A	--	A	--	--	100
07007	174	JAB512	29	58	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
08002	008	JAB512	30	-----	118	65	58	A	--	A	--	--	100
09004	075	JAB517	28	-----	111	42	50	A	--	A	--	--	100
09007	168	JAB512	28	-----	117	68	61	A	--	A	--	--	100
09008	062	JAB512	29	59	-----	66	61	A	A	--	--	--	100
09009	008	JAB512	30	-----	116	66	57	A	--	A	--	--	100
09010	002	JAB512	29	-----	116	70	61	A	--	A	--	--	100
09011	002	JAB512	30	60	-----	72	63	A	A	--	--	--	100
09014	075	JAB517	28	57	-----	67	60	A	A	--	--	--	100
10001	002	JAB512	29	59	-----	71	61	A	A	--	--	--	100
10002	002	JAB512	30	-----	119	69	62	A	--	A	--	--	100
11002	008	JAB512	29	-----	119	69	58	A	--	A	--	--	100
11004	160	JAB512	28	58	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
11005	175	JAB512	28	-----	115	67	59	A	--	A	--	--	100
11007	008	JAB512	29	60	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
11021	176	JAB517	29	-----	115	72	62	A	--	A	--	--	100
11025	100	JAB512	28	58	-----	68	62	A	A	--	--	--	100
12003	006	JAB512	28	-----	116	69	61	A	--	A	--	--	100
12006	008	JAB512	29	-----	118	65	58	A	--	A	--	--	100
12010	122	JAB512	29	-----	117	68	60	A	--	A	--	--	100
12011	111	JAB517	29	58	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
12012	008	JAB512	29	60	-----	67	59	A	A	--	--	--	100
12013	087	JAB512	29	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
12014	075	JAB517	28	-----	110	69	61	A	--	A	--	--	100
12015	041	JAB512	28	59	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
12018	041	JAB512	28	58	-----	69	62	A	A	--	--	--	100
13001	050	JAB512	29	60	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
13004	200	JAB512	28	-----	117	66	60	A	--	A	--	--	100
13005	002	JAB512	30	-----	117	70	61	A	--	A	--	--	100
13006	002	JAB512	29	-----	117	71	61	A	--	A	--	--	100
13007	002	JAB512	29	60	-----	72	62	A	A	--	--	--	100
13008	002	JAB512	29	60	-----	72	60	A	A	--	--	--	100
13010	008	JAB512	29	60	-----	65	58	A	A	--	--	--	100
13013	111	JAB517	29	58	-----	71	63	A	A	--	--	--	100
13014	008	JAB512	29	-----	119	68	367	A	--	A	--	--	100
13015	008	JAB512	29	60	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
13016	041	JAB512	28	59	-----	69	63	A	A	--	--	--	100
13021	002	JAB512	29	58	-----	70	63	A	A	--	--	--	100
13022	008	JAB512	29	-----	119	69	60	A	--	A	--	--	100
13024	002	JAB512	30	60	-----	71	62	A	A	--	--	--	100
13033	087	JAB512	29	-----	117	69	61	A	--	A	--	--	100
13035	008	JAB512	29	-----	119	68	61	A	--	A	--	--	100
13036	006	JAB512	28	58	-----	69	61	A	A	--	--	--	100

[17]白血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	JAB512	30	60	-----	71	61	A	A	--	--	--	100
13039	002	JAB512	29	-----	118	71	61	A	--	A	--	--	100
13045	002	JAB512	30	-----	119	70	61	A	--	A	--	--	100
13049	002	JAB512	30	-----	118	72	62	A	--	A	--	--	100
13051	008	JAB512	29	-----	119	65	61	A	--	A	--	--	100
13052	002	JAB512	29	-----	117	70	62	A	--	A	--	--	100
13055	002	JAB512	29	60	-----	72	63	A	A	--	--	--	100
13056	012	JAB512	29	-----	115	67	60	A	--	A	--	--	100
13063	050	JAB512	28	-----	117	57	53	A	--	A	--	--	100
13067	008	JAB512	29	-----	120	69	61	A	--	A	--	--	100
13071	075	JAB517	28	57	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
13077	008	JAB512	29	60	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
13078	006	JAB512	28	-----	116	69	62	A	--	A	--	--	100
13079	041	JAB512	28	-----	117	61	60	A	--	A	--	--	100
13080	008	JAB512	29	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
13082	008	JAB512	29	60	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
13083	008	JAB512	30	60	-----	65	57	A	A	--	--	--	100
13088	154	JAB512	28	59	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
13089	002	JAB512	30	-----	118	70	60	A	--	A	--	--	100
13090	008	JAB512	29	60	-----	65	58	A	A	--	--	--	100
13101	002	JAB512	30	-----	120	69	61	A	--	A	--	--	100
13107	008	JAB512	29	61	-----	65	59	A	A	--	--	--	100
13109	008	JAB512	30	-----	117	65	57	A	--	A	--	--	100
13115	041	JAB512	27	59	-----	70	64	A	A	--	--	--	100
14002	008	JAB512	28	59	-----	66	57	A	A	--	--	--	100
14004	008	JAB512	29	-----	120	67	60	A	--	A	--	--	100
14005	137	JAB512	29	-----	115	68	60	A	--	A	--	--	100
14006	006	JAB512	28	-----	116	61	59	A	--	A	--	--	100
14007	041	JAB512	28	-----	117	69	61	A	--	A	--	--	100
14018	008	JAB512	30	-----	118	69	60	A	--	A	--	--	100
14022	008	JAB512	29	-----	119	69	60	A	--	A	--	--	100
14023	006	JAB512	28	-----	116	67	61	A	--	A	--	--	100
14026	008	JAB512	29	60	-----	66	57	A	A	--	--	--	100
14029	041	JAB512	29	58	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
15007	008	JAB512	29	59	-----	65	59	A	A	--	--	--	100
15008	002	JAB512	29	-----	119	71	62	A	--	A	--	--	100
15010	002	JAB512	30	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
16004	171	JAB512	29	-----	117	69	60	A	--	A	--	--	100
16005	006	JAB512	28	58	-----	67	61	A	A	--	--	--	100
16008	089	JAB514	29	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
17003	190	JAB512	28	-----	116	70	62	A	--	A	--	--	100
18003	008	JAB512	29	60	-----	65	57	A	A	--	--	--	100
20001	006	JAB512	29	-----	116	70	62	A	--	A	--	--	100
20002	128	JAB512	28	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
20003	081	JAB512	28	57	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
20004	081	JAB512	28	57	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
21001	172	JAB512	29	-----	114	69	59	A	--	A	--	--	100
21004	057	JAB512	27	-----	118	69	61	A	--	A	--	--	100
22007	144	JAB512	28	-----	116	67	61	A	--	A	--	--	100
22010	006	JAB512	28	59	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
22015	008	JAB512	30	-----	118	68	60	A	--	A	--	--	100
22019	006	JAB512	28	-----	116	54	53	A	--	A	--	--	100
22023	129	JAB512	28	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
23001	057	JAB512	27	58	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
23002	172	JAB512	28	-----	115	69	60	A	--	A	--	--	100
23005	002	JAB512	29	60	-----	72	61	A	A	--	--	--	100

[17]白血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	JAB512	28	59	-----	68	59	A	A	--	--	--	100
23007	169	JAB512	28	-----	113	71	62	A	--	A	--	--	100
23009	088	JAB512	28	-----	116	68	59	A	--	A	--	--	100
23012	083	JAB517	29	58	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
23018	008	JAB512	28	-----	116	69	59	A	--	A	--	--	100
23022	006	JAB512	28	58	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
23026	088	JAB512	28	-----	116	68	59	A	--	A	--	--	100
23029	172	JAB512	28	-----	115	70	60	A	--	A	--	--	100
23030	088	JAB512	28	59	-----	68	59	A	A	--	--	--	100
23032	083	JAB517	29	58	-----	70	62	A	A	--	--	--	100
23037	088	JAB512	28	-----	116	68	59	A	--	A	--	--	100
23038	169	JAB512	28	57	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
23039	169	JAB512	28	58	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
23040	008	JAB512	29	-----	118	69	60	A	--	A	--	--	100
23042	200	JAB512	29	58	-----	38	33	A	A	--	--	--	100
24001	169	JAB512	28	-----	114	52	57	A	--	A	--	--	100
24002	122	JAB512	29	-----	117	68	60	A	--	A	--	--	100
25001	122	JAB512	29	-----	117	68	60	A	--	A	--	--	100
25002	126	JAB512	29	59	-----	67	59	A	A	--	--	--	100
26002	024	JAB517	29	56	-----	65	61	A	A	--	--	--	100
26005	009	JAR408	29	-----	111	69	61	--	--	--	--	--	======
26012	200	JAB512	29	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
27002	008	JAB512	29	-----	117	69	60	A	--	A	--	--	100
27003	200	JAB512	28	-----	113	69	60	A	--	A	--	--	100
27005	122	JAB512	29	60	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
27006	200	JAB512	29	58	-----	64	57	A	A	--	--	--	100
27007	009	JAR408	28	57	-----	69	60	--	--	--	--	--	======
27009	008	JAB512	29	60	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
27010	094	JAB512	28	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
27018	060	JAB512	29	60	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
27023	090	JAB512	27	59	-----	68	59	A	A	--	--	--	100
27031	090	JAB512	29	-----	115	65	61	A	--	A	--	--	100
27037	200	JAB512	29	58	-----	63	58	A	A	--	--	--	100
27038	008	JAB512	28	59	-----	66	57	A	A	--	--	--	100
27041	029	JAB512	29	59	-----	70	59	A	A	--	--	--	100
27042	102	JAB512	29	60	-----	68	62	A	A	--	--	--	100
27045	200	JAB512	28	-----	116	71	59	A	--	A	--	--	100
27048	200	JAB512	29	59	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
27051	002	JAB512	30	60	-----	70	60	A	A	--	--	--	100
27052	200	JAB512	28	58	-----	65	58	A	A	--	--	--	100
27061	200	JAB512	29	-----	116	69	59	A	--	A	--	--	100
28001	090	JAB512	29	56	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
28007	197	JAB512	29	-----	118	70	60	A	--	A	--	--	100
28008	090	JAB512	28	-----	114	67	59	A	--	A	--	--	100
28014	008	JAB512	29	60	-----	65	58	A	A	--	--	--	100
28015	002	JAB512	30	59	-----	71	62	A	A	--	--	--	100
28018	102	JAB512	29	60	-----	68	62	A	A	--	--	--	100
28019	002	JAB512	29	-----	118	70	63	A	--	A	--	--	100
28022	198	JAB512	30	60	-----	72	62	A	A	--	--	--	100
28029	200	JAB512	29	-----	115	70	59	A	--	A	--	--	100
30006	126	JAB512	29	-----	114	68	60	A	--	A	--	--	100
31002	008	JAB512	29	-----	119	69	60	A	--	A	--	--	100
31003	008	JAB512	29	-----	117	69	61	A	--	A	--	--	100
33002	065	JAB517	29	-----	111	69	62	A	--	A	--	--	100
33004	008	JAB512	29	60	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
33014	112	JAB519	25	-----	103	69	59	--	--	--	--	--	======

[17]白血球　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	JAB512	29	-----	118	69	59	A	--	A	--	--	100
34002	008	JAB512	30	59	-----	69	60	A	A	--	--	--	100
34003	008	JAB512	29	-----	118	65	60	A	--	A	--	--	100
34005	112	JAB512	29	59	-----	71	61	A	A	--	--	--	100
34013	112	JAB512	29	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
35006	109	JAB512	28	59	-----	68	59	A	A	--	--	--	100
36002	161	JAB512	29	-----	118	69	61	A	--	A	--	--	100
37001	058	JAB512	29	58	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
37004	008	JAB512	29	59	-----	69	59	A	A	--	--	--	100
38006	054	JAJ011	30	59	-----	70	61	--	--	--	--	--	======
38009	006	JAB512	28	-----	116	68	60	A	--	A	--	--	100
40001	193	JAB512	30	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100
40002	193	JAB512	30	-----	120	69	61	A	--	A	--	--	100
40004	165	JAB512	28	-----	115	64	57	A	--	A	--	--	100
40006	165	JAB512	28	-----	117	68	58	A	--	A	--	--	100
40013	109	JAB512	28	-----	115	67	59	A	--	A	--	--	100
40015	008	JAB512	28	59	-----	67	58	A	A	--	--	--	100
40022	165	JAB512	28	56	-----	70	58	A	A	--	--	--	100
40025	109	JAB512	28	-----	115	67	60	A	--	A	--	--	100
40026	165	JAB512	28	58	-----	67	58	A	A	--	--	--	100
40028	200	JAB512	28	-----	118	69	61	A	--	A	--	--	100
40029	069	JAB512	30	60	-----	68	61	A	A	--	--	--	100
40030	109	JAB512	29	-----	115	68	59	A	--	A	--	--	100
40031	151	JAB512	28	-----	116	68	60	A	--	A	--	--	100
40034	193	JAB512	30	-----	120	68	60	A	--	A	--	--	100
40035	165	JAB512	29	58	-----	68	58	A	A	--	--	--	100
41001	073	JAB512	29	59	-----	65	59	A	A	--	--	--	100
41002	008	JAB512	29	-----	117	65	57	A	--	A	--	--	100
42001	165	JAB512	29	-----	116	67	57	A	--	A	--	--	100
42002	008	JAB512	29	-----	116	66	57	A	--	A	--	--	100
43004	146	JAB512	28	58	-----	70	61	A	A	--	--	--	100
43007	095	JAB512	28	58	-----	68	60	A	A	--	--	--	100
44002	193	JAB512	30	60	-----	67	61	A	A	--	--	--	100
46001	193	JAB512	30	59	-----	69	61	A	A	--	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	JAB512	41.4	38.7	-----	36.0	31.2	A	A	--	--	--	100
01007	008	JAB512	41.3	-----	27.6	36.3	31.1	A	--	A	--	--	100
01019	052	JAB512	41.4	38.5	-----	36.1	31.3	A	A	--	--	--	100
01027	052	JAB512	41.5	38.6	-----	36.1	31.3	A	A	--	--	--	100
02001	008	JAB512	41.5	38.7	-----	36.0	31.3	A	A	--	--	--	100
02003	110	JAB517	41.1	-----	27.0	36.2	30.9	A	--	A	--	--	100
03004	002	JAB512	42.1	39.5	-----	36.8	32.2	A	A	--	--	--	100
04001	185	JAB512	42.3	-----	28.2	36.2	31.3	A	--	A	--	--	100
04006	185	JAB512	42.5	39.2	-----	36.1	31.4	A	A	--	--	--	100
04012	002	JAB512	42.4	-----	28.3	36.3	31.2	A	--	A	--	--	100
06001	136	JAB514	40.8	38.0	-----	36.0	30.6	A	A	--	--	--	100
06004	008	JAB512	41.2	-----	27.3	36.3	31.0	A	--	A	--	--	100
07004	062	JAB512	41.3	-----	27.2	35.8	30.8	A	--	A	--	--	100
07007	174	JAB512	41.2	38.4	-----	36.1	30.9	A	A	--	--	--	100
08002	008	JAB512	41.0	-----	27.3	36.1	30.9	A	--	A	--	--	100
09004	075	JAB517	42.2	-----	27.6	36.5	31.5	A	--	A	--	--	100
09007	168	JAB512	41.6	-----	27.6	35.7	30.7	A	--	A	--	--	100
09008	062	JAB512	41.4	38.9	-----	35.7	31.0	A	A	--	--	--	100
09009	008	JAB512	41.3	-----	27.3	36.0	30.7	A	--	A	--	--	100
09010	002	JAB512	42.7	-----	28.5	37.0	32.0	A	--	A	--	--	100
09011	002	JAB512	42.7	39.3	-----	36.6	31.9	A	A	--	--	--	100
09014	075	JAB517	42.1	39.2	-----	36.6	31.5	A	A	--	--	--	100
10001	002	JAB512	42.5	39.6	-----	37.3	32.2	A	A	--	--	--	100
10002	002	JAB512	42.6	-----	28.4	36.9	32.0	A	--	A	--	--	100
11002	008	JAB512	41.3	-----	27.4	36.0	30.8	A	--	A	--	--	100
11004	160	JAB512	41.1	38.2	-----	35.7	30.3	A	A	--	--	--	100
11005	175	JAB512	40.8	-----	27.1	35.4	30.5	A	--	A	--	--	100
11007	008	JAB512	41.4	38.5	-----	36.0	30.9	A	A	--	--	--	100
11021	176	JAB517	41.1	-----	26.9	36.0	30.7	A	--	A	--	--	100
11025	100	JAB512	42.2	38.9	-----	36.0	30.6	A	A	--	--	--	100
12003	006	JAB512	41.9	-----	27.6	35.8	30.8	A	--	A	--	--	100
12006	008	JAB512	41.4	-----	27.4	36.4	30.9	A	--	A	--	--	100
12010	122	JAB512	41.4	-----	27.5	36.0	31.0	A	--	A	--	--	100
12011	111	JAB517	41.9	39.0	-----	36.6	31.9	A	A	--	--	--	100
12012	008	JAB512	41.3	38.6	-----	36.2	31.1	A	A	--	--	--	100
12013	087	JAB512	41.7	38.7	-----	35.5	30.4	A	A	--	--	--	100
12014	075	JAB517	42.0	-----	27.8	36.5	31.4	A	--	A	--	--	100
12015	041	JAB512	41.4	38.6	-----	35.8	31.0	A	A	--	--	--	100
12018	041	JAB512	41.9	38.9	-----	35.7	30.9	A	A	--	--	--	100
13001	050	JAB512	41.5	38.9	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
13004	200	JAB512	41.6	-----	27.5	36.2	31.2	A	--	A	--	--	100
13005	002	JAB512	42.6	-----	28.4	37.2	32.1	A	--	A	--	--	100
13006	002	JAB512	42.6	-----	28.1	37.2	32.4	A	--	A	--	--	100
13007	002	JAB512	42.6	39.1	-----	37.4	32.1	A	A	--	--	--	100
13008	002	JAB512	42.5	39.5	-----	36.9	32.0	A	A	--	--	--	100
13010	008	JAB512	41.4	38.6	-----	35.8	30.9	A	A	--	--	--	100
13013	111	JAB517	41.9	38.7	-----	36.7	31.6	A	A	--	--	--	100
13014	008	JAB512	40.8	-----	27.2	36.2	31.0	A	--	A	--	--	100
13015	008	JAB512	41.0	38.2	-----	36.0	30.6	A	A	--	--	--	100
13016	041	JAB512	42.1	39.1	-----	35.1	30.2	A	A	--	--	--	100
13021	002	JAB512	42.1	39.5	-----	37.8	32.5	A	A	--	--	--	100
13022	008	JAB512	41.3	-----	27.7	36.0	30.8	A	--	A	--	--	100
13024	002	JAB512	42.7	39.5	-----	37.6	32.3	A	A	--	--	--	100
13033	087	JAB512	41.7	-----	27.9	35.5	30.4	A	--	A	--	--	100
13035	008	JAB512	41.3	-----	27.6	36.1	31.0	A	--	A	--	--	100
13036	006	JAB512	41.9	38.7	-----	35.7	30.9	A	A	--	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	JAB512	42.6	39.2	-----	37.7	32.2	A	A	--	--	--	100
13039	002	JAB512	42.4	-----	28.3	37.2	32.3	A	--	A	--	--	100
13045	002	JAB512	42.6	-----	28.4	37.7	32.6	A	--	A	--	--	100
13049	002	JAB512	42.4	-----	28.1	37.6	32.1	A	--	A	--	--	100
13051	008	JAB512	41.2	-----	27.6	36.0	30.9	A	--	A	--	--	100
13052	002	JAB512	42.4	-----	28.2	38.2	32.5	A	--	A	--	--	100
13055	002	JAB512	42.6	39.5	-----	37.9	32.6	A	A	--	--	--	100
13056	012	JAB512	42.5	-----	28.2	35.8	30.9	A	--	A	--	--	100
13063	050	JAB512	41.5	-----	27.8	36.0	30.5	A	--	A	--	--	100
13067	008	JAB512	41.6	-----	27.6	36.3	31.2	A	--	A	--	--	100
13071	075	JAB517	42.1	39.0	-----	36.7	31.3	A	A	--	--	--	100
13077	008	JAB512	41.2	38.4	-----	35.8	31.1	A	A	--	--	--	100
13078	006	JAB512	41.7	-----	27.7	35.7	30.6	A	--	A	--	--	100
13079	041	JAB512	41.1	-----	27.9	35.2	30.5	A	--	A	--	--	100
13080	008	JAB512	40.9	38.2	-----	36.0	31.0	A	A	--	--	--	100
13082	008	JAB512	40.9	38.1	-----	36.4	31.0	A	A	--	--	--	100
13083	008	JAB512	41.3	38.8	-----	36.3	31.0	A	A	--	--	--	100
13088	154	JAB512	42.3	39.7	-----	36.6	31.1	A	A	--	--	--	100
13089	002	JAB512	42.1	-----	28.2	37.7	32.2	A	--	A	--	--	100
13090	008	JAB512	40.9	38.2	-----	35.9	31.1	A	A	--	--	--	100
13101	002	JAB512	42.6	-----	28.2	38.0	32.4	A	--	A	--	--	100
13107	008	JAB512	41.5	38.7	-----	36.3	31.2	A	A	--	--	--	100
13109	008	JAB512	41.0	-----	27.3	36.1	31.0	A	--	A	--	--	100
13115	041	JAB512	41.3	38.8	-----	35.8	30.7	A	A	--	--	--	100
14002	008	JAB512	41.3	38.5	-----	36.2	31.0	A	A	--	--	--	100
14004	008	JAB512	40.9	-----	27.2	36.1	30.9	A	--	A	--	--	100
14005	137	JAB512	41.5	-----	27.5	35.7	30.6	A	--	A	--	--	100
14006	006	JAB512	41.9	-----	27.7	35.5	30.4	A	--	A	--	--	100
14007	041	JAB512	41.7	-----	28.0	35.5	30.4	A	--	A	--	--	100
14018	008	JAB512	40.7	-----	27.2	35.9	30.9	A	--	A	--	--	100
14022	008	JAB512	41.3	-----	27.2	35.9	30.7	A	--	A	--	--	100
14023	006	JAB512	41.6	-----	27.6	35.9	30.7	A	--	A	--	--	100
14026	008	JAB512	40.9	38.2	-----	36.0	30.9	A	A	--	--	--	100
14029	041	JAB512	41.5	38.5	-----	35.5	30.9	A	A	--	--	--	100
15007	008	JAB512	41.6	38.3	-----	35.8	30.8	A	A	--	--	--	100
15008	002	JAB512	42.3	-----	28.4	37.5	32.2	A	--	A	--	--	100
15010	002	JAB512	42.5	39.3	-----	37.0	32.4	A	A	--	--	--	100
16004	171	JAB512	41.3	-----	27.4	36.0	31.1	A	--	A	--	--	100
16005	006	JAB512	41.8	38.9	-----	35.8	30.5	A	A	--	--	--	100
16008	089	JAB514	41.3	38.5	-----	35.9	31.0	A	A	--	--	--	100
17003	190	JAB512	42.2	-----	28.2	35.8	30.8	A	--	A	--	--	100
18003	008	JAB512	41.3	38.3	-----	35.7	30.7	A	A	--	--	--	100
20001	006	JAB512	41.7	-----	27.6	35.8	30.5	A	--	A	--	--	100
20002	128	JAB512	41.6	38.5	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
20003	081	JAB512	41.7	38.9	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
20004	081	JAB512	41.7	38.9	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
21001	172	JAB512	41.6	-----	27.5	35.7	30.7	A	--	A	--	--	100
21004	057	JAB512	41.6	-----	28.5	36.3	31.3	A	--	A	--	--	100
22007	144	JAB512	41.9	-----	28.0	35.9	30.9	A	--	A	--	--	100
22010	006	JAB512	41.6	38.6	-----	36.1	30.9	A	A	--	--	--	100
22015	008	JAB512	41.3	-----	27.1	36.0	30.7	A	--	A	--	--	100
22019	006	JAB512	41.8	-----	27.6	35.7	30.7	A	--	A	--	--	100
22023	129	JAB512	41.4	38.5	-----	35.6	30.6	A	A	--	--	--	100
23001	057	JAB512	41.9	38.7	-----	36.2	31.0	A	A	--	--	--	100
23002	172	JAB512	41.7	-----	27.6	35.6	30.6	A	--	A	--	--	100
23005	002	JAB512	42.5	39.4	-----	37.9	32.4	A	A	--	--	--	100

[18]ヘマトクリット　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	JAB512	41.5	38.4	-----	36.7	31.6	A	A	--	--	--	100
23007	169	JAB512	41.5	-----	27.7	35.5	30.7	A	--	A	--	--	100
23009	088	JAB512	41.5	-----	27.5	36.7	31.6	A	--	A	--	--	100
23012	083	JAB517	42.3	38.6	-----	37.0	31.8	A	A	--	--	--	100
23018	008	JAB512	41.5	-----	27.7	36.0	31.0	A	--	A	--	--	100
23022	006	JAB512	41.6	38.7	-----	35.7	30.5	A	A	--	--	--	100
23026	088	JAB512	41.5	-----	27.5	36.7	31.6	A	--	A	--	--	100
23029	172	JAB512	41.5	-----	27.6	35.5	30.7	A	--	A	--	--	100
23030	088	JAB512	41.5	38.4	-----	36.7	31.6	A	A	--	--	--	100
23032	083	JAB517	42.3	38.6	-----	37.0	31.8	A	A	--	--	--	100
23037	088	JAB512	41.5	-----	27.5	36.7	31.6	A	--	A	--	--	100
23038	169	JAB512	41.7	38.7	-----	35.5	30.6	A	A	--	--	--	100
23039	169	JAB512	41.7	38.8	-----	35.8	30.6	A	A	--	--	--	100
23040	008	JAB512	41.0	-----	27.3	36.0	31.3	A	--	A	--	--	100
23042	200	JAB512	41.9	39.6	-----	36.6	30.0	A	A	--	--	--	100
24001	169	JAB512	41.6	-----	27.6	35.8	30.8	A	--	A	--	--	100
24002	122	JAB512	41.4	-----	27.5	36.0	31.0	A	--	A	--	--	100
25001	122	JAB512	41.4	-----	27.5	36.0	31.0	A	--	A	--	--	100
25002	126	JAB512	41.6	39.0	-----	35.5	31.0	A	A	--	--	--	100
26002	024	JAB517	41.1	37.9	-----	36.5	31.8	A	A	--	--	--	100
26005	009	JAR408	40.2	-----	26.3	36.7	31.2	--	--	--	--	--	======
26012	200	JAB512	41.5	38.4	-----	35.9	30.8	A	A	--	--	--	100
27002	008	JAB512	41.2	-----	27.5	35.7	30.6	A	--	A	--	--	100
27003	200	JAB512	41.3	-----	27.5	36.5	31.3	A	--	A	--	--	100
27005	122	JAB512	41.4	38.5	-----	36.0	31.0	A	A	--	--	--	100
27006	200	JAB512	41.7	38.7	-----	36.3	31.3	A	A	--	--	--	100
27007	009	JAR408	40.2	37.2	-----	36.7	31.8	--	--	--	--	--	======
27009	008	JAB512	41.4	38.2	-----	36.2	30.9	A	A	--	--	--	100
27010	094	JAB512	41.6	38.5	-----	35.6	30.2	A	A	--	--	--	100
27018	060	JAB512	41.4	38.5	-----	36.0	31.0	A	A	--	--	--	100
27023	090	JAB512	42.6	39.5	-----	35.8	31.1	A	A	--	--	--	100
27031	090	JAB512	42.6	-----	28.7	35.7	31.2	A	--	A	--	--	100
27037	200	JAB512	41.2	38.4	-----	36.0	30.8	A	A	--	--	--	100
27038	008	JAB512	41.3	38.4	-----	36.4	31.3	A	A	--	--	--	100
27041	029	JAB512	42.0	39.0	-----	36.5	31.6	A	A	--	--	--	100
27042	102	JAB512	41.2	38.5	-----	34.9	30.2	A	A	--	--	--	100
27045	200	JAB512	41.7	-----	27.6	36.2	31.1	A	--	A	--	--	100
27048	200	JAB512	41.9	38.5	-----	36.2	31.0	A	A	--	--	--	100
27051	002	JAB512	42.4	39.8	-----	37.5	32.3	A	A	--	--	--	100
27052	200	JAB512	41.8	38.6	-----	36.1	31.1	A	A	--	--	--	100
27061	200	JAB512	41.2	-----	27.4	36.5	31.0	A	--	A	--	--	100
28001	090	JAB512	42.2	39.3	-----	36.1	31.4	A	A	--	--	--	100
28007	197	JAB512	42.0	-----	28.1	35.7	31.2	A	--	A	--	--	100
28008	090	JAB512	42.7	-----	28.1	36.3	31.2	A	--	A	--	--	100
28014	008	JAB512	41.4	38.5	-----	36.1	31.0	A	A	--	--	--	100
28015	002	JAB512	42.1	39.5	-----	38.3	32.7	A	A	--	--	--	100
28018	102	JAB512	41.2	38.5	-----	34.8	30.1	A	A	--	--	--	100
28019	002	JAB512	42.6	-----	28.0	38.1	32.6	A	--	A	--	--	100
28022	198	JAB512	42.7	39.3	-----	36.9	32.0	A	A	--	--	--	100
28029	200	JAB512	41.3	-----	27.2	36.1	31.1	A	--	A	--	--	100
30006	126	JAB512	42.0	-----	27.9	35.5	31.0	A	--	A	--	--	100
31002	008	JAB512	41.2	-----	27.5	35.9	30.7	A	--	A	--	--	100
31003	008	JAB512	41.0	-----	27.5	35.8	30.7	A	--	A	--	--	100
33002	065	JAB517	41.8	-----	27.7	36.6	31.6	A	--	A	--	--	100
33004	008	JAB512	41.3	37.9	-----	36.1	30.9	A	A	--	--	--	100
33014	112	JAB519	42.2	-----	27.6	36.8	31.3	--	--	--	--	--	======

[18]ヘマトクリット　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	JAB512	41.1	-----	27.5	35.9	30.7	A	--	A	--	--	100
34002	008	JAB512	41.3	38.1	-----	35.5	30.7	A	A	--	--	--	100
34003	008	JAB512	41.2	-----	27.2	35.7	30.8	A	--	A	--	--	100
34005	112	JAB512	41.5	38.4	-----	35.6	30.5	A	A	--	--	--	100
34013	112	JAB512	41.5	38.4	-----	35.6	30.5	A	A	--	--	--	100
35006	109	JAB512	42.2	39.1	-----	36.2	31.2	A	A	--	--	--	100
36002	161	JAB512	41.7	-----	27.9	35.6	30.8	A	--	A	--	--	100
37001	058	JAB512	40.7	38.0	-----	35.8	30.6	A	A	--	--	--	100
37004	008	JAB512	40.8	38.0	-----	35.6	30.4	A	A	--	--	--	100
38006	054	JAJ011	41.7	38.8	-----	35.8	29.1	--	--	--	--	--	======
38009	006	JAB512	41.6	-----	27.6	35.7	30.5	A	--	A	--	--	100
40001	193	JAB512	41.7	38.8	-----	35.9	30.5	A	A	--	--	--	100
40002	193	JAB512	41.7	-----	27.5	35.9	30.8	A	--	A	--	--	100
40004	165	JAB512	41.6	-----	27.7	34.9	30.2	A	--	A	--	--	100
40006	165	JAB512	41.5	-----	27.9	35.3	30.2	A	--	A	--	--	100
40013	109	JAB512	42.0	-----	28.1	36.3	31.3	A	--	A	--	--	100
40015	008	JAB512	41.1	38.2	-----	35.8	30.4	A	A	--	--	--	100
40022	165	JAB512	42.1	39.1	-----	35.3	30.3	A	A	--	--	--	100
40025	109	JAB512	42.0	-----	28.0	36.2	31.0	A	--	A	--	--	100
40026	165	JAB512	41.9	39.2	-----	35.2	30.4	A	A	--	--	--	100
40028	200	JAB512	42.0	-----	27.7	35.9	31.1	A	--	A	--	--	100
40029	069	JAB512	41.7	38.8	-----	35.5	30.6	A	A	--	--	--	100
40030	109	JAB512	42.1	-----	28.1	36.1	31.4	A	--	A	--	--	100
40031	151	JAB512	42.1	-----	28.3	35.6	30.9	A	--	A	--	--	100
40034	193	JAB512	41.7	-----	27.6	35.5	30.4	A	--	A	--	--	100
40035	165	JAB512	42.0	38.8	-----	35.2	30.3	A	A	--	--	--	100
41001	073	JAB512	41.7	39.0	-----	35.9	30.9	A	A	--	--	--	100
41002	008	JAB512	41.0	-----	27.1	36.0	30.4	A	--	A	--	--	100
42001	165	JAB512	42.1	-----	28.0	35.4	30.1	A	--	A	--	--	100
42002	008	JAB512	40.9	-----	27.2	35.6	30.9	A	--	A	--	--	100
43004	146	JAB512	41.9	38.9	-----	35.7	30.8	A	A	--	--	--	100
43007	095	JAB512	41.8	39.1	-----	35.9	30.7	A	A	--	--	--	100
44002	193	JAB512	41.6	38.8	-----	35.5	30.6	A	A	--	--	--	100
46001	193	JAB512	41.7	38.8	-----	35.5	30.4	A	A	--	--	--	100

[19]血小板　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	JAB512	34.2	26.6	-----	28.2	28.0	A	A	--	--	--	100
01007	008	JAB512	34.2	-----	51.8	28.8	28.6	A	--	A	--	--	100
01019	052	JAB512	34.5	26.6	-----	27.5	28.0	A	A	--	--	--	100
01027	052	JAB512	34.4	26.2	-----	27.8	28.0	A	A	--	--	--	100
02001	008	JAB512	35.0	26.8	-----	28.3	28.1	A	A	--	--	--	100
02003	110	JAB517	34.4	-----	48.7	25.8	24.5	A	--	A	--	--	100
03004	002	JAB512	36.3	27.3	-----	29.9	29.0	A	A	--	--	--	100
04001	185	JAB512	36.1	-----	53.5	29.2	29.1	A	--	A	--	--	100
04006	185	JAB512	35.6	27.3	-----	29.3	28.9	A	A	--	--	--	100
04012	002	JAB512	36.0	-----	53.5	30.0	29.2	A	--	A	--	--	100
06001	136	JAB514	36.0	27.5	-----	27.5	28.1	A	A	--	--	--	100
06004	008	JAB512	35.4	-----	52.7	29.2	28.1	A	--	A	--	--	100
07004	062	JAB512	34.5	-----	53.2	28.1	27.2	A	--	A	--	--	100
07007	174	JAB512	36.0	27.8	-----	28.1	27.0	A	A	--	--	--	100
08002	008	JAB512	35.0	-----	52.9	29.0	27.2	A	--	A	--	--	100
09004	075	JAB517	35.2	-----	48.1	25.6	25.4	A	--	A	--	--	100
09007	168	JAB512	34.9	-----	52.6	28.3	27.5	A	--	A	--	--	100
09008	062	JAB512	34.3	27.0	-----	28.0	27.0	A	A	--	--	--	100
09009	008	JAB512	35.4	-----	53.0	28.0	27.5	A	--	A	--	--	100
09010	002	JAB512	36.9	-----	54.8	30.2	29.0	A	--	A	--	--	100
09011	002	JAB512	36.2	27.5	-----	30.4	29.2	A	A	--	--	--	100
09014	075	JAB517	35.8	26.9	-----	27.0	25.8	A	A	--	--	--	100
10001	002	JAB512	36.6	27.8	-----	31.1	30.0	A	A	--	--	--	100
10002	002	JAB512	36.2	-----	54.4	30.9	29.7	A	--	A	--	--	100
11002	008	JAB512	35.0	-----	52.9	29.3	28.3	A	--	A	--	--	100
11004	160	JAB512	35.3	26.8	-----	28.9	27.6	A	A	--	--	--	100
11005	175	JAB512	35.7	-----	53.3	29.4	27.4	A	--	A	--	--	100
11007	008	JAB512	35.6	26.5	-----	28.8	28.4	A	A	--	--	--	100
11021	176	JAB517	35.6	-----	49.2	28.5	26.6	A	--	A	--	--	100
11025	100	JAB512	34.5	27.5	-----	28.3	27.7	A	A	--	--	--	100
12003	006	JAB512	35.5	-----	52.9	28.7	27.7	A	--	A	--	--	100
12006	008	JAB512	35.5	-----	52.7	29.2	28.0	A	--	A	--	--	100
12010	122	JAB512	35.6	-----	52.8	28.2	28.3	A	--	A	--	--	100
12011	111	JAB517	37.4	28.0	-----	27.9	26.7	A	A	--	--	--	100
12012	008	JAB512	34.6	26.7	-----	29.0	28.3	A	A	--	--	--	100
12013	087	JAB512	35.0	27.1	-----	28.2	28.0	A	A	--	--	--	100
12014	075	JAB517	35.5	-----	48.5	27.2	25.3	A	--	A	--	--	100
12015	041	JAB512	35.8	26.6	-----	28.0	27.9	A	A	--	--	--	100
12018	041	JAB512	35.0	26.5	-----	28.2	27.8	A	A	--	--	--	100
13001	050	JAB512	35.0	26.5	-----	28.1	27.5	A	A	--	--	--	100
13004	200	JAB512	35.9	-----	53.7	27.2	28.2	A	--	A	--	--	100
13005	002	JAB512	37.1	-----	53.9	31.1	28.7	A	--	A	--	--	100
13006	002	JAB512	36.7	-----	54.0	30.2	29.5	A	--	A	--	--	100
13007	002	JAB512	37.4	27.9	-----	30.8	29.5	A	A	--	--	--	100
13008	002	JAB512	36.6	27.3	-----	30.0	28.8	A	A	--	--	--	100
13010	008	JAB512	35.2	26.7	-----	29.2	28.3	A	A	--	--	--	100
13013	111	JAB517	37.9	27.9	-----	27.5	26.9	A	A	--	--	--	100
13014	008	JAB512	36.2	-----	52.8	29.4	28.4	A	--	A	--	--	100
13015	008	JAB512	35.2	27.1	-----	28.9	28.4	A	A	--	--	--	100
13016	041	JAB512	34.6	26.6	-----	27.9	26.9	A	A	--	--	--	100
13021	002	JAB512	37.0	28.3	-----	30.6	30.0	A	A	--	--	--	100
13022	008	JAB512	35.5	-----	52.8	29.0	28.2	A	--	A	--	--	100
13024	002	JAB512	36.5	27.3	-----	29.7	29.8	A	A	--	--	--	100
13033	087	JAB512	35.0	-----	52.4	28.2	28.0	A	--	A	--	--	100
13035	008	JAB512	35.1	-----	52.1	29.3	28.2	A	--	A	--	--	100
13036	006	JAB512	34.8	27.0	-----	28.6	27.8	A	A	--	--	--	100

[19]血小板　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	JAB512	36.2	27.7	-----	30.3	28.5	A	A	--	--	--	100
13039	002	JAB512	37.0	-----	54.5	30.6	29.0	A	--	A	--	--	100
13045	002	JAB512	36.6	-----	54.1	30.5	29.3	A	--	A	--	--	100
13049	002	JAB512	36.0	-----	54.0	29.9	28.8	A	--	A	--	--	100
13051	008	JAB512	34.7	-----	52.8	29.4	28.5	A	--	A	--	--	100
13052	002	JAB512	36.5	-----	54.2	30.7	29.4	A	--	A	--	--	100
13055	002	JAB512	36.9	28.3	-----	30.6	30.0	A	A	--	--	--	100
13056	012	JAB512	35.6	-----	52.1	28.3	27.8	A	--	A	--	--	100
13063	050	JAB512	35.5	-----	51.8	28.2	25.6	A	--	A	--	--	100
13067	008	JAB512	35.1	-----	52.7	28.9	27.8	A	--	A	--	--	100
13071	075	JAB517	35.7	26.9	-----	26.8	25.3	A	A	--	--	--	100
13077	008	JAB512	34.5	26.5	-----	29.2	27.5	A	A	--	--	--	100
13078	006	JAB512	34.8	-----	52.8	28.2	27.5	A	--	A	--	--	100
13079	041	JAB512	35.4	-----	52.5	27.0	27.0	A	--	A	--	--	100
13080	008	JAB512	35.1	27.1	-----	28.1	28.1	A	A	--	--	--	100
13082	008	JAB512	35.7	26.9	-----	28.6	28.6	A	A	--	--	--	100
13083	008	JAB512	35.1	26.7	-----	28.0	27.6	A	A	--	--	--	100
13088	154	JAB512	34.6	26.6	-----	27.2	27.1	A	A	--	--	--	100
13089	002	JAB512	37.5	-----	55.0	30.5	29.6	A	--	A	--	--	100
13090	008	JAB512	35.4	27.2	-----	28.0	27.2	A	A	--	--	--	100
13101	002	JAB512	36.3	-----	55.0	30.5	29.0	A	--	A	--	--	100
13107	008	JAB512	34.5	26.4	-----	29.1	27.6	A	A	--	--	--	100
13109	008	JAB512	35.5	-----	52.8	28.3	27.3	A	--	A	--	--	100
13115	041	JAB512	35.2	26.4	-----	28.9	26.7	A	A	--	--	--	100
14002	008	JAB512	35.0	27.0	-----	28.0	27.6	A	A	--	--	--	100
14004	008	JAB512	35.4	-----	52.9	28.7	27.6	A	--	A	--	--	100
14005	137	JAB512	35.3	-----	52.4	28.2	28.0	A	--	A	--	--	100
14006	006	JAB512	35.3	-----	52.8	28.5	27.4	A	--	A	--	--	100
14007	041	JAB512	35.8	-----	52.5	28.6	27.9	A	--	A	--	--	100
14018	008	JAB512	35.4	-----	53.3	28.7	28.0	A	--	A	--	--	100
14022	008	JAB512	36.1	-----	52.8	28.5	28.5	A	--	A	--	--	100
14023	006	JAB512	35.1	-----	52.6	28.6	27.4	A	--	A	--	--	100
14026	008	JAB512	35.5	26.5	-----	28.4	28.0	A	A	--	--	--	100
14029	041	JAB512	35.2	26.8	-----	28.3	27.7	A	A	--	--	--	100
15007	008	JAB512	35.0	26.7	-----	29.3	28.1	A	A	--	--	--	100
15008	002	JAB512	36.4	-----	54.1	30.5	29.3	A	--	A	--	--	100
15010	002	JAB512	37.0	27.6	-----	30.1	29.6	A	A	--	--	--	100
16004	171	JAB512	35.6	-----	52.8	28.2	27.3	A	--	A	--	--	100
16005	006	JAB512	34.9	27.1	-----	28.6	27.9	A	A	--	--	--	100
16008	089	JAB514	35.3	27.3	-----	28.2	27.3	A	A	--	--	--	100
17003	190	JAB512	35.0	-----	52.8	28.5	27.7	A	--	A	--	--	100
18003	008	JAB512	35.8	26.9	-----	28.4	27.2	A	A	--	--	--	100
20001	006	JAB512	34.8	-----	52.6	28.2	27.4	A	--	A	--	--	100
20002	128	JAB512	35.2	26.7	-----	28.3	28.0	A	A	--	--	--	100
20003	081	JAB512	34.9	26.8	-----	28.3	27.4	A	A	--	--	--	100
20004	081	JAB512	34.9	26.8	-----	28.3	27.4	A	A	--	--	--	100
21001	172	JAB512	35.4	-----	52.3	28.4	28.1	A	--	A	--	--	100
21004	057	JAB512	35.0	-----	52.6	28.6	27.7	A	--	A	--	--	100
22007	144	JAB512	35.2	-----	53.0	28.4	27.6	A	--	A	--	--	100
22010	006	JAB512	35.3	27.2	-----	29.1	27.5	A	A	--	--	--	100
22015	008	JAB512	35.2	-----	52.7	28.9	28.2	A	--	A	--	--	100
22019	006	JAB512	35.1	-----	53.6	28.4	27.0	A	--	A	--	--	100
22023	129	JAB512	35.3	26.8	-----	28.4	28.1	A	A	--	--	--	100
23001	057	JAB512	35.4	27.0	-----	28.3	27.2	A	A	--	--	--	100
23002	172	JAB512	35.3	-----	52.3	28.5	28.2	A	--	A	--	--	100
23005	002	JAB512	36.7	27.5	-----	29.9	28.4	A	A	--	--	--	100

[19]血小板　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	JAB512	34.9	26.7	-----	28.3	27.1	A	A	--	--	--	100
23007	169	JAB512	35.0	-----	51.6	27.8	27.8	A	--	A	--	--	100
23009	088	JAB512	34.9	-----	52.0	28.3	27.1	A	--	A	--	--	100
23012	083	JAB517	36.5	26.7	-----	27.5	26.5	A	A	--	--	--	100
23018	008	JAB512	35.6	-----	53.2	28.6	27.3	A	--	A	--	--	100
23022	006	JAB512	34.9	26.7	-----	28.9	27.2	A	A	--	--	--	100
23026	088	JAB512	34.9	-----	52.0	28.3	27.1	A	--	A	--	--	100
23029	172	JAB512	35.4	-----	52.2	28.3	28.0	A	--	A	--	--	100
23030	088	JAB512	34.9	26.7	-----	28.3	27.1	A	A	--	--	--	100
23032	083	JAB517	36.5	26.7	-----	27.5	26.5	A	A	--	--	--	100
23037	088	JAB512	34.9	-----	52.0	28.3	27.1	A	--	A	--	--	100
23038	169	JAB512	34.6	26.5	-----	28.7	27.6	A	A	--	--	--	100
23039	169	JAB512	34.4	27.1	-----	28.6	27.6	A	A	--	--	--	100
23040	008	JAB512	35.9	-----	53.0	29.4	28.2	A	--	A	--	--	100
23042	200	JAB512	36.2	28.1	-----	23.3	25.1	A	A	--	--	--	100
24001	169	JAB512	35.9	-----	51.9	27.3	28.0	A	--	A	--	--	100
24002	122	JAB512	35.6	-----	52.8	28.2	28.3	A	--	A	--	--	100
25001	122	JAB512	35.6	-----	52.8	28.2	28.3	A	--	A	--	--	100
25002	126	JAB512	35.8	26.7	-----	28.8	28.7	A	A	--	--	--	100
26002	024	JAB517	37.0	27.6	-----	28.1	26.7	A	A	--	--	--	100
26005	009	JAR408	34.9	-----	52.6	27.9	27.5	--	--	--	--	--	======
26012	200	JAB512	36.4	27.7	-----	29.1	28.4	A	A	--	--	--	100
27002	008	JAB512	35.0	-----	53.2	29.1	28.6	A	--	A	--	--	100
27003	200	JAB512	36.6	-----	54.8	28.8	28.5	A	--	A	--	--	100
27005	122	JAB512	35.6	27.2	-----	28.2	28.3	A	A	--	--	--	100
27006	200	JAB512	36.3	27.8	-----	27.5	28.0	A	A	--	--	--	100
27007	009	JAR408	35.0	26.6	-----	28.1	27.6	--	--	--	--	--	======
27009	008	JAB512	35.5	27.1	-----	28.9	28.5	A	A	--	--	--	100
27010	094	JAB512	35.3	26.8	-----	28.9	28.4	A	A	--	--	--	100
27018	060	JAB512	35.6	27.2	-----	28.2	28.3	A	A	--	--	--	100
27023	090	JAB512	25.5	26.2	-----	27.5	27.2	D	A	--	--	--	100
27031	090	JAB512	35.5	-----	51.2	27.0	26.4	A	--	A	--	--	100
27037	200	JAB512	36.0	27.3	-----	28.1	28.0	A	A	--	--	--	100
27038	008	JAB512	34.9	26.8	-----	28.0	27.2	A	A	--	--	--	100
27041	029	JAB512	35.3	26.6	-----	28.2	27.5	A	A	--	--	--	100
27042	102	JAB512	34.7	26.3	-----	28.0	27.0	A	A	--	--	--	100
27045	200	JAB512	36.2	-----	55.0	28.5	28.2	A	--	A	--	--	100
27048	200	JAB512	36.0	28.2	-----	27.3	27.7	A	A	--	--	--	100
27051	002	JAB512	37.1	28.2	-----	30.2	29.8	A	A	--	--	--	100
27052	200	JAB512	36.4	27.7	-----	28.0	27.5	A	A	--	--	--	100
27061	200	JAB512	36.1	-----	54.8	29.3	27.9	A	--	A	--	--	100
28001	090	JAB512	33.8	25.5	-----	27.5	25.7	A	A	--	--	--	100
28007	197	JAB512	36.6	-----	53.6	29.4	28.1	A	--	A	--	--	100
28008	090	JAB512	33.9	-----	51.9	27.8	26.1	A	--	A	--	--	100
28014	008	JAB512	35.4	27.3	-----	28.1	28.5	A	A	--	--	--	100
28015	002	JAB512	36.0	27.5	-----	30.0	29.5	A	A	--	--	--	100
28018	102	JAB512	34.7	26.2	-----	27.9	27.1	A	A	--	--	--	100
28019	002	JAB512	36.0	-----	54.4	29.9	29.2	A	--	A	--	--	100
28022	198	JAB512	36.2	27.5	-----	30.0	28.8	A	A	--	--	--	100
28029	200	JAB512	35.6	-----	53.4	29.4	28.4	A	--	A	--	--	100
30006	126	JAB512	35.6	-----	52.1	28.5	28.0	A	--	A	--	--	100
31002	008	JAB512	34.5	-----	52.5	29.4	28.2	A	--	A	--	--	100
31003	008	JAB512	35.8	-----	52.7	28.3	28.2	A	--	A	--	--	100
33002	065	JAB517	37.5	-----	50.8	27.8	26.4	A	--	A	--	--	100
33004	008	JAB512	35.1	26.8	-----	28.3	27.6	A	A	--	--	--	100
33014	112	JAB519	37.7	-----	52.5	27.4	26.3	--	--	--	--	--	======

[19]血小板　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	JAB512	35.3	-----	53.8	29.3	28.8	A	--	A	--	--	100
34002	008	JAB512	35.4	26.5	-----	28.8	28.3	A	A	--	--	--	100
34003	008	JAB512	35.1	-----	52.7	28.7	28.1	A	--	A	--	--	100
34005	112	JAB512	35.3	26.5	-----	29.6	28.5	A	A	--	--	--	100
34013	112	JAB512	35.3	26.5	-----	29.6	28.5	A	A	--	--	--	100
35006	109	JAB512	36.2	27.4	-----	28.7	28.3	A	A	--	--	--	100
36002	161	JAB512	35.0	-----	52.0	28.3	28.0	A	--	A	--	--	100
37001	058	JAB512	34.7	26.4	-----	27.1	27.5	A	A	--	--	--	100
37004	008	JAB512	35.0	26.6	-----	29.3	27.6	A	A	--	--	--	100
38006	054	JAJ011	30.5	22.8	-----	24.8	24.6	--	--	--	--	--	======
38009	006	JAB512	34.8	-----	52.8	28.4	27.3	A	--	A	--	--	100
40001	193	JAB512	36.2	27.6	-----	28.8	28.1	A	A	--	--	--	100
40002	193	JAB512	36.2	-----	53.9	28.8	28.1	A	--	A	--	--	100
40004	165	JAB512	36.1	-----	54.9	29.0	28.5	A	--	A	--	--	100
40006	165	JAB512	34.6	-----	53.6	29.2	28.7	A	--	A	--	--	100
40013	109	JAB512	35.7	-----	54.2	29.0	28.5	A	--	A	--	--	100
40015	008	JAB512	34.9	26.9	-----	28.5	27.2	A	A	--	--	--	100
40022	165	JAB512	34.7	27.7	-----	29.7	28.1	A	A	--	--	--	100
40025	109	JAB512	36.3	-----	53.9	29.5	28.5	A	--	A	--	--	100
40026	165	JAB512	35.6	27.1	-----	29.0	27.7	A	A	--	--	--	100
40028	200	JAB512	36.5	-----	55.1	29.5	28.8	A	--	A	--	--	100
40029	069	JAB512	36.2	27.0	-----	28.8	28.0	A	A	--	--	--	100
40030	109	JAB512	36.1	-----	53.3	29.0	28.0	A	--	A	--	--	100
40031	151	JAB512	35.9	-----	53.7	29.2	28.5	A	--	A	--	--	100
40034	193	JAB512	35.7	-----	53.9	28.7	28.0	A	--	A	--	--	100
40035	165	JAB512	35.1	27.4	-----	28.8	28.1	A	A	--	--	--	100
41001	073	JAB512	35.4	27.1	-----	28.9	27.9	A	A	--	--	--	100
41002	008	JAB512	35.1	-----	53.1	28.1	27.2	A	--	A	--	--	100
42001	165	JAB512	35.5	-----	53.9	28.6	27.0	A	--	A	--	--	100
42002	008	JAB512	35.0	-----	52.2	28.6	27.7	A	--	A	--	--	100
43004	146	JAB512	35.1	26.8	-----	27.4	26.1	A	A	--	--	--	100
43007	095	JAB512	36.0	27.6	-----	28.8	28.8	A	A	--	--	--	100
44002	193	JAB512	36.0	27.6	-----	27.2	28.0	A	A	--	--	--	100
46001	193	JAB512	36.2	27.6	-----	28.4	28.0	A	A	--	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
01002	008	JAB512	84.8	83.2	-----	89.1	85.7	A	A	--	--	--	100
01007	008	JAB512	85.0	-----	78.0	89.4	85.9	A	--	A	--	--	100
01019	052	JAB512	84.8	83.2	-----	88.5	85.8	A	A	--	--	--	100
01027	052	JAB512	84.5	83.2	-----	88.5	85.1	A	A	--	--	--	100
02001	008	JAB512	84.9	83.4	-----	88.9	85.5	A	A	--	--	--	100
02003	110	JAB517	85.6	-----	78.7	90.3	86.1	A	--	A	--	--	100
03004	002	JAB512	86.0	84.5	-----	89.8	87.5	A	A	--	--	--	100
04001	185	JAB512	86.2	-----	79.2	87.7	84.4	A	--	A	--	--	100
04006	185	JAB512	86.2	84.7	-----	87.4	84.2	A	A	--	--	--	100
04012	002	JAB512	86.2	-----	79.7	88.8	84.3	A	--	A	--	--	100
06001	136	JAB514	83.6	82.6	-----	88.2	83.6	A	A	--	--	--	100
06004	008	JAB512	84.4	-----	77.6	89.0	84.2	A	--	A	--	--	100
07004	062	JAB512	84.3	-----	77.1	88.4	84.4	A	--	A	--	--	100
07007	174	JAB512	84.6	82.9	-----	88.9	84.2	A	A	--	--	--	100
08002	008	JAB512	84.0	-----	77.4	89.1	84.7	A	--	A	--	--	100
09004	075	JAB517	86.5	-----	79.3	88.8	85.6	A	--	A	--	--	100
09007	168	JAB512	85.1	-----	78.0	88.1	84.1	A	--	A	--	--	100
09008	062	JAB512	84.8	83.8	-----	87.9	85.4	A	A	--	--	--	100
09009	008	JAB512	84.1	-----	77.1	88.0	83.7	A	--	A	--	--	100
09010	002	JAB512	85.8	-----	78.8	90.0	86.5	A	--	A	--	--	100
09011	002	JAB512	86.2	84.3	-----	89.5	86.2	A	A	--	--	--	100
09014	075	JAB517	86.4	84.8	-----	88.8	85.4	A	A	--	--	--	100
10001	002	JAB512	86.0	84.2	-----	90.5	87.0	A	A	--	--	--	100
10002	002	JAB512	86.0	-----	79.1	90.6	87.0	A	--	A	--	--	100
11002	008	JAB512	84.6	-----	77.6	88.9	84.6	A	--	A	--	--	100
11004	160	JAB512	84.4	83.0	-----	88.1	83.7	A	A	--	--	--	100
11005	175	JAB512	83.8	-----	77.0	87.6	83.6	A	--	A	--	--	100
11007	008	JAB512	84.7	83.0	-----	88.7	84.7	A	A	--	--	--	100
11021	176	JAB517	84.9	-----	78.4	88.7	83.9	A	--	A	--	--	100
11025	100	JAB512	86.3	84.2	-----	88.0	84.3	A	A	--	--	--	100
12003	006	JAB512	85.7	-----	77.7	87.7	84.4	A	--	A	--	--	100
12006	008	JAB512	85.0	-----	78.1	89.2	84.9	A	--	A	--	--	100
12010	122	JAB512	84.7	-----	77.7	88.5	84.9	A	--	A	--	--	100
12011	111	JAB517	85.3	83.7	-----	89.5	86.2	A	A	--	--	--	100
12012	008	JAB512	84.5	83.2	-----	89.2	85.2	A	A	--	--	--	100
12013	087	JAB512	85.5	83.8	-----	87.4	83.5	A	A	--	--	--	100
12014	075	JAB517	86.1	-----	80.1	89.5	85.6	A	--	A	--	--	100
12015	041	JAB512	85.0	83.7	-----	88.0	84.5	A	A	--	--	--	100
12018	041	JAB512	85.0	83.8	-----	87.7	84.2	A	A	--	--	--	100
13001	050	JAB512	85.2	83.7	-----	87.7	83.8	A	A	--	--	--	100
13004	200	JAB512	84.2	-----	77.5	88.3	85.2	A	--	A	--	--	100
13005	002	JAB512	85.7	-----	79.2	90.9	86.4	A	--	A	--	--	100
13006	002	JAB512	85.9	-----	78.8	90.5	87.6	A	--	A	--	--	100
13007	002	JAB512	85.9	84.3	-----	90.8	87.2	A	A	--	--	--	100
13008	002	JAB512	86.1	84.5	-----	90.0	86.8	A	A	--	--	--	100
13010	008	JAB512	84.7	83.0	-----	88.4	84.7	A	A	--	--	--	100
13013	111	JAB517	85.5	83.8	-----	89.5	85.4	A	A	--	--	--	100
13014	008	JAB512	83.8	-----	76.7	89.2	84.5	A	--	B	--	--	92.9
13015	008	JAB512	83.8	82.5	-----	89.1	84.1	A	A	--	--	--	100
13016	041	JAB512	85.9	84.4	-----	86.7	83.7	A	A	--	--	--	100
13021	002	JAB512	85.4	84.1	-----	91.4	87.6	A	A	--	--	--	100
13022	008	JAB512	84.5	-----	77.5	88.5	83.9	A	--	A	--	--	100
13024	002	JAB512	85.8	84.3	-----	91.3	87.1	A	A	--	--	--	100
13033	087	JAB512	85.5	-----	78.8	87.4	83.5	A	--	A	--	--	100
13035	008	JAB512	84.8	-----	78.2	88.9	85.2	A	--	A	--	--	100
13036	006	JAB512	85.7	83.6	-----	88.1	84.7	A	A	--	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
13038	002	JAB512	85.7	83.9	-----	91.4	87.2	A	A	--	--	--	100
13039	002	JAB512	86.0	-----	79.0	90.5	86.7	A	--	A	--	--	100
13045	002	JAB512	86.3	-----	79.0	92.2	88.2	A	--	A	--	--	100
13049	002	JAB512	85.7	-----	78.8	91.8	86.6	A	--	A	--	--	100
13051	008	JAB512	84.3	-----	77.7	89.3	84.7	A	--	A	--	--	100
13052	002	JAB512	85.6	-----	78.7	92.1	87.5	A	--	A	--	--	100
13055	002	JAB512	85.7	84.2	-----	92.4	88.3	A	A	--	--	--	100
13056	012	JAB512	87.1	-----	79.9	88.8	84.2	B	--	A	--	--	92.9
13063	050	JAB512	85.2	-----	78.5	88.2	83.3	A	--	A	--	--	100
13067	008	JAB512	84.9	-----	77.9	89.4	85.5	A	--	A	--	--	100
13071	075	JAB517	86.1	84.6	-----	90.0	85.8	A	A	--	--	--	100
13077	008	JAB512	84.4	83.1	-----	88.4	85.4	A	A	--	--	--	100
13078	006	JAB512	85.1	-----	78.2	87.5	83.8	A	--	A	--	--	100
13079	041	JAB512	85.3	-----	78.4	86.9	84.0	A	--	A	--	--	100
13080	008	JAB512	84.0	82.3	-----	88.2	84.9	A	A	--	--	--	100
13082	008	JAB512	83.8	82.1	-----	89.2	84.9	A	A	--	--	--	100
13083	008	JAB512	84.8	84.5	-----	89.2	85.2	A	A	--	--	--	100
13088	154	JAB512	85.5	84.1	-----	88.4	84.3	A	A	--	--	--	100
13089	002	JAB512	85.7	-----	78.9	91.3	87.5	A	--	A	--	--	100
13090	008	JAB512	83.6	82.3	-----	88.0	85.2	A	A	--	--	--	100
13101	002	JAB512	85.7	-----	78.9	92.5	87.6	A	--	A	--	--	100
13107	008	JAB512	84.7	83.4	-----	89.4	85.5	A	A	--	--	--	100
13109	008	JAB512	84.0	-----	77.1	88.9	84.7	A	--	A	--	--	100
13115	041	JAB512	85.0	83.8	-----	88.0	83.9	A	A	--	--	--	100
14002	008	JAB512	84.5	83.2	-----	88.9	84.5	A	A	--	--	--	100
14004	008	JAB512	83.5	-----	76.9	88.3	84.0	A	--	A	--	--	100
14005	137	JAB512	84.7	-----	78.3	88.8	83.8	A	--	A	--	--	100
14006	006	JAB512	85.7	-----	78.2	87.2	83.5	A	--	A	--	--	100
14007	041	JAB512	85.3	-----	78.4	87.7	83.7	A	--	A	--	--	100
14018	008	JAB512	83.6	-----	76.9	88.9	84.9	A	--	A	--	--	100
14022	008	JAB512	83.9	-----	76.8	88.0	83.7	A	--	B	--	--	92.9
14023	006	JAB512	85.2	-----	78.2	88.0	84.6	A	--	A	--	--	100
14026	008	JAB512	83.6	82.3	-----	88.9	84.4	A	A	--	--	--	100
14029	041	JAB512	85.2	83.5	-----	87.7	84.0	A	A	--	--	--	100
15007	008	JAB512	84.7	82.9	-----	88.0	84.2	A	A	--	--	--	100
15008	002	JAB512	85.5	-----	78.6	91.1	87.6	A	--	A	--	--	100
15010	002	JAB512	85.8	84.0	-----	90.5	87.2	A	A	--	--	--	100
16004	171	JAB512	84.3	-----	77.6	88.5	85.2	A	--	A	--	--	100
16005	006	JAB512	85.5	84.0	-----	88.4	83.8	A	A	--	--	--	100
16008	089	JAB514	84.3	83.3	-----	88.2	84.9	A	A	--	--	--	100
17003	190	JAB512	86.7	-----	80.1	88.4	84.6	A	--	B	--	--	92.9
18003	008	JAB512	84.3	82.7	-----	88.4	84.1	A	A	--	--	--	100
20001	006	JAB512	85.1	-----	78.2	87.7	83.6	A	--	A	--	--	100
20002	128	JAB512	85.2	83.2	-----	87.7	84.1	A	A	--	--	--	100
20003	081	JAB512	85.5	84.0	-----	87.5	83.6	A	A	--	--	--	100
20004	081	JAB512	85.5	84.0	-----	87.5	83.6	A	A	--	--	--	100
21001	172	JAB512	85.2	-----	78.1	88.1	84.1	A	--	A	--	--	100
21004	057	JAB512	85.2	-----	79.8	88.5	84.5	A	--	A	--	--	100
22007	144	JAB512	86.0	-----	79.3	88.4	84.7	A	--	A	--	--	100
22010	006	JAB512	84.7	83.4	-----	88.5	84.4	A	A	--	--	--	100
22015	008	JAB512	83.8	-----	77.0	87.8	84.1	A	--	A	--	--	100
22019	006	JAB512	85.1	-----	78.0	88.1	84.1	A	--	A	--	--	100
22023	129	JAB512	84.8	83.3	-----	87.9	83.8	A	A	--	--	--	100
23001	057	JAB512	83.2	86.2	-----	87.8	84.1	B	B	--	--	--	78.6
23002	172	JAB512	85.3	-----	78.6	87.7	84.1	A	--	A	--	--	100
23005	002	JAB512	86.2	84.1	-----	92.0	88.0	A	A	--	--	--	100

[20]平均赤血球容積　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測定値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
23006	088	JAB512	84.9	82.8	-----	90.4	86.8	A	A	--	--	--	100
23007	169	JAB512	84.7	-----	78.0	87.7	84.6	A	--	A	--	--	100
23009	088	JAB512	84.9	-----	78.1	90.4	86.8	A	--	A	--	--	100
23012	083	JAB517	86.9	83.9	-----	90.9	87.4	A	A	--	--	--	100
23018	008	JAB512	84.5	-----	77.8	87.8	84.5	A	--	A	--	--	100
23022	006	JAB512	84.7	83.6	-----	87.7	84.0	A	A	--	--	--	100
23026	088	JAB512	84.9	-----	78.1	90.4	86.8	A	--	A	--	--	100
23029	172	JAB512	85.0	-----	78.2	87.7	84.3	A	--	A	--	--	100
23030	088	JAB512	84.9	82.8	-----	90.4	86.8	A	A	--	--	--	100
23032	083	JAB517	86.9	83.9	-----	90.9	87.4	A	A	--	--	--	100
23037	088	JAB512	84.9	-----	78.1	90.4	86.8	A	--	A	--	--	100
23038	169	JAB512	85.1	83.6	-----	88.3	84.1	A	A	--	--	--	100
23039	169	JAB512	85.5	83.8	-----	88.4	83.8	A	A	--	--	--	100
23040	008	JAB512	83.8	-----	76.9	88.2	85.1	A	--	A	--	--	100
23042	200	JAB512	84.3	84.4	-----	94.1	86.2	A	A	--	--	--	100
24001	169	JAB512	85.1	-----	78.2	88.0	84.8	A	--	A	--	--	100
24002	122	JAB512	84.7	-----	77.7	88.5	84.9	A	--	A	--	--	100
25001	122	JAB512	84.7	-----	77.7	88.5	84.9	A	--	A	--	--	100
25002	126	JAB512	85.2	84.4	-----	88.1	85.6	A	A	--	--	--	100
26002	024	JAB517	84.0	82.6	-----	89.5	86.4	A	A	--	--	--	100
26005	009	JAR408	82.7	-----	75.5	92.3	87.8	--	--	--	--	--	======
26012	200	JAB512	84.3	82.8	-----	87.8	83.9	A	A	--	--	--	100
27002	008	JAB512	84.4	-----	77.6	87.9	84.3	A	--	A	--	--	100
27003	200	JAB512	84.3	-----	77.0	89.5	85.3	A	--	A	--	--	100
27005	122	JAB512	84.7	83.2	-----	88.5	84.9	A	A	--	--	--	100
27006	200	JAB512	84.2	82.7	-----	88.1	84.8	A	A	--	--	--	100
27007	009	JAR408	82.7	80.9	-----	92.3	88.0	--	--	--	--	--	======
27009	008	JAB512	84.8	83.2	-----	89.6	85.1	A	A	--	--	--	100
27010	094	JAB512	85.2	83.3	-----	87.9	82.5	A	A	--	--	--	100
27018	060	JAB512	84.7	83.2	-----	88.5	84.9	A	A	--	--	--	100
27023	090	JAB512	85.6	85.3	-----	88.2	85.0	A	B	--	--	--	92.9
27031	090	JAB512	87.8	-----	81.1	87.5	85.2	B	--	B	--	--	64.3
27037	200	JAB512	84.1	82.8	-----	88.5	84.8	A	A	--	--	--	100
27038	008	JAB512	84.6	83.3	-----	89.0	85.3	A	A	--	--	--	100
27041	029	JAB512	85.4	83.9	-----	89.7	86.8	A	A	--	--	--	100
27042	102	JAB512	84.1	82.6	-----	86.2	82.5	A	A	--	--	--	100
27045	200	JAB512	84.2	-----	77.7	88.3	84.7	A	--	A	--	--	100
27048	200	JAB512	84.5	83.0	-----	88.5	85.4	A	A	--	--	--	100
27051	002	JAB512	85.8	84.1	-----	91.2	87.4	A	A	--	--	--	100
27052	200	JAB512	84.3	82.8	-----	88.7	84.5	A	A	--	--	--	100
27061	200	JAB512	84.3	-----	77.2	89.9	85.2	A	--	A	--	--	100
28001	090	JAB512	87.2	85.6	-----	89.6	85.6	B	B	--	--	--	85.7
28007	197	JAB512	85.2	-----	78.3	87.1	84.1	A	--	A	--	--	100
28008	090	JAB512	87.9	-----	80.5	89.0	84.6	B	--	B	--	--	71.4
28014	008	JAB512	84.8	83.0	-----	87.8	85.2	A	A	--	--	--	100
28015	002	JAB512	85.8	84.0	-----	92.8	88.2	A	A	--	--	--	100
28018	102	JAB512	84.1	82.6	-----	86.1	82.5	A	A	--	--	--	100
28019	002	JAB512	85.5	-----	78.4	92.4	88.0	A	--	A	--	--	100
28022	198	JAB512	86.2	84.3	-----	90.0	86.8	A	A	--	--	--	100
28029	200	JAB512	84.3	-----	77.3	88.9	84.5	A	--	A	--	--	100
30006	126	JAB512	86.1	-----	79.0	87.4	84.9	A	--	A	--	--	100
31002	008	JAB512	84.3	-----	77.4	88.6	83.9	A	--	A	--	--	100
31003	008	JAB512	84.0	-----	77.0	87.7	83.9	A	--	A	--	--	100
33002	065	JAB517	86.0	-----	80.1	90.4	87.3	A	--	A	--	--	100
33004	008	JAB512	84.3	82.4	-----	88.0	84.7	A	A	--	--	--	100
33014	112	JAB519	86.7	-----	79.8	90.9	86.9	--	--	--	--	--	======

[20]平均赤血球容積　　外部施設測定結果一覧

施設	外部機関	測定装置	測　定　値					試料NO別判定値					総合
コード	コード	コード	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	1	2	3	4	5	評価点
34001	008	JAB512	84.0	-----	77.0	88.6	83.9	A	--	A	--	--	100
34002	008	JAB512	84.1	82.5	-----	87.7	83.9	A	A	--	--	--	100
34003	008	JAB512	84.1	-----	76.8	87.7	84.4	A	--	B	--	--	92.9
34005	112	JAB512	84.5	82.8	-----	87.3	83.1	A	A	--	--	--	100
34013	112	JAB512	84.5	82.8	-----	87.3	83.1	A	A	--	--	--	100
35006	109	JAB512	85.9	84.3	-----	88.3	85.2	A	A	--	--	--	100
36002	161	JAB512	85.5	-----	78.8	87.5	84.8	A	--	A	--	--	100
37001	058	JAB512	83.1	81.7	-----	88.0	83.6	B	B	--	--	--	85.7
37004	008	JAB512	83.6	82.1	-----	88.1	83.5	A	A	--	--	--	100
38006	054	JAJ011	86.1	84.3	-----	88.5	81.2	--	--	--	--	--	======
38009	006	JAB512	85.1	-----	77.7	88.1	83.6	A	--	A	--	--	100
40001	193	JAB512	85.1	83.6	-----	89.1	84.5	A	A	--	--	--	100
40002	193	JAB512	84.4	-----	78.6	88.9	85.1	A	--	A	--	--	100
40004	165	JAB512	85.1	-----	77.8	85.5	82.5	A	--	A	--	--	100
40006	165	JAB512	85.2	-----	78.2	86.7	83.0	A	--	A	--	--	100
40013	109	JAB512	85.5	-----	78.5	88.5	84.6	A	--	A	--	--	100
40015	008	JAB512	83.9	82.7	-----	88.2	83.5	A	A	--	--	--	100
40022	165	JAB512	85.6	83.9	-----	87.2	83.5	A	A	--	--	--	100
40025	109	JAB512	85.2	-----	78.4	88.5	84.5	A	--	A	--	--	100
40026	165	JAB512	85.3	83.6	-----	86.7	83.1	A	A	--	--	--	100
40028	200	JAB512	85.4	-----	78.5	88.9	84.1	A	--	A	--	--	100
40029	069	JAB512	84.9	83.4	-----	87.4	83.6	A	A	--	--	--	100
40030	109	JAB512	85.6	-----	78.9	88.7	84.9	A	--	A	--	--	100
40031	151	JAB512	85.6	-----	79.1	86.8	83.3	A	--	A	--	--	100
40034	193	JAB512	84.9	-----	78.6	88.0	84.2	A	--	A	--	--	100
40035	165	JAB512	85.4	83.8	-----	86.3	83.5	A	A	--	--	--	100
41001	073	JAB512	85.0	83.5	-----	86.9	83.7	A	A	--	--	--	100
41002	008	JAB512	84.0	-----	76.5	87.8	83.5	A	--	B	--	--	100
42001	165	JAB512	85.6	-----	78.7	87.0	82.7	A	--	A	--	--	100
42002	008	JAB512	84.2	-----	77.5	87.7	84.4	A	--	A	--	--	100
43004	146	JAB512	85.2	83.7	-----	87.7	84.2	A	A	--	--	--	100
43007	095	JAB512	85.7	84.3	-----	88.0	84.3	A	A	--	--	--	100
44002	193	JAB512	85.4	83.4	-----	88.1	84.8	A	A	--	--	--	100
46001	193	JAB512	84.9	83.6	-----	87.7	84.0	A	A	--	--	--	100

第25回臨床検査精度管理調査

補助調査･臨床検査の基準範囲に関する調査

集計結果

調 査 の 概 要

1 調査の目的

健診施設等の臨床検査の実情と精度管理実施状況等を把握し、臨床検査精度管理調査参加施設等の業務の参考に供することを目的とする。

2 調査実施時期

平成28年10月～11月

3 調査対象期間

実施件数については平成27年度の実績、その他は調査日現在の状況。

4 調査対象施設

臨床検査精度管理調査参加施設 356施設（うち健康診断施設 319施設）。

5 調査事項

健康診断施設等における臨床検査の実施状況および精度管理実施状況、臨床検査の基準範囲に関する現状調査。
（添付資料（平成28年度補助調査票、臨床検査の基準範囲に関する調査票）参照）。

6 調査票の回収率

調査対象施設のうち補助調査票に回答があったのは320施設、基準範囲に関する調査票への回答は318施設からであった。

平成28年度（第25回）臨床検査精度管理調査補助調査票集計結果

1．精度管理等の実施

設問1-1で、精度管理の実施体制について以下の回答を得た。

1-1 臨床検査精度管理実施体制

選任	選　任		資　格		
精度管理責任者	有	291	医　師	臨床検査技師	その他
	無	19	129	145	29
精度管理担当者	有	287	医　師	臨床検査技師	その他
	無	17	2	263	31

選任	職　位　・　職　制			
精度管理責任者	a 所長・局長ｸﾗｽ	b 部長クラス	c 課長クラス	d その他
	127	55	87	35
精度管理担当者	a 所長・局長ｸﾗｽ	b 部長クラス	c 課長クラス	d その他
	6	33	119	136

① 精度管理責任者の選任状況等

精度管理責任者を選任している施設は291施設、その主たる資格は医師129名、臨床検査技師145名、職位は、所長・局長クラスで127名である。

自施設で検査する場合は当然であるが、外部委託する場合でも精度管理責任者の選任が求められていることから、未選任の施設19施設の速やかな選任が求められるところである。

② 精度管理担当者の選任状況等

精度管理担当者を選任している施設は287施設、その主たる資格は臨床検査技師263名、職位は、その他136名となった。

精度管理担当者未選任の17施設には、同担当者の選任等の精度管理体制の明確化を求めたい。

③ 全衛連以外の外部精度管理調査参加状況

外部精度管理調査参加では、日本医師会の精度管理調査に参加している施設176施設と最も多く、次いで臨床衛生検査技師会の精度管理調査参加140施設であった。その他調査票に記載された精度管理実施機関名を示す。

1-2 全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無

全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無	日本医師会	都道府県市	臨床衛生検査技師会	衛生検査所協会	総合健診医学会	メーカー等
	176	118	140	33	102	114

f.に記載されたメーカー名等（記載のとおりです。正式名称とはかぎりません。）

ＣＡＰ	アークレイ	富士レビオ	栄研化学	積水メディカル
シスメックス	関東化学	デンカ	協和メディックス	シーメンス
和光純薬	デタミナー	人間ドッグ学会	バイオラッド	東ソー
予防医学事業中央会	ニットーボー	極東製薬工業		

④ 内部精度管記録それぞれを作製している施設数1-3と、内部精度管理の実施の有無は以下のとおりである。

1-3 内部精度管理記録

自施設測定に係る制度管理標準仕様書	精度管理図等図表記録	関連項目との相関チェック	測定装置の保守管理機録	検査担当者の研修記録
197施設	161施設	77施設	195施設	161施設

1-4 内部制度管理の実施（回答：320施設）

検査項目	実施の有無(%)		実施頻度		コントロール試料					
			毎回毎日	その他	市販品	血清の性状		自家製	濃度数	
生化学	有	164 (51 %)	150 (92 %)	1	160 (93 %)	a.凍結 b.凍結乾燥 c.液状 d.その他	134 (84 %) 22 (14 %) 21 (13 %) 1 (0.6 %)	13 (7.5 %)	a.2濃度 b.その他	145 (92 %) 12 (7.6 %)
血液	有	166 (52 %)	154 (93 %)	2	160 (98 %)	a.メーカー指定 b.その他	159 (99 %) 2 (1.3 %)	3 (1.8 %)	a.2濃度 b.その他	96 (61 %) 61 (39 %)
尿	有	217 (68 %)	147 (68 %)	49	200 (92 %)	a.メーカー指定 b.その他	178 (89 %) 23 (12 %)	17 (7.8 %)	a.2濃度 b.その他	154 (81 %) 37 (19 %)

注1) 実施の有無の（ ）書きは回答施設に対する比率（整数以下は四捨五入）である。
注2) 実施頻度・コントロール試料の（ ）書きは実施有の施設に対する比率（整数以下は四捨五入）である。
注3) 数字の不整合は無回答の施設があることによる。

内部精度管理調査は、尿関係の検査項目を実施する施設においては６割以上の施設66.7%で実施され、生化学および血液の項目を実施する施設では、半数弱50%台の実施率なった。

内部精度管理調査未実施の施設については、精度管理調査体制の整備、内部精度管理調査の速やかな実施を求めたい。

実施施設のうち、尿関係を除く検査項目を実施する各施設においては、約90%の施設で毎回あるいは毎日精度管理調査を実施しているが、尿関係の項目では本年度調査でも68%にとどまっている。
コントロール試料の市販品、自家製の使用状況では、市販品の比率が圧倒的に高くコントロール試料の濃度数は2濃度が主流となっている。

⑤ 外部委託先への精度管理調査の状況
外部委託先への精度管理調査の状況は表1-5のとおりである。

1-5 外部委託先への精度管理調査（回答：297施設）

検査項目	実施の有無(%)		実施の頻度	実施の方法	
				同一検体ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入	既知試料挿入
生化学	有	160 (54 %)	年 1回 66 (41 %) 半年1回 23 (14 %) 毎月1回 42 (26 %) その他 31 (19 %)	120 (75 %)	41 (26 %)
血液	有	151 (51 %)	年 1回 65 (43 %) 半年1回 23 (15 %) 毎月1回 36 (24 %) その他 28 (18 %)	113 (78 %)	32 (22 %)

注1) 実施の有無の（ ）書きは回答施設に対する比率
注2) 実施頻度・実施の方法の（ ）書きは実施有の施設に対する比率（整数以下は四捨五入）である。
注3) 数字の不整合は無回答の施設があることによる。
注4)「その他」には、①Ｘ－Ｒ管理図の入手。②外部精度管理結果報告書、内部精度管理調査報告書等の提出を求め評価。④複数の登録検査所

外部委託先への精度管理調査は、生化学および血液の項目を実施する施設において今年度調査で回答のあった297施設で50%台となった。
実施頻度は半数強の施設が年1回実施している。
実施方法は、生化学および血液の項目を実施する施設で同一検体ブラインド挿入を採用している施設がそれぞれ75%、78%で、残りの施設は既知試料挿入方法を採用している。
健診結果の報告は、外部委託している場合であっても、健診実施施設の責任においてなされることから、全衛連では外部委託先機関が適正な検査を実施していることの担保として、「同一検体ブラインド挿入」、「既知試料挿入」等を推奨しているところであり、外部委託先機関に対する精度管理調査の実施が改善されることを期待したい。

⑥ 外部委託先との契約・管理体制
外部委託先との契約・管理等の状況は表1-6のとおりである。

1-6 委託先との契約、管理体制（回答施設：320）

検査所要日数					
3日以内		4日以上		その他	
195	(77.4 %)	27	(10.7 %)	30	(11.9 %)

個人情報管理					
Pマーク		ＩＳＯ２７００１		その他	
217	(72.3 %)	70	(23.3 %)	13	(4.3 %)

品質管理認定・認証					
ＩＳＯ９００１	ＩＳＯ１５１８９	ＣＡＰ	日臨枝	医療関連 ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ	その他
108	178	108	63	116	24
(18.1 %)	(29.8 %)	(18.1 %)	(10.6 %)	(19.4 %)	(4 %)

情報公開					
ホームページ		パンフレット		その他	
143	(50.4 %)	97	(34.2 %)	44	(15.5 %)

注）測定項目および内部精度管理、外部精度管理に係る情報公開をどの媒体を使って行っているかについて回答

外部委託先との契約で、検査に要する日数は３日以内が最も多かった。

個人情報保護管理では、回答された320施設のうち、設問にあるいずれかの外部認証機関に保証された施設を選択している施設が95%以上だった。

外部について自施設の精度管理に関する情報を公開していると回答した施設は、320施設のうち284施設、89%であった。

2．臨床検査実施数および実施状況（平成27年度実績）

平成27年度実績の臨床検査精度管理調査各項目における年間臨床検査実施数は次ページの表「2．臨床検査実施数および実施状況」のとおりである。

検査種類のうちクレアチニンが、施設内での実施件数が目立って多く、他の検査項目比べ一桁多い。

今回回答された施設で、調査項目に関して自施設での測定は、約８割を自施設で測定している。

2. 臨床検査実施数及び実施状況（平成２７年度実績）

検査項目		回答施設数	年間施設内測定件数		施設内検査の実態（重複あり）							
					自施設職員		FMS方式		ブランチラボ		年間外部委託測定件数	
生化学検査	総コレステロール	316	33,115,698	件（約 83.0 %）	116	施設	14	施設	23	施設	6,778,454	件（約 17.0 %）
	中性脂肪	317	56,683,636	件（約 81.1 %）	116	施設	14	施設	23	施設	13,227,080	件（約 18.9 %）
	HDLコレステロール	317	47,613,294	件（約 78.5 %）	116	施設	14	施設	23	施設	13,051,432	件（約 21.5 %）
	LDLコレステロール	317	49,091,164	件（約 79.2 %）	115	施設	14	施設	23	施設	12,894,444	件（約 20.8 %）
	AST（GOT）	317	61,991,734	件（約 81.7 %）	116	施設	14	施設	23	施設	13,868,677	件（約 18.3 %）
	ALT（GPT）	317	61,717,617	件（約 81.7 %）	116	施設	14	施設	23	施設	13,848,349	件（約 18.3 %）
	γ-GT（γ-GTP）	317	57,668,082	件（約 81.0 %）	116	施設	14	施設	23	施設	13,542,532	件（約 19.0 %）
	尿酸	317	48,211,184	件（約 83.6 %）	116	施設	14	施設	23	施設	9,459,215	件（約 16.4 %）
	クレアチニン	316	101,660,180	件（約 91.7 %）	116	施設	14	施設	23	施設	9,237,435	件（約 8.3 %）
	血糖	316	48,112,808	件（約 81.5 %）	117	施設	13	施設	23	施設	10,926,722	件（約 18.5 %）
	HbA1c	317	35,921,704	件（約 78.6 %）	116	施設	13	施設	23	施設	9,755,704	件（約 21.4 %）
血液検査	ヘモグロビン	317	58,646,517	件（約 81.1 %）	121	施設	14	施設	23	施設	13,666,562	件（約 18.9 %）
	赤血球数	316	58,543,517	件（約 81.2 %）	119	施設	14	施設	23	施設	13,583,623	件（約 18.8 %）
	白血球数	315	54,834,074	件（約 83.2 %）	120	施設	14	施設	23	施設	11,071,555	件（約 16.8 %）
	血小板数	315	50,020,221	件（約 85.1 %）	119	施設	14	施設	23	施設	8,769,089	件（約 14.9 %）
	ヘマトクリット値	315	56,393,322	件（約 82.7 %）	120	施設	14	施設	23	施設	11,804,486	件（約 17.3 %）
尿検査	尿糖	315	29,168,766	件（約 90.9 %）	229	施設	5	施設	15	施設	2,910,286	件（約 9.1 %）
	尿蛋白	315	29,411,866	件（約 91.0 %）	230	施設	5	施設	15	施設	2,907,590	件（約 9.0 %）
	尿潜血	312	22,008,028	件（約 91.1 %）	227	施設	5	施設	15	施設	2,157,357	件（約 8.9 %）

4　血液検体の採取・搬送・授受について

血液検体の採取・搬送・授受の状況は315施設から回答を得られ、表3-1に生化学検査と血液検査について示す。表3-2には尿検体(尿検査)の採取･回収・授受の状況について304施設から回答を得た結果を示す。

血液検体の採取方法は、JCCLSガイドライン準拠採血法が251施設、同ガイドライン未対応または準備中との回答施設が合わせて29施設であった。

血液検体の回収時の保存方法は室温と回答した32施設、アイスボックス・冷蔵庫の使用が合わせて209施設であった。

尿検体では現場での検査を行わず、検査施設までの保管の際室温と回答した施設が、61施設であった。

検体の回収記録、授受記録について「なし」と回答した施設数は、血液検体で8施設であった。外部委託している場合であっても健診実施施設の責任において結果報告がなされることから、外部委託する場合は、検体の保存状況、検体回収時の授受記録の管理徹底を強く求めたい。

３－１　血液検体（生化学・血液検査）の採取・搬送・授受（回答：315施設）

検体の採取法	a. JCCLS ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準拠	251施設 (84.5％)	b. ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ未対応	11施設 (3.7％)	c. ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ準備中	18施設 (6.1％)	d. 測定受託機関のため該当せず	28施設 (9.4％)
検体の回収者	a. 健診スタッフ	190施設 (64.0％)	b. 健診施設回収担当者	10施設 (3.4％)	c. 測定機関回収担当者	102施設 (34.3％)	d. 委託業者	6施設 (2.0％)
検体回収時の保存方法	a. 室　温	32施設 (10.8％)	b. アイスボックス	195施設 (65.7％)	c. c.冷蔵庫	54施設 (18.2％)	d. 測定受託機関のため該当せず	21施設 (7.1％)
検体外部委託の記録	a. あ　り	260施設 (87.5％)	b. な　し	8施設 (2.7％)	c. 測定受託機関のため該当せず	33施設 (11.1％)		
検体搬送時の温度管理	a. 施し記録あり	114施設 (38.4％)	b. 実施しているが記録なし	130施設 (43.8％)	c. 未実施	60施設 (20.2％)		

注）（ ）内は回答数に対する比率（整数以下は四捨五入）

3-2 尿検体（尿検査）の採取・回収・授受 （回答：304施設）

検体の採取法	a. 自宅採尿	56 施設 (18.9 ％)	b. 健診会場で採尿（健診現場・自施設）	234 施設 (78.8 ％)		
検査の実施場所	a. 出張健診現場の担当者	176 施設 (59.3 ％)	b. 自施設検査室	104 施設 (35.0 ％)	c. 外部委託	16 施設 (5.4 ％)

＊ｂまたはｃを選択した場合のみ下記項目に回答

尿検体の回収者	a. 健診スタッフ	106 施設 (35.7 ％)	b. 委託検査機関担当者	23 施設 (7.7 ％)		
検体回収時の保存法	a. 室　温	61 施設 (20.5 ％)	b. アイスボックス	63 施設 (21.2 ％)	c. 冷蔵庫	7 施設 (2.4 ％)
検体の採取法	a. 自宅採尿	101 施設 (34.0 ％)	b. 健診会場で採尿（健診現場・自施設）	29 施設 (9.8 ％)		
尿検体搬送時の温度管理	a. 実施し記録あり	33 施設 (11.1 ％)	b. 実施しているが記録なし	46 施設 (15.5 ％)	c. 未実施	48 施設 (16.2 ％)

注）（ ）内は回答施設に対する割合である（整数以下四捨五入）。

平成 28 年度（第 25 回）基準範囲調査票集計結果

基準範囲を 3 年ごとに調査することとし、初回調査を 23 年度に実施した。

2 回目調査を平成 23 年調査以降の実績を基に 26 年に実施、報告していただいた。

26 年度の調査実施後に全衛連臨床検査専門委員会にて検討した結果、3 年ごとの調査から、毎回実施に変更する事が決定され本年度も調査を行った。

今回 28 年度調査は、27 年度における基準範囲の変更の有無と、使用している基準範囲の報告となる。

１．基準範囲の決め方について

今回「基準範囲の決め方」について 28 年度は、27 年度の質問項目 a～f の 6 項目に 2 項目を追加し、質問項目の見直しも行った。

a　：使用試薬の添付説明書記載値
b　：自機関で算出
c　：日本人間ドック学会の基準範囲
d　：日本臨床検査医学会の学生用基準範囲
e　：日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の共用基準範囲
f　：日本検査血液学会の血球計数項目の基準範囲
g　：学術文献の値
h　：その他（単位表示など具体的に記述してください）

２．基準範囲の変更について

「基準範囲の変更」理由として以下の 0～5 の 6 項目を設定した。

0　：変更なし
1　：検査方法の変更
2　：使用機器の変更
3　：試薬の変更
4　：基準値引用の変更
5　：その他（具体的に記述してください）

基準範囲の決め方を表 1 に、表 2 に基準範囲の変更についての理由をそれぞれ一覧で示し、各検査項目について集計した基準範囲数値を一覧で示す。

表1 基準範囲の決め方　＊複数回答あり

	根拠																	
項目	a 使用試薬の添付説明書記載値		b 自機関で算出		c 日本人間ドック学会の基準範囲		d 日本臨床検査医学会の学生用基準範囲		e 日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の共用基準範囲		f 日本検査血液学会の血球計数項目の基準範囲		g 学術文献の値		h その他		Blank	
総コレステロール	34	11.1%	41	15.5%	82	26.9%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.3%	71	23.3%	57	18.7%	15	8.5%
中性脂肪	33	10.9%	45	17.4%	87	28.6%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.3%	66	21.7%	56	18.4%	13	7.1%
尿酸	35	11.7%	52	21.1%	74	24.7%	0	0.0%	5	1.4%	1	0.3%	62	20.7%	57	19.1%	13	7.2%
クレアチニン	36	11.6%	75	31.8%	74	23.8%	0	0.0%	6	1.7%	1	0.3%	60	19.3%	46	14.8%	13	6.3%
AST (GOT)	31	9.9%	88	39.3%	72	23.1%	0	0.0%	6	1.7%	1	0.3%	50	16.0%	52	16.7%	12	5.7%
ALT (GPT)	31	9.9%	89	39.9%	72	23.1%	0	0.0%	6	1.6%	1	0.3%	49	15.7%	52	16.7%	12	5.7%
γ-GT（γ-GTP）	34	10.9%	87	38.7%	73	23.4%	0	0.0%	7	1.9%	1	0.3%	45	14.4%	53	17.0%	12	5.6%
血糖	33	11.0%	48	19.0%	73	24.3%	0	0.0%	6	1.7%	1	0.3%	71	23.7%	55	18.3%	13	7.5%
HDLコレステロール	32	10.8%	48	19.3%	84	28.3%	0	0.0%	3	0.9%	1	0.3%	63	21.2%	53	17.8%	13	7.2%
LDLコレステロール	34	11.1%	44	16.8%	80	26.1%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.3%	73	23.9%	54	17.6%	16	8.9%
HbA1c	37	11.8%	39	14.2%	75	24.0%	0	0.0%	4	1.1%	1	0.3%	76	24.3%	66	21.1%	15	8.8%
ヘモグロビン	31	9.9%	81	35.1%	70	22.4%	0	0.0%	8	2.2%	2	0.6%	57	18.3%	50	16.0%	13	6.3%
赤血球数	30	9.6%	79	33.8%	71	22.7%	0	0.0%	8	2.2%	2	0.6%	60	19.2%	49	15.7%	14	6.9%
白血球数	32	10.3%	82	35.7%	69	22.1%	1	0.3%	7	2.2%	2	0.6%	57	18.3%	49	15.7%	13	6.3%
ヘマトクリット	31	9.9%	82	35.7%	69	22.1%	0	0.0%	8	2.6%	2	0.6%	57	18.3%	49	15.7%	14	6.8%
血小板数	31	10.0%	80	34.6%	67	21.5%	0	0.0%	7	2.3%	3	0.9%	58	18.6%	51	16.4%	14	6.9%
MCV	34	10.9%	83	36.1%	37	11.8%	0	0.0%	11	3.5%	4	1.2%	60	19.2%	52	16.6%	32	15.9%

表2 基準範囲の変更

項目	根拠													
	変更なし		検査方法の変更		使用機器の変更		試薬の変更		基準値引用の変更		その他		Blank	
総コレステロール	291	91.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.8%	2	0.6%	16	5.0%
中性脂肪	291	91.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.8%	3	0.9%	15	4.7%
尿酸	286	89.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	13	4.1%	3	0.9%	15	4.7%
クレアチニン	290	91.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	10	3.1%	2	0.6%	15	4.7%
AST (GOT)	295	92.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.2%	2	0.6%	14	4.4%
ALT (GPT)	295	92.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.2%	2	0.6%	14	4.4%
γ-GT (γ-GTP)	294	92.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	7	2.2%	2	0.6%	14	4.4%
血糖	289	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.1%	4	1.3%	15	4.7%
HDLコレステロール	292	91.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	3	0.9%	15	4.7%
LDLコレステロール	289	91.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.2%	2	0.6%	17	5.4%
HbA1c	291	91.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	3	0.9%	15	4.7%
ヘモグロビン	292	91.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	9	2.8%	2	0.6%	14	4.4%
赤血球数	293	91.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	8	2.5%	2	0.6%	15	4.7%
白血球数	293	92.1%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	8	2.5%	2	0.6%	14	4.4%
ヘマトクリット	292	91.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	8	2.5%	2	0.6%	15	4.7%
血小板数	293	92.1%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	7	2.2%	2	0.6%	15	4.7%
MCV	277	87.1%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	5	1.6%	2	0.6%	33	10.4%

３．各項目の基準範囲の集計結果

対象は、精度管理調査参加施設 356 施設。回収施設数は 320 施設。基準範囲の下限で「〇〇以下」の場合は全て測定値 0 でまとめて表示した。

総コレステロール(無性差) (mg/dL) 回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			11 (3.4%)	130	～	219	57 (17.8%)
	～	219	1 (0.3%)	130	～	220	15 (4.7%)
	～	220	1 (0.3%)	135	～	219	1 (0.3%)
100	～	219	1 (0.3%)	139	～	219	1 (0.3%)
100	～	220	2 (0.6%)	140	～	190	2 (0.6%)
101	～	219	1 (0.3%)	140	～	199	110 (34.4%)
104	～	199	1 (0.3%)	140	～	219	21 (6.6%)
120	～	219	28 (8.8%)	140	～	220	3 (0.9%)
120	～	220	1 (0.3%)	142	～	248	3 (0.9%)
125	～	219	1 (0.3%)	150	～	199	2 (0.6%)
125	～	220	1 (0.3%)	150	～	219	34 (10.6%)
128	～	219	19 (5.9%)	150	～	220	2 (0.6%)
130	～	119	1 (0.3%)		～		( )

中性脂肪（無性差）（mg/ dL）回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 (3.0%)	35	～	199	1 (0.3%)
0	～	140	1 (0.3%)	36	～	130	1 (0.3%)
0	～	149	11 (3.7%)	40	～	149	23 (7.7%)
1	～	50	1 (0.3%)	40	～	150	2 (0.7%)
20	～	149	1 (0.3%)	40	～	234	1 (0.3%)
30	～	149	152 (51.2%)	45	～	149	3 (1.0%)
30	～	150	6 (2.0%)	50	～	149	39 (13.1%)
30	～	160	1 (0.3%)	50	～	150	2 (0.7%)
32	～	149	1 (0.3%)	130	～	149	1 (0.3%)
32	～	150	1 (0.3%)		～	149	21 (7.1%)
35	～	149	36 (12.1%)		～	150	3 (1.0%)
35	～	150	3 (1.0%)		～		( )

尿酸(男性) (mg/dL)回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			14 (4.4%)		3.0	～	6.9	7 (2.2%)
0.0	～	6.9	6 (1.9%)		3.0	～	7.0	8 (2.5%)
0.0	～	7.0	47 (14.7%)		3.1	～	6.5	1 (0.3%)
0.0	～	7.5	2 (0.6%)		3.3	～	7.0	1 (0.3%)
0.1	～	7.0	1 (0.3%)		3.4	～	7.0	3 (0.9%)
1.0	～	7.0	1 (0.3%)		3.5	～	7.0	3 (0.9%)
1.5	～	7.0	1 (0.3%)		3.5	～	7.8	1 (0.3%)
1.6	～	7.0	1 (0.3%)		3.5	～	7.9	1 (0.3%)
2.0	～	6.9	2 (0.6%)		3.6	～	7.0	47 (14.7%)
2.0	～	7.0	25 (7.8%)		3.6	～	8.0	1 (0.3%)
2.0	～	7.5	1 (0.3%)		3.7	～	7.0	25 (7.8%)
2.1	～	6.9	1 (0.3%)		3.7	～	7.6	3 (0.9%)
2.1	～	7.0	73 (22.8%)		3.7	～	7.8	2 (0.6%)
2.3	～	7.5	1 (0.3%)		3.8	～	7.0	17 (5.3%)
2.5	～	6.9	1 (0.3%)		3.8	～	7.5	1 (0.3%)
2.5	～	7.0	16 (5.0%)		4.0	～	6.9	1 (0.3%)
2.6	～	7.0	1 (0.3%)		4.0	～	7.0	2 (0.6%)
2.9	～	6.5	1 (0.3%)		8.0	～	20.0	1 (0.3%)

尿酸(女性) (mg/dL)回答数320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			143 (44.7%)		2.4	～	6.0	1 (0.3%)
	～	5.7	1 (0.3%)		2.4	～	7.0	6 (1.9%)
	～	6.9	1 (0.3%)		2.5	～	5.4	3 (0.9%)
	～	7.0	6 (1.9%)		2.5	～	6.0	2 (0.6%)
0.0	～	6.9	1 (0.3%)		2.5	～	6.3	1 (0.3%)
0.0	～	7.0	6 (1.9%)		2.5	～	7.0	45 (14.1%)
1.5	～	7.0	1 (0.3%)		2.6	～	5.5	3 (0.9%)
1.8	～	5.2	1 (0.3%)		2.6	～	6.0	2 (0.6%)
2.0	～	5.5	2 (0.6%)		2.6	～	7.0	3 (0.9%)
2.0	～	5.9	2 (0.6%)		2.7	～	5.4	1 (0.3%)
2.0	～	6.0	1 (0.3%)		2.7	～	7.0	18 (5.6%)
2.0	～	7.0	15 (4.7%)		2.8	～	7.0	1 (0.3%)
2.1	～	7.0	20 (6.3%)		3.0	～	6.9	1 (0.3%)
2.2	～	5.7	3 (0.9%)		3.0	～	7.0	1 (0.3%)
2.3	～	5.5	2 (0.6%)		3.5	～	7.0	1 (0.3%)
2.3	～	7.0	24 (7.5%)		8.0	～	20.0	1 (0.3%)
2.4	～	5.8	1 (0.3%)			～		( )

クレアチニン（男性）（mg/dL）回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			10 （ 3.1% ）		0.45	～	1.14	1 （ 0.3% ）
0.00	～	1.00	88 （ 27.5% ）		0.50	～	1.00	2 （ 0.6% ）
0.00	～	1.04	4 （ 1.3% ）		0.50	～	1.09	1 （ 0.3% ）
0.00	～	1.09	19 （ 5.9% ）		0.50	～	1.10	7 （ 2.2% ）
0.00	～	1.10	12 （ 3.8% ）		0.50	～	1.20	3 （ 0.9% ）
0.00	～	1.14	5 （ 1.6% ）		0.53	～	1.02	2 （ 0.6% ）
0.00	～	1.15	1 （ 0.3% ）		0.56	～	1.06	3 （ 0.9% ）
0.00	～	1.19	4 （ 1.3%		0.57	～	1.04	1 （ 0.3% ）
0.00	～	1.20	1 （ 0.3% ）		0.60	～	1.00	3 （ 0.9% ）
0.00	～	1.59	1 （ 0.3% ）		0.60	～	1.10	41 （ 12.8% ）
0.01	～	1.00	1 （ 0.3% ）		0.60	～	1.15	2 （ 0.6% ）
0.10	～	1.00	1 （ 0.3% ）		0.60	～	1.20	1 （ 0.3% ）
0.10	～	1.10	1 （ 0.3% ）		0.60	～	1.29	2 （ 0.6% ）
0.10	～	1.70	1 （ 0.3% ）		0.61	～	1.04	53 （ 16.6% ）
0.20	～	0.50	1 （ 0.3% ）		0.61	～	1.08	2 （ 0.6% ）
0.30	～	1.10	2 （ 0.6% ）		0.61	～	1.09	4 （ 1.3% ）
0.35	～	1.14	2 （ 0.6% ）		0.61	～	1.94	1 （ 0.3% ）
0.40	～	1.00	1 （ 0.3% ）		0.65	～	1.00	1 （ 0.3% ）
0.40	～	1.09	2 （ 0.6% ）		0.65	～	1.07	2 （ 0.6% ）
0.40	～	1.10	1 （ 0.3% ）		0.65	～	1.09	19 （ 5.9% ）
0.40	～	1.14	4 （ 1.3% ）		0.66	～	1.11	1 （ 0.3% ）
0.40	～	1.19	1 （ 0.3% ）		0.66	～	1.13	2 （ 0.6% ）
0.42	～	1.11	1 （ 0.3% ）		1.10	～	1.29	1 （ 0.3% ）
0.44	～	1.15	1 （ 0.3% ）			～		（ 0.0% ）

クレアチニン（女性）（mg/dL）回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			18 （ 5.6% ）		0.40	～	0.90	4 （ 1.3% ）
0.00	～	0.70	85 （ 26.6% ）		0.40	～	0.99	1 （ 0.3% ）
0.00	～	0.79	18 （ 5.6% ）		0.40	～	1.00	1 （ 0.3% ）
0.00	～	0.80	13 （ 4.1% ）		0.40	～	1.10	2 （ 0.6% ）
0.00	～	0.82	4 （ 1.3% ）		0.41	～	0.76	3 （ 0.9% ）
0.00	～	0.84	5 （ 1.6% ）		0.43	～	0.72	1 （ 0.3% ）
0.00	～	0.85	1 （ 0.3% ）		0.43	～	0.82	1 （ 0.3% ）
0.00	～	0.89	5 （ 1.6% ）		0.45	～	0.80	3 （ 0.9% ）
0.00	～	0.90	1 （ 0.3% ）		0.45	～	0.82	1 （ 0.3% ）
0.01	～	0.70	1 （ 0.3%		0.45	～	0.85	2 （ 0.6% ）
0.10	～	0.70	1 （ 0.3% ）		0.46	～	0.70	1 （ 0.3% ）
0.10	～	0.80	2 （ 0.6% ）		0.46	～	0.79	3 （ 0.9% ）
0.22	～	0.91	1 （ 0.3% ）		0.46	～	0.80	1 （ 0.3% ）
0.30	～	0.79	1 （ 0.3% ）		0.46	～	0.82	23 （ 7.2% ）
0.30	～	0.80	1 （ 0.3% ）		0.47	～	0.79	53 （ 16.6% ）
0.30	～	0.90	1 （ 0.3% ）		0.48	～	0.80	1 （ 0.3% ）
0.31	～	0.88	4 （ 1.3% ）		0.48	～	0.85	2 （ 0.6% ）
0.32	～	0.84	1 （ 0.3% ）		0.50	～	0.80	2 （ 0.6% ）
0.35	～	0.84	2 （ 0.6% ）		0.50	～	0.90	1 （ 0.3% ）
0.35	～	0.94	1 （ 0.3% ）		0.50	～	1.10	2 （ 0.6% ）
0.40	～	0.70	18 （ 5.6% ）		0.50	～	1.50	1 （ 0.3% ）
0.40	～	0.79	2 （ 0.6% ）		0.60	～	1.20	1 （ 0.3% ）
0.40	～	0.80	22 （ 6.9% ）		0.80	～	0.99	1 （ 0.3% ）
0.40	～	0.89	1 （ 0.3% ）			～		（ ）

AST（無性差）（U/L）回答数 320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 (2.8%)	7	～	36	2 (0.6%)
0	～	30	94 (29.4%)	7	～	40	1 (0.3%)
0	～	31	3 (0.9%)	8	～	30	6 (1.9%)
0	～	33	1 (0.3%)	8	～	33	2 (0.6%)
0	～	35	18 (5.6%)	8	～	34	2 (0.6%)
0	～	38	4 (1.3%)	8	～	35	3 (0.9%)
0	～	39	1 (0.3%)	8	～	38	11 (3.4%)
0	～	40	26 (8.1%)	8	～	40	8 (2.5%)
0	～	42	2 (0.6%)	9	～	38	1 (0.3%)
0	～	45	3 (0.9%)	10	～	30	3 (0.9%)
1	～	30	3 (0.9%)	10	～	35	10 (3.1%)
1	～	35	2 (0.6%)	10	～	40	63 (19.7%)
1	～	42	1 (0.3%)	11	～	35	1 (0.3%)
3	～	35	1 (0.3%)	13	～	30	7 (2.2%)
3	～	38	1 (0.3%)	13	～	33	21 (6.6%)
5	～	35	2 (0.6%)	31	～	60	1 (0.3%)
5	～	40	7 (2.2%)		～		( )

ALT（無性差）（U/L）回答数 320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 (2.8%)	5	～	30	9 (2.8%)
0	～	30	95 (29.7%)	5	～	35	13 (4.1%)
0	～	31	1 (0.3%)	5	～	39	3 (0.9%)
0	～	35	21 (6.6%)	5	～	40	11 (3.4%)
0	～	39	1 (0.3%)	5	～	42	2 (0.6%)
0	～	40	20 (6.3%)	5	～	43	1 (0.3%)
0	～	44	2 (0.6%)	5	～	45	47 (14.7%)
0	～	45	12 (3.8%)	6	～	26	1 (0.3%)
1	～	30	3 (0.9%)	6	～	27	2 (0.6%)
1	～	35	1 (0.3%)	6	～	30	15 (4.7%)
1	～	40	3 (0.9%)	6	～	32	2 (0.6%)
3	～	35	1 (0.3%)	6	～	35	3 (0.9%)
3	～	40	1 (0.3%)	6	～	39	1 (0.3%)
3	～	49	1 (0.3%)	6	～	40	8 (2.5%)
4	～	39	1 (0.3%)	7	～	42	1 (0.3%)
4	～	40	1 (0.3%)	7	～	45	1 (0.3%)
4	～	41	1 (0.3%)	8	～	42	4 (1.3%)
4	～	43	6 (1.9%)	10	～	40	5 (1.6%)
4	～	44	6 (1.9%)	10	～	42	2 (0.6%)
4	～	45	2 (0.6%)	31	～	60	1 (0.3%)

γ-GT（男性）（U/L）回答数 320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			12 （ 3.8% ）	1	～	70	1 （ 0.3% ）
0	～	49	2 （ 0.6% ）	1	～	73	1 （ 0.3% ）
0	～	50	103 （ 32.2% ）	1	～	79	1 （ 0.3% ）
0	～	51	1 （ 0.3% ）	3	～	84	1 （ 0.3% ）
0	～	55	17 （ 5.3% ）	5	～	55	5 （ 1.6% ）
0	～	59	1 （ 0.3% ）	5	～	60	6 （ 1.9% ）
0	～	60	5 （ 1.6% ）	6	～	55	2 （ 0.6% ）
0	～	66	1 （ 0.3% ）	6	～	64	1 （ 0.3% ）
0	～	67	4 （ 1.3% ）	6	～	71	1 （ 0.3% ）
0	～	70	16 （ 5.0% ）	6	～	85	1 （ 0.3% ）
0	～	73	7 （ 2.2% ）	6	～	88	1 （ 0.3% ）
0	～	75	16 （ 5.0% ）	7	～	60	1 （ 0.3% ）
0	～	76	1 （ 0.3% ）	7	～	74	1 （ 0.3% ）
0	～	79	19 （ 5.9% ）	8	～	58	2 （ 0.6% ）
0	～	80	41 （ 12.8% ）	9	～	70	1 （ 0.3% ）
0	～	84	4 （ 1.3% ）	10	～	47	21 （ 6.6% ）
0	～	85	5 （ 1.6% ）	10	～	80	1 （ 0.3% ）
0	～	86	4 （ 1.3% ）	12	～	72	1 （ 0.3% ）
0	～	88	1 （ 0.3% ）	13	～	64	2 （ 0.6% ）
0	～	95	1 （ 0.3% ）	16	～	73	2 （ 0.6% ）
1	～	50	2 （ 0.6% ）	16	～	84	1 （ 0.3% ）
1	～	55	1 （ 0.3% ）	18	～	66	1 （ 0.3% ）
1	～	60	1 （ 0.3% ）		～		（ ）

γ-GT（女性）（U/L）回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			149 （ 46.6% ）	1	～	48	1 （ 0.3% ）
0	～	30	28 （ 8.8% ）	1	～	55	1 （ 0.3% ）
0	～	33	1 （ 0.3% ）	2	～	40	1 （ 0.3% ）
0	～	35	4 （ 1.3% ）	3	～	40	1 （ 0.3% ）
0	～	40	4 （ 1.3% ）	3	～	48	1 （ 0.3% ）
0	～	45	17 （ 5.3% ）	4	～	40	1 （ 0.3% ）
0	～	48	29 （ 9.1% ）	5	～	37	1 （ 0.3% ）
0	～	49	2 （ 0.6% ）	5	～	40	5 （ 1.6% ）
0	～	50	37 （ 11.6% ）	7	～	32	1 （ 0.3% ）
0	～	51	1 （ 0.3% ）	7	～	38	2 （ 0.6% ）
0	～	55	7 （ 2.2% ）	8	～	21	1 （ 0.3% ）
0	～	60	1 （ 0.3% ）	8	～	40	1 （ 0.3% ）
0	～	65	2 （ 0.6% ）	9	～	32	2 （ 0.6% ）
0	～	66	1 （ 0.3% ）	10	～	40	1 （ 0.3% ）
0	～	67	1 （ 0.3% ）	10	～	47	8 （ 2.5% ）
0	～	73	2 （ 0.6% ）	10	～	55	1 （ 0.3% ）
0	～	80	2 （ 0.6% ）	11	～	45	1 （ 0.3% ）
1	～	35	1 （ 0.3% ）	12	～	48	1 （ 0.3% ）

血糖（無性差）（mg/dL）回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 （ 2.8% ）	65	～	99	9 （ 2.8% ）
0	～	90	1 （ 0.3% ）	65	～	105	1 （ 0.3% ）
0	～	99	50 （ 15.6% ）	65	～	109	2 （ 0.6% ）
0	～	109	15 （ 4.7% ）	65	～	110	1 （ 0.3% ）
0	～	110	3 （ 0.9% ）	67	～	99	3 （ 0.9% ）
1	～	109	1 （ 0.3% ）	69	～	109	2 （ 0.6% ）
40	～	99	2 （ 0.6% ）	70	～	99	46 （ 14.4% ）
50	～	99	2 （ 0.6% ）	70	～	109	84 （ 26.3% ）
50	～	109	1 （ 0.3% ）	70	～	110	15 （ 4.7% ）
50	～	140	1 （ 0.3% ）	70	～	139	1 （ 0.3% ）
51	～	99	4 （ 1.3% ）	70	～	142	1 （ 0.3% ）
51	～	109	4 （ 1.3% ）	73	～	109	1 （ 0.3% ）
55	～	109	1 （ 0.3% ）	75	～	99	1 （ 0.3% ）
60	～	99	26 （ 8.1% ）	75	～	109	1 （ 0.3% ）
60	～	100	2 （ 0.6% ）	75	～	110	1 （ 0.3% ）
60	～	109	21 （ 6.6% ）	78	～	99	2 （ 0.6% ）
60	～	110	5 （ 1.6% ）	80	～	109	1 （ 0.3% ）

HDL（男性）（mg/dL）回答数320								
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数	
未記入			13 （ 4.1% ）	40	～	90	11 （ 3.4% ）	
1	～	40	1 （ 0.3% ）	40	～	93	1 （ 0.3% ）	
35	～	75	1 （ 0.3% ）	40	～	96	15 （ 4.7% ）	
35	～	85	2 （ 0.6% ）	40	～	99	33 （ 10.3% ）	
36	～	67	1 （ 0.3% ）	40	～	100	5 （ 1.6% ）	
37	～	67	1 （ 0.3% ）	40	～	119	98 （ 30.6% ）	
37	～	86	1 （ 0.3% ）	40	～	119.9	4 （ 1.3% ）	
38	～	90	1 （ 0.3% ）	40	～	120	1 （ 0.3% ）	
40	～	60	1 （ 0.3% ）	40	～	129	1 （ 0.3% ）	
40	～	70	4 （ 1.3% ）	40	～	999	3 （ 0.9% ）	
40	～	74	1 （ 0.3% ）	40	～		35 （ 10.9% ）	
40	～	75	9 （ 2.8% ）	41	～	67	1 （ 0.3% ）	
40	～	77	4 （ 1.3% ）	41	～	80	1 （ 0.3% ）	
40	～	79	5 （ 1.6% ）	41	～	85	1 （ 0.3% ）	
40	～	80	18 （ 5.6% ）	41	～	86	1 （ 0.3% ）	
40	～	83	1 （ 0.3% ）	41	～	96	1 （ 0.3% ）	
40	～	85	14 （ 4.4% ）	41	～	99	1 （ 0.3% ）	
40	～	86	26 （ 8.1% ）	41	～	100	1 （ 0.3% ）	
40	～	89	1 （ 0.3% ）	44	～	75	1 （ 0.3% ）	

HDL（女性）（mg/dL）回答数 320								
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数	
未記入			156 （ 48.8% ）	40	～	119	30 （ 9.4% ）	
40	～	71	2 （ 0.6% ）	40	～	120	1 （ 0.3% ）	
40	～	75	1 （ 0.3% ）	40	～	129	1 （ 0.3% ）	
40	～	79	1 （ 0.3% ）	40	～	199	1 （ 0.3% ）	
40	～	80	1 （ 0.3% ）	40	～	999	1 （ 0.3% ）	
40	～	83	11 （ 3.4% ）	40	～		19 （ 5.9% ）	
40	～	89	1 （ 0.3% ）	41	～	90	1 （ 0.3% ）	
40	～	90	23 （ 7.2% ）	41	～	96	1 （ 0.3% ）	
40	～	95	15 （ 4.7% ）	45	～	75	1 （ 0.3% ）	
40	～	96	30 （ 9.4% ）	45	～	95	1 （ 0.3% ）	
40	～	98	1 （ 0.3% ）	48	～	103	1 （ 0.3% ）	
40	～	99	5 （ 1.6% ）	49	～	74	1 （ 0.3% ）	
40	～	100	6 （ 1.9% ）	50	～	70	1 （ 0.3% ）	
40	～	103	1 （ 0.3% ）	50	～	99	2 （ 0.6% ）	
40	～	107	1 （ 0.3% ）	50	～	109	1 （ 0.3% ）	
40	～	110	1 （ 0.3% ）	53	～	87	1 （ 0.3% ）	

LDL コレステロール （男性）（mg/dL）回答数 320								
基準範囲			施設数r		基準範囲			施設数
未記入			14 （ 4.4% ）		60	～	129	1 （ 0.3% ）
0	～	119	18 （ 5.6% ）		60	～	139	11 （ 3.4% ）
0	～	120	2 （ 0.6% ）		60	～	140	1 （ 0.3% ）
0	～	139	18 （ 5.6% ）		65	～	139	16 （ 5.0% ）
0	～	140	5 （ 1.6% ）		65	～	163	1 （ 0.3% ）
0	～	159	1 （ 0.3% ）		67	～	139	1 （ 0.3% ）
0	～	163	1 （ 0.3% ）		70	～	119	10 （ 3.1% ）
0	～	199	1 （ 0.3% ）		70	～	129	1 （ 0.3% ）
1	～	139	1 （ 0.3% ）		70	～	129.9	2 （ 0.6% ）
20	～	140	1 （ 0.3% ）		70	～	139	98 （ 30.6% ）
50	～	120	1 （ 0.3% ）		70	～	139.9	1 （ 0.3% ）
50	～	139	3 （ 0.9% ）		70	～	140	3 （ 0.9% ）
58	～	139	2 （ 0.6% ）		100	～	139	1 （ 0.3% ）
60	～	119	105 （ 32.8% ）			～		（ 0.0% ）

LDL （女性）（mg/dL）回答数320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			227 （ 0.1% ）		60	～	119	30 （ 0.0% ）
0	～	119	6 （ 0.0% ）		60	～	139	5 （ 0.0% ）
0	～	120	2 （ 0.0% ）		60	～	199	1 （ 0.0% ）
0	～	139	3 （ 0.0% ）		65	～	139	4 （ 0.0% ）
0	～	159	1 （ 0.0% ）		67	～	139	1 （ 0.0% ）
0	～	163	1 （ 0.0% ）		70	～	119	4 （ 0.0% ）
0	～	199	1 （ 0.0% ）		70	～	139	28 （ 0.0% ）
1	～	139	1 （ 0.0% ）		70	～	139.9	1 （ 0.0% ）
50	～	120	1 （ 0.0% ）		79	～	139	1 （ 0.0% ）
50	～	139	1 （ 0.0% ）		100	～	139	1 （ 0.0% ）

HbA1c（無性差）（%）回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 （ 2.8% ）	4.3	～	5.9	2 （ 0.6% ）
0	～	5.1	2 （ 0.6% ）	4.3	～	6.2	2 （ 0.6% ）
0	～	5.4	1 （ 0.3% ）	4.4	～	5.5	2 （ 0.6% ）
0	～	5.5	90 （ 28.1% ）	4.4	～	5.9	2 （ 0.6% ）
0	～	5.6	1 （ 0.3% ）	4.4	～	6.4	1 （ 0.3% ）
0	～	5.8	5 （ 1.6% ）	4.5	～	6.2	2 （ 0.6% ）
0	～	5.9	4 （ 1.3% ）	4.6	～	5.5	35 （ 10.9% ）
0	～	6.0	2 （ 0.6% ）	4.6	～	5.8	2 （ 0.6% ）
0	～	6.2	10 （ 3.1% ）	4.6	～	5.9	5 （ 1.6% ）
0	～	6.3	1 （ 0.3% ）	4.6	～	6.2	115 （ 35.9% ）
0.1	～	5.5	2 （ 0.6% ）	4.7	～	5.5	1 （ 0.3% ）
0.1	～	5.9	1 （ 0.3% ）	4.7	～	5.9	1 （ 0.3% ）
3.9	～	5.5	1 （ 0.3% ）	4.7	～	6.2	3 （ 0.9% ）
4.0	～	5.5	1 （ 0.3% ）	4.9	～	5.5	1 （ 0.3% ）
4.3	～	5.5	13 （ 4.1% ）	4.9	～	6.0	2 （ 0.6% ）
4.3	～	5.8	1 （ 0.3% ）		～		（ ）

ヘモグロビン（男性）（g/dL）回答数 320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			9 （ 2.8% ）	13.4	～	17.4	1 （ 0.3% ）
11.0	～	12.9	1 （ 0.3% ）	13.4	～	17.9	1 （ 0.3% ）
12.4	～	16.6	1 （ 0.3% ）	13.5	～	17.0	2 （ 0.6% ）
12.4	～	17.6	1 （ 0.3% ）	13.5	～	17.5	17 （ 5.3% ）
12.6	～	17.6	1 （ 0.3% ）	13.5	～	17.6	45 （ 14.1% ）
13.0	～	16.0	1 （ 0.3% ）	13.5	～	17.7	2 （ 0.6% ）
13.0	～	16.6	16 （ 5.0% ）	13.5	～	18.0	6 （ 1.9% ）
13.0	～	16.9	1 （ 0.3% ）	13.5	～	18.3	2 （ 0.6% ）
13.0	～	17.0	25 （ 7.8% ）	13.5	～	18.7	1 （ 0.3% ）
13.0	～	17.5	3 （ 0.9% ）	13.5	～	18.9	1 （ 0.3% ）
13.0	～	17.6	1 （ 0.3% ）	13.5	～		2 （ 0.6% ）
13.0	～	18.0	10 （ 3.1% ）	13.6	～	17.4	2 （ 0.6% ）
13.1	～	16.6	79 （ 24.7% ）	13.6	～	17.6	1 （ 0.3% ）
13.1	～	16.9	1 （ 0.3% ）	13.6	～	18.0	1 （ 0.3% ）
13.1	～	17.6	4 （ 1.3% ）	13.6	～	18.3	24 （ 7.5% ）
13.1	～	17.9	8 （ 2.5% ）	13.7	～	16.8	2 （ 0.6% ）
13.1	～	18.0	5 （ 1.6% ）	13.7	～	17.4	4 （ 1.3% ）
13.1	～	18.3	1 （ 0.3% ）	13.8	～	17.2	1 （ 0.3% ）
13.2	～	17.0	5 （ 1.6% ）	14.0	～	16.5	1 （ 0.3% ）
13.2	～	17.6	6 （ 1.9% ）	14.0	～	18.0	24 （ 7.5% ）
13.3	～	17.0	1 （ 0.3% ）		～		（ ）

ヘモグロビン （女性）(g/dL) 回答数320								
基準範囲			施設数	基準範囲			機関数	
未記入			10 （ 3.1% ）	11.5	～	14.5	2 （ 0.6% ）	
4.6	～	5.5	1 （ 0.3% ）	11.5	～	15.0	15 （ 4.7% ）	
9.5	～	10.9	1 （ 0.3% ）	11.5	～	15.2	2 （ 0.6% ）	
10.5	～	16.0	1 （ 0.3% ）	11.5	～	15.5	8 （ 2.5% ）	
10.7	～	15.1	1 （ 0.3% ）	11.5	～	16.0	7 （ 2.2% ）	
11.0	～	15.0	17 （ 5.3% ）	11.5	～	16.5	1 （ 0.3% ）	
11.0	～	15.1	1 （ 0.3% ）	11.5	～		1 （ 0.3% ）	
11.0	～	15.2	1 （ 0.3% ）	11.6	～	14.6	1 （ 0.3% ）	
11.0	～	15.9	1 （ 0.3% ）	11.6	～	14.8	2 （ 0.6% ）	
11.0	～	16.0	3 （ 0.9% ）	11.6	～	15.1	1 （ 0.3% ）	
11.1	～	15.1	1 （ 0.3% ）	11.6	～	15.6	1 （ 0.3% ）	
11.2	～	14.6	1 （ 0.3% ）	11.6	～	16.0	1 （ 0.3% ）	
11.2	～	14.7	1 （ 0.3% ）	12.0	～	14.6	1 （ 0.3% ）	
11.2	～	14.9	1 （ 0.3% ）	12.0	～	14.7	1 （ 0.3% ）	
11.2	～	15.2	26 （ 8.1% ）	12.0	～	14.9	1 （ 0.3% ）	
11.2	～	16.0	1 （ 0.3% ）	12.0	～	15.0	2 （ 0.6% ）	
11.3	～	14.9	2 （ 0.6% ）	12.0	～	15.2	2 （ 0.6% ）	
11.3	～	15.0	5 （ 1.6% ）	12.0	～	15.5	3 （ 0.9% ）	
11.3	～	15.1	1 （ 0.3% ）	12.0	～	15.9	1 （ 0.3% ）	
11.3	～	15.2	47 （ 14.7% ）	12.0	～	16.0	27 （ 8.4% ）	
11.3	～	15.3	1 （ 0.3% ）	12.1	～	14.6	77 （ 24.1% ）	
11.3	～	15.4	1 （ 0.3% ）	12.1	～	14.9	3 （ 0.9% ）	
11.3	～	15.4	1 （ 0.3% ）	12.1	～	15.0	1 （ 0.3% ）	
11.3	～	16.0	1 （ 0.3% ）	12.1	～	15.2	3 （ 0.9% ）	
11.3	～	16.3	1 （ 0.3% ）	12.1	～	15.5	1 （ 0.3% ）	
11.3	～		1 （ 0.3% ）	12.1	～	15.9	8 （ 2.5% ）	
11.4	～	14.6	15 （ 4.7% ）	12.1	～	16.0	2 （ 0.6% ）	
11.4	～	15.0	1 （ 0.3% ）		～		（ ）	

赤血球数 （男性）（$10^4/\mu L$）回答数320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			9 （ 2.8% ）		420	～	540	1 （ 0.3% ）
360	～	550	1 （ 0.3% ）		420	～	549	1 （ 0.3% ）
380	～	580	1 （ 0.3% ）		420	～	550	4 （ 1.3% ）
390	～	540	1 （ 0.3% ）		420	～	559	1 （ 0.3% ）
400	～	539	95 （ 29.7% ）		420	～	560	4 （ 1.3% ）
400	～	540	1 （ 0.3% ）		420	～	570	19 （ 5.9% ）
400	～	550	15 （ 4.7% ）		420	～	600	1 （ 0.3% ）
400	～	560	3 （ 0.9% ）		423	～	559	1 （ 0.3% ）
400	～	570	10 （ 3.1% ）		427	～	570	44 （ 13.8% ）
400	～	579	1 （ 0.3% ）		427	～	600	1 （ 0.3% ）
400	～	580	3 （ 0.9% ）		427	～	606	1 （ 0.3% ）
400	～	599	1 （ 0.3% ）		428	～	564	1 （ 0.3% ）
401	～	540	5 （ 1.6% ）		430	～	530	3 （ 0.9% ）
410	～	530	7 （ 2.2% ）		430	～	560	1 （ 0.3% ）
410	～	540	1 （ 0.3% ）		430	～	562	1 （ 0.3% ）
410	～	550	2 （ 0.6%		430	～	570	32 （ 10.0% ）
410	～	556	1 （ 0.3% ）		430	～	577	1 （ 0.3% ）
410	～	560	2 （ 0.6% ）		431	～	565	3 （ 0.9% ）
410	～	570	2 （ 0.6% ）		435	～	555	2 （ 0.6% ）
410	～	600	1 （ 0.3% ）		438	～	539	1 （ 0.3% ）
412	～	554	1 （ 0.3% ）		438	～	577	27 （ 8.4% ）
415	～	550	1 （ 0.3% ）		440	～	560	1 （ 0.3% ）
415	～	563	1 （ 0.3% ）		440	～	590	1 （ 0.3% ）
418	～	555	1 （ 0.3% ）		450	～	550	1 （ 0.3% ）
420	～	520	1 （ 0.3% ）			～		（ 0.0% ）

赤血球数 （女性）（$10^4/\mu L$）回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			10 （ 3.1% ）		375	～	485	1 （ 0.3% ）
300	～	530	1 （ 0.3% ）		375	～	510	1 （ 0.3% ）
330	～	500	1 （ 0.3% ）		376	～	489	1 （ 0.3% ）
345	～	535	1 （ 0.3% ）		376	～	493	1 （ 0.3% ）
350	～	500	7 （ 2.2% ）		376	～	500	50 （ 15.6% ）
350	～	549	1 （ 0.3% ）		376	～	516	28 （ 8.8% ）
351	～	480	5 （ 1.6% ）		376	～	530	1 （ 0.3% ）
355	～	475	1 （ 0.3% ）		376	～	533	1 （ 0.3% ）
360	～	480	1 （ 0.3% ）		378	～	497	3 （ 0.9% ）
360	～	489	94 （ 29.4% ）		379	～	488	1 （ 0.3% ）
360	～	490	2 （ 0.6% ）		380	～	480	14 （ 4.4% ）
360	～	500	2 （ 0.6% ）		380	～	489	1 （ 0.3% ）
360	～	520	1 （ 0.3% ）		380	～	490	1 （ 0.3% ）
368	～	491	1 （ 0.3% ）		380	～	500	37 （ 11.6% ）
370	～	470	1 （ 0.3% ）		380	～	510	3 （ 0.9% ）
370	～	490	2 （ 0.6% ）		380	～	519	1 （ 0.3% ）
370	～	500	23 （ 7.2% ）		380	～	520	3 （ 0.9% ）
370	～	510	4 （ 1.3% ）		380	～	550	1 （ 0.3% ）
370	～	520	2 （ 0.6%		385	～	480	1 （ 0.3% ）
370	～	549	1 （ 0.3% ）		386	～	492	2 （ 0.6% ）
371	～	499	1 （ 0.3% ）		390	～	500	2 （ 0.6% ）
373	～	490	1 （ 0.3% ）		390	～	520	2 （ 0.6% ）
373	～	507	1 （ 0.3% ）			～		（ ）

白血球数 （無性差）（$10^2/\mu L$） 320回収								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			9 （ 2.8% ）		35	～	92	1 （ 0.3% ）
30	～	90	11 （ 3.4% ）		35	～	93	3 （ 0.9% ）
30	～	95	1 （ 0.3% ）		35	～	94	1 （ 0.3% ）
31	～	93	1 （ 0.3% ）		35	～	95	3 （ 0.9% ）
31	～	96	1 （ 0.3% ）		35	～	97	22 （ 6.9% ）
31.01	～	97	1 （ 0.3% ）		35	～	97.99	1 （ 0.3% ）
32	～	85	64 （ 20.0% ）		35	～	98	7 （ 2.2% ）
32	～	85.9	2 （ 0.6% ）		35	～	99	2 （ 0.6% ）
32	～	85.99	6 （ 1.9% ）		35	～	99.9	1 （ 0.3% ）
32	～	89	1 （ 0.3% ）		35	～	100	2 （ 0.6% ）
32	～	89.99	2 （ 0.6% ）		36	～	92	1 （ 0.3% ）
32	～	90	2 （ 0.6% ）		37	～	85	1 （ 0.3% ）
32	～	98	2 （ 0.6% ）		38	～	89	1 （ 0.3% ）
32	～	109.99	1 （ 0.3% ）		38	～	90	4 （ 1.3% ）
33	～	86	2 （ 0.6% ）		38	～	98	6 （ 1.9% ）
33	～	89	12 （ 3.8% ）		39	～	90	2 （ 0.6% ）
33	～	89.99	2 （ 0.6% ）		39	～	97	3 （ 0.9% ）
33	～	90	17 （ 5.3% ）		39	～	98	40 （ 12.5% ）
33	～	91	1 （ 0.3% ）		39	～	100	8 （ 2.5% ）
33	～	95	1 （ 0.3% ）		40	～	80	7 （ 2.2% ）
33	～	96	1 （ 0.3% ）		40	～	85	8 （ 2.5% ）
33	～	97.9	1 （ 0.3% ）		40	～	89	1 （ 0.3% ）
33	～	98	1 （ 0.3% ）		40	～	90	21 （ 6.6% ）
34	～	84	1 （ 0.3% ）		40	～	95	3 （ 0.9% ）
34	～	95	1 （ 0.3%		40	～	100	3 （ 0.9% ）
34.3	～	94.3	1 （ 0.3% ）		41	～	61	1 （ 0.3% ）
35	～	85	5 （ 1.6% ）		45	～	80	2 （ 0.6% ）
35	～	90	15 （ 4.7% ）			～		（ ）

ヘマトクリット （男性） （%） 回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			10 （ 3.1% ）		39.2	～	51.8	6 （ 1.9% ）
13.5	～	17.6	2 （ 0.6% ）		39.5	～	51.9	5 （ 1.6% ）
36.0	～	48.0	1 （ 0.3% ）		39.7	～	52.4	15 （ 4.7% ）
36.0	～	52.0	1 （ 0.3% ）		39.8	～	51.8	43 （ 13.4% ）
36.0	～	53.0	2 （ 0.6% ）		39.8	～	54.0	1 （ 0.3% ）
37.0	～	50.0	1 （ 0.3% ）		39.8	～	57.8	1 （ 0.3% ）
37.0	～	52.0	2 （ 0.6% ）		40.0	～	48.0	9 （ 2.8% ）
37.9	～	49.2	1 （ 0.3% ）		40.0	～	49.9	1 （ 0.3% ）
38.0	～	48.9	18 （ 5.6% ）		40.0	～	50.0	5 （ 1.6% ）
38.0	～	50.0	5 （ 1.6% ）		40.0	～	51.0	1 （ 0.3% ）
38.0	～	51.9	1 （ 0.3% ）		40.0	～	51.1	1 （ 0.3% ）
38.0	～	52.0	8 （ 2.5% ）		40.0	～	51.5	1 （ 0.3% ）
38.0	～	54.0	1 （ 0.3% ）		40.0	～	52.0	12 （ 3.8% ）
38.0	～	54.9	1 （ 0.3% ）		40.0	～	53.0	2 （ 0.6% ）
38.1	～	54.0	1 （ 0.3% ）		40.0	～	54.0	3 （ 0.9% ）
38.1	～	55.0	1 （ 0.3% ）		40.0	～	55.0	1 （ 0.3% ）
38.2	～	49.2	1 （ 0.3% ）		40.2	～	51.5	3 （ 0.9% ）
38.5	～	48.6	1 （ 0.3% ）		40.4	～	48.9	1 （ 0.3% ）
38.5	～	48.9	73 （ 22.8% ）		40.4	～	51.9	27 （ 8.4% ）
38.5	～	51.8	2 （ 0.6% ）		40.5	～	51.1	1 （ 0.3% ）
38.9	～	50.2	5 （ 1.6% ）		40.7	～	50.1	2 （ 0.6% ）
39.0	～	50.0	2 （ 0.6% ）		41.0	～	51.0	1 （ 0.3% ）
39.0	～	51.0	3 （ 0.9% ）		41.0	～	52.0	6 （ 1.9% ）
39.0	～	52.0	18 （ 5.6% ）		41.0	～	53.0	1 （ 0.3% ）
39.0	～	52.5	1 （ 0.3% ）		42.0	～	49.8	1 （ 0.3% ）
39.0	～	53.0	1 （ 0.3% ）		42.0	～	53.0	4 （ 1.3% ）
39.0	～		1 （ 0.3% ）		43.0	～	52.0	1 （ 0.3% ）
39.2	～	51.2	1 （ 0.3% ）			～		（ 0.0% ）

ヘマトクリット （女性） （%）回答数320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			11 （ 3.4% ）		34.0	～	45.0	14 （ 4.4% ）
11.3	～	15.2	2 （ 0.6% ）		34.0	～	45.9	1 （ 0.3% ）
30.1	～	48.0	1 （ 0.3% ）		34.0	～	46.0	8 （ 2.5% ）
31.0	～	45.0	1 （ 0.3% ）		34.0	～	46.5	5 （ 1.6% ）
32.0	～		1 （ 0.3% ）		34.0	～	47.0	1 （ 0.3% ）
32.8	～	45.1	1 （ 0.3% ）		34.0	～	48.0	2 （ 0.6% ）
33.0	～	43.0	1 （ 0.3% ）		34.1	～	47.0	1 （ 0.3% ）
33.0	～	44.5	1 （ 0.3% ）		34.3	～	43.9	1 （ 0.3% ）
33.0	～	45.0	12 （ 3.8% ）		34.3	～	45.2	29 （ 9.1% ）
33.0	～	46.0	3 （ 0.9% ）		34.8	～	45.0	14 （ 4.4% ）
33.0	～	47.9	1 （ 0.3% ）		35.0	～	44.9	1 （ 0.3% ）
33.1	～	50.0	1 （ 0.3% ）		35.0	～	45.0	5 （ 1.6% ）
33.2	～	44.4	5 （ 1.6% ）		35.0	～	46.0	2 （ 0.6% ）
33.2	～	46.7	1 （ 0.3% ）		35.0	～	46.5	1 （ 0.3% ）
33.4	～	44.9	50 （ 15.6% ）		35.0	～	47.0	2 （ 0.6% ）
33.4	～	47.0	1 （ 0.3% ）		35.0	～	48.0	9 （ 2.8% ）
33.4	～	47.8	1 （ 0.3% ）		35.1	～	44.4	2 （ 0.6% ）
33.4	～	47.9	1 （ 0.3% ）		35.5	～	43.9	72 （ 22.5% ）
33.5	～	43.5	1 （ 0.3% ）		36.0	～	42.0	1 （ 0.3% ）
33.5	～	43.9	2 （ 0.6% ）		36.0	～	43.5	1 （ 0.3% ）
33.5	～	46.0	1 （ 0.3% ）		36.0	～	44.1	1 （ 0.3% ）
33.6	～	44.6	3 （ 0.9% ）		36.0	～	46.0	2 （ 0.6% ）
33.6	～	45.6	1 （ 0.3% ）		36.0	～	47.0	6 （ 1.9% ）
33.7	～	46.0	1 （ 0.3% ）		36.0	～	48.0	3 （ 0.9% ）
34.0	～	42.0	8 （ 2.5% ）		37.0	～	47.0	4 （ 1.3% ）
34.0	～	43.0	1 （ 0.3% ）		37.0	～	50.0	1 （ 0.3% ）
34.0	～	43.9	18 （ 5.6% ）			～		（ ）

血小板数 （無性差）（$10^4/\mu$L）回答数 320								
基準範囲			施設数		基準範囲			施設数
未記入			10 （ 3.1% ）		13.1	～	36.2	24 （ 7.5% ）
10.0	～	40.0	2 （ 0.6% ）		13.1	～	36.5	3 （ 0.9% ）
11.0	～	34.0	1 （ 0.3% ）		13.4	～	34.9	1 （ 0.3% ）
12.0	～	32.0	2 （ 0.6% ）		14.0	～	31.0	1 （ 0.3% ）
12.0	～	34.0	2 （ 0.6% ）		14.0	～	34.0	21 （ 6.6% ）
12.0	～	35.0	4 （ 1.3% ）		14.0	～	34.9	1 （ 0.3% ）
12.0	～	36.0	1 （ 0.3% ）		14.0	～	35.0	3 （ 0.9% ）
12.0	～	37.0	1 （ 0.3% ）		14.0	～	35.9	14 （ 4.4% ）
12.0	～	38.0	3 （ 0.9% ）		14.0	～	36.0	8 （ 2.5% ）
12.0	～	39.0	1 （ 0.3% ）		14.0	～	37.9	29 （ 9.1% ）
12.0	～	40.0	6 （ 1.9% ）		14.0	～	38.0	3 （ 0.9% ）
12.0	～	41.0	1 （ 0.3% ）		14.0	～	40.0	1 （ 0.3% ）
12.0	～	45.0	1 （ 0.3% ）		14.0	～	44.9	1 （ 0.3% ）
13.0	～	32.0	1 （ 0.3% ）		14.5	～	35.0	5 （ 1.6% ）
13.0	～	34.0	7 （ 2.2% ）		14.5	～	37.0	2 （ 0.6% ）
13.0	～	34.9	79 （ 24.7% ）		15.0	～	33.0	1 （ 0.3% ）
13.0	～	35.0	12 （ 3.8% ）		15.0	～	35.0	2 （ 0.6% ）
13.0	～	36.0	9 （ 2.8% ）		15.0	～	36.0	1 （ 0.3% ）
13.0	～	36.9	24 （ 7.5% ）		15.0	～	37.0	1 （ 0.3% ）
13.0	～	37.0	12 （ 3.8% ）		15.0	～	38.0	1 （ 0.3% ）
13.0	～	37.9	1 （ 0.3% ）		15.0	～	40.0	1 （ 0.3% ）
13.0	～	38.0	3 （ 0.9% ）		15.3	～	33.7	1 （ 0.3% ）
13.0	～	39.9	4 （ 1.3% ）		15.7	～	38.4	1 （ 0.3% ）
13.0	～	40.0	4 （ 1.3% ）		15.8	～	34.8	2 （ 0.6% ）
13.0	～	43.0	1 （ 0.3% ）			～		（ ）

MCV （男性）(fL)回答数320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			35 （ 10.9% ）	83.0	～	99.0	7 （ 2.2% ）
40.4	～	51.9	1 （ 0.3% ）	83.0	～	100.0	4 （ 1.3% ）
70.1	～	107.9	1 （ 0.3% ）	83.0	～	101.0	51 （ 15.9% ）
76.0	～	101.0	6 （ 1.9% ）	83.0	～	101.5	7 （ 2.2% ）
77.0	～	100.0	1 （ 0.3% ）	83.0	～	101.9	2 （ 0.6% ）
77.0	～	104.0	1 （ 0.3% ）	83.0	～	102.0	23 （ 7.2% ）
78.0	～	101.0	2 （ 0.6% ）	83.0	～	103.0	1 （ 0.3% ）
78.0	～	101.9	1 （ 0.3% ）	83.5	～	100.7	1 （ 0.3% ）
78.0	～	111.0	1 （ 0.3% ）	83.6	～	98.2	3 （ 0.9% ）
78.0	～	102.0	3 （ 0.9% ）	84.0	～	99.0	2 （ 0.6% ）
79.0	～	101.6	1 （ 0.3% ）	84.0	～	100.0	4 （ 1.3% ）
79.0	～	102.0	1 （ 0.3% ）	84.0	～	101.0	3 （ 0.9% ）
79.0	～	105.0	1 （ 0.3% ）	84.0	～	102.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	94.0	2 （ 0.6% ）	84.0	～	104.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	96.0	2 （ 0.6% ）	85.0	～	90.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	99.0	3 （ 0.9% ）	85.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	99.9	1 （ 0.3% ）	85.0	～	99.0	5 （ 1.6% ）
80.0	～	100.0	13 （ 4.1% ）	85.0	～	100.0	5 （ 1.6% ）
80.0	～	101.0	1 （ 0.3%	85.0	～	100.9	2 （ 0.6% ）
80.0	～	103.0	5 （ 1.6% ）	85.0	～	102.0	17 （ 5.3% ）
80.0	～	105.0	1 （ 0.3% ）	85.0	～	102.9	1 （ 0.3% ）
81.0	～	98.0	3 （ 0.9% ）	85.0	～	103.0	3 （ 0.9% ）
81.0	～	100.0	2 （ 0.6% ）	85.0	～	104.0	2 （ 0.6% ）
81.3	～	101.3	1 （ 0.3% ）	85.0	～	105.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	92.0	1 （ 0.3% ）	86.0	～	101.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）	86.0	～	101.9	1 （ 0.3% ）
82.0	～	99.0	1 （ 0.3% ）	86.0	～	102.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	100.0	1 （ 0.3% ）	86.0	～	103.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	101.0	2 （ 0.6% ）	86.0	～	104.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	102.0	2 （ 0.6% ）	86.3	～	101.6	1 （ 0.3% ）
82.6	～	103.0	1 （ 0.3% ）	87.0	～	97.0	1 （ 0.3% ）
82.7	～	101.6	43 （ 13.4% ）	87.0	～	100.0	2 （ 0.6% ）
82.9	～	101.2	1 （ 0.3% ）	87.0	～	101.0	1 （ 0.3% ）
83.0	～	93.0	2 （ 0.6% ）	87.0	～	102.0	6 （ 1.9% ）
83.0	～	96.0	1 （ 0.3% ）	88.0	～	99.0	3 （ 0.9% ）
83.0	～	97.0	3 （ 0.9% ）	89.0	～	99.0	4 （ 1.3% ）
83.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）		～		（ 0.0% ）

MCV （女性）（fL）回答数 320							
基準範囲			施設数	基準範囲			施設数
未記入			138 （ 43.1% ）	82.0	～	102.0	1 （ 0.3% ）
34.3	～	45.2	1 （ 0.3% ）	82.0	～	102.1	1 （ 0.3% ）
70.1	～	107.9	1 （ 0.3% ）	83.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）
77.0	～	100.0	1 （ 0.3% ）	83.0	～	100.0	3 （ 0.9% ）
78.0	～	96.0	1 （ 0.3% ）	83.0	～	101.0	1 （ 0.3% ）
79.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）	83.1	～	97.7	1 （ 0.3% ）
79.0	～	99.0	9 （ 2.8% ）	83.6	～	98.2	2 （ 0.6% ）
79.0	～	99.2	1 （ 0.3% ）	84.0	～	93.0	1 （ 0.3% ）
79.0	～	100.0	71 （ 22.2% ）	84.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）
79.0	～	101.0	6 （ 1.9% ）	84.0	～	99.0	2 （ 0.6% ）
80.0	～	94.0	1 （ 0.3% ）	84.0	～	100.0	2 （ 0.6% ）
80.0	～	99.0	2 （ 0.6% ）	84.0	～	100.9	1 （ 0.3% ）
80.0	～	99.9	1 （ 0.3% ）	84.0	～	102.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	100.0	2 （ 0.6% ）	85.0	～	95.0	1 （ 0.3% ）
80.0	～	101.0	35 （ 10.9% ）	85.0	～	99.0	4 （ 1.3% ）
80.0	～	101.9	2 （ 0.6% ）	85.0	～	100.0	3 （ 0.9% ）
81.0	～	98.0	1 （ 0.3% ）	85.0	～	101.0	2 （ 0.6% ）
81.0	～	99.0	1 （ 0.3% ）	85.0	～	102.0	4 （ 1.3% ）
81.0	～	100.0	3 （ 0.9% ）	87.0	～	100.0	1 （ 0.3% ）
81.0	～	102.0	2 （ 0.6% ）	87.0	～	102.0	2 （ 0.6% ）
81.9	～	99.1	1 （ 0.3% ）	88.0	～	99.0	1 （ 0.3% ）
82.0	～	100.0	1 （ 0.3% ）	89.0	～	99.0	2 （ 0.6% ）

参考資料

１．第２５回精度管理調査参加施設一覧

２．第２５回精度管理調査外部測定施設一覧

３．第２５回全衛連臨床検査精度管理調査回答票

４．平成２８年度全衛連臨床検査精度管理調査票（控用）

５．平成２８年度臨床検査精度管理調査実施要領

６．平成２８年度（第２５回）臨床検査精度管理調査　補助調査票

７．臨床検査の基準範囲に関する調査票（平成２８年度）

１．　第２５回精度管理調査参加施設一覧

都道府県名	施　設　名
北海道	(公財)北海道労働保健管理協会 (公財)北海道結核予防会 (公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　北海道支部札幌商工診療所 (医社)慶友会 吉田病院 第一岸本臨床検査センター　札幌 (一社)日本健康倶楽部北海道支部 (公財)北海道労働保健管理協会　札幌総合健診センター 札幌臨床検査センター㈱ (医)新産健会　スマイル健康クリニック
青森県	(一財)全日本労働福祉協会 青森県支部 (公財)八戸市総合健診センター (公財)ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会　八戸西健診プラザ
岩手県	(公財)岩手県予防医学協会 (社医)啓愛会 健診センター 盛岡臨床検査センター
宮城県	(一財)杜の都産業保健会 (一財)宮城県予防医学協会 (公財)宮城厚生協会 (一財)宮城県成人病予防協会 (一財)宮城県成人病予防協会　中央診療所 (医社)進興会　せんだい総合健診ｸﾘﾆｯｸ (一財)杜の都産業保健会　　一番町健診クリニック (医)仁泉会　みやぎ健診プラザ
山形県	(一財)全日本労働福祉協会 東北支部 (一財)日本健康管理協会　山形健康管理センター
福島県	(公財)福島県労働保健センター (医)創仁会 東日本診療所 (医)郡山病院 (公財)福島県保健衛生協会
茨城県	(公財)日立メディカルセンター (一財)全日本労働福祉協会　茨城県支部 (一財)茨城県メディカルセンター (公財)茨城県総合健診協会 ㈱江東微生物研究所　微研中央研究所つくば (公社)取手市医師会　取手北相馬　保健医療ｾﾝﾀｰ医師会病院
栃木県	(公財)栃木県保健衛生事業団 (医)北斗会　宇都宮東病院 (医社)福田会 福田記念病院 (公財)宇都宮市医療保健事業団　健診センター (社医)中山会 宇都宮記念病院　総合健診センター

都道府県名	施　設　名
	(医)宇都宮健康クリニック 宇都宮巡回診療所 さくら診療所 ㈱昭和メディカルサイエンス総合研究所 (医社)亮仁会 那須中央病院　総合健診センター (医社)健暉会　清原診療所　巡回健診部 栄研化学(株)野木事業所
群馬県	(一財)日本健康管理協会　北関東支部 (一財)全日本労働福祉協会 群馬県支部 (公財)群馬慈恵会 松井田病院 (医社)三愛会 三愛クリニック (一社)伊勢崎佐波医師会病院　成人病検診センター (株)群馬臨床検査センター
埼玉県	(公財)埼玉県健康づくり事業団 (医社)愛友会 上尾中央総合病院 (医財)健隆会　戸田中央総合健康管理ｾﾝﾀｰ ㈱ビー・エム・エル BML総合研究所 (社医)刀仁会 坂戸中央病院 (株)保健科学　東日本　総合研究所 (公社)東松山医師会病院 ㈱メディアース・ビケン (医)クレモナ会　ティーエムクリニック (医社)紘智会籠原病院 (医財)新生会　大宮共立病院 (一社)日本健康倶楽部 浦和支部
千葉県	(一財)君津健康センター (公財)ちば県民保健予防財団 (医社)福生会 斎藤労災病院 (医社)誠馨会　新東京病院 (株)サンリツ (医社)廣生会　関東予防医学診療所 (一財)柏戸記念財団 (医社)青山会 (医社)圭春会　小張総合病院　健診ｾﾝﾀｰ (一社)日本健康倶楽部　千葉支部 (一社)千葉衛生福祉協会　千葉診療所 (社福)聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 健診ｾﾝﾀｰ (医社)報徳会　報徳千葉診療所
東京都	(一財)全日本労働福祉協会 (一財)健康医学協会 (公財)東京都予防医学協会 (一財)日本予防医学協会　本部・東日本事業部

都道府県名	施　設　名
	(一社)労働保健協会 (一財)産業保健協会 (一財)労働衛生協会 (一財)労働医学研究会 (医社)新町クリニック健康管理センター (医社)日健会 日健クリニック (医財)福音医療会 (医社)同友会 ㈱エスアールエル　エスアールエル　八王子ラボラトリー (株)LSIメディエンス　中央総合ラボラトリー (公財)愛世会 愛誠病院 (医社)俊秀会 エヌ・ケイ・クリニック (医社)松英会 (医財)立川中央病院　附属健康クリニック (一財)近畿健康管理センター東京事業部 (医社)七星会　ｶｽｶﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ (公財)河野臨床医学研究所　附属北品川クリニック (一財)産業保健研究財団 (医社)朋翔会　弥生ファーストクリニック (一財)日本健康増進財団 (医社)幸楽会　幸楽ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ (一財)近藤記念医学財団 富坂診療所 (一財)日本健康管理協会　新宿健診プラザ (医社)こころとからだの元氣プラザ (医社)康生会　シーエスケー・クリニック (医財)南葛勤医協　芝健診センター (一財)東京保健会 病体生理研究所 (公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　東京支部ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ診療所 (株)昭和メディカルサイエンス (医財)三友会 深川ギャザリアクリニック (医財)京映会 エスアールエル　MUQSラボラトリー (一財)日本がん知識普及協会 (医社)多摩医療会 原町田診療所 (医社)友好会 目黒メディカルクリニック (医財)東友会 (一社)衛生文化協会 城西病院 (医財)綜友会 (一財)健康医学協会 霞が関ビル診療所 (医社)明芳会　イムス板橋健診クリニック (医社)予防会　新宿クリニック (医社)あさひ会　西早稲田クリニック

都道府県名	施　設　名
	㈱ファルコバイオシステムズ東京研究所
	(医社)成山会楠樹記念クリニック
	(株)エスアールエル練馬ラボラトリー
	(医財)綜友会　第二臨海クリニック
	(医社)せいおう会　鶯谷健診センター
	(公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ東京支部　ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ読売ﾋﾞﾙ診療所
	(医社)生光会　新宿追分クリニック
	(医社)生光会　新宿追分クリニック　板橋分院
	(医社)友好会秋葉原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ
	東京大学医学部附属病院検査部
神奈川県	(公財)神奈川県予防医学協会 中央診療所
	(一財)神奈川県労働衛生福祉協会
	(一財)ヘルス・サイエンス・センター
	(医社)相和会
	(一財)京浜保健衛生協会
	(医)興生会 相模台健診クリニック
	(公財) 神奈川県結核予防会
	(株)保健科学研究所
	(社医)石心会　川崎健診クリニック
	(医社)成澤会　清水橋クリニック
	(一社)日本健康倶楽部 横浜支部
	㈱北里大塚バイオメディカルアッセイ　研究所
	(一社)日本厚生団 長津田厚生総合病院
	(医社)優和会　湘南健診クリニック　湘南健康管理センター
	船員保険健康管理センター
	(医社)藤順会　藤沢総合健診センター
	(公財)神奈川県予防医学協会　集団検診センター
新潟県	(一社)新潟県労働衛生医学協会
	(一社)新潟縣健康管理協会
	(公財)新潟県保健衛生センター
	(一社)上越医師会　上越地域総合健康管理ｾﾝﾀｰ
	(一財)健康医学予防協会
	(一財)健康医学予防協会　長岡健康管理センター
	(一社)新潟県労働衛生医学協会　附属ｱｸｱｰﾚ長岡健康増進ｾﾝﾀｰ
	(一社)新潟県労働衛生医学協会　附属佐渡検診センター
富山県	(一財)北陸予防医学協会
	(公財)友愛健康医学センター
	(一社)日本健康倶楽部 北陸支部
	(公財)富山県健康づくり財団　富山県健康増進センター
	(医社)若葉会　高重記念クリニック　予防医療センター
石川県	(一財)石川県予防医学協会
	(医社)洋和会　未病医学センター

都道府県名	施　設　名
福井県	(公財)福井県予防医学協会 (公財)福井県労働衛生センター
長野県	(一社)長野県労働基準協会連合会　松本健診所 (一財)労働衛生協会 長野県支部 (一財)全日本労働福祉協会 長野県支部 (公財)長野県健康づくり事業団 (一財)中部公衆医学研究所 (株)メディック 長野ラボ
岐阜県	(一財)岐阜県産業保健センター (一社)ぎふ綜合健診センター (一財)岐阜健康管理センター (株)メディック 岐阜ラボ (一財)総合保健センター
静岡県	(一財)東海検診センター (社福)聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター (公財)静岡県予防医学協会 (公財)静岡県産業労働福祉協会 (一財)芙蓉協会聖隷沼津第一ｸﾘﾆｯｸ　聖隷沼津健康診断センター (一社)静岡市静岡医師会健診センター (医社)清風会 芹沢病院 (社福)聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター (株)メディック 静岡ラボ (医社)駿栄会 御殿場石川病院 (社福)聖隷福祉事業団　聖隷健康　ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰShizuoka (医)弘遠会　すずかけセントラル病院 (医)豊岡会　浜松とよおか病院 (公財)静岡県予防医学協会　西部検査所
愛知県	(一社)瀬戸健康管理センター (一財)公衆保健協会 (一財)愛知健康増進財団 (一財)全日本労働福祉協会 東海支部 (医)豊昌会 豊田健康管理クリニック (一財)名古屋公衆医学研究所 (一社)オリエンタル労働衛生協会 (医社)卓和会 しらゆりクリニック (社医)宏潤会　だいどうクリニック　健診センター (医)東海予防医学クリニック (医)光生会 光生会病院 (一社)半田市医師会 健康管理センター (一社)碧南市医師会 臨床検査センター (医)あいち健康クリニック (公財)豊田地域医療センター

都道府県名	施　設　名
	(一社)岡崎市医師会 公衆衛生センター
	(医)豊岡会 豊橋元町病院　健康管理センター
	㈱エスアールエル エスアールエル　愛知ラボラトリー
	(医)名翔会　名古屋セントラルクリニック
	(公財)愛知県健康づくり振興事業団
	(医)松柏会 国際セントラルクリニック
	(医)九愛会 中京サテライトクリニック
	(医)名翔会　和合セントラルクリニック
	三河安城クリニック
	(一財)近畿健康管理センター　名古屋事業部
	(一財)全日本労働福祉協会　東海診療所
	(一財)日本予防医学協会 東海事業部
三重県	(一財)三重県産業衛生協会
	(一財)近畿健康管理センター三重事業部
	(医)尚豊会　四日市健診クリニック
滋賀県	(一財)近畿健康管理センター 滋賀事業部
	(一財)滋賀保健研究センター
	(株)メディック(滋賀)
京都府	(一財)京都工場保健会
	(公財)京都健康管理研究会 中央診療所
	(一財)京都労災援護財団 京都城南診療所
	(一財)京都予防医学センター
	ファルコバイオシステムズ総合研究所
	(医社)洛和会　洛和会音羽病院　健診センター
	(一財)京都工場保健会 診療所 宇治支所
大阪府	(公社)関西労働衛生技術センター
	(医)崇孝会 北摂クリニック
	(一財)日本予防医学協会　西日本事業部
	(一財)関西労働保健協会
	(一財)近畿健康管理センター大阪事業部
	パナソニック健康保険組合　産業衛生科学センター
	大阪健康倶楽部 関山診療所
	(社医)寿楽会 m.o クリニック
	(医)いながきレディースクリニック　集検部
	(株)エスアールエル　エスアールエル関西ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
	(株)大阪血清微生物研究所
	(医)緑地会　赤尾クリニック
	(株)メディック　メディック堺
	(医)恵生会
	多根総合病院健診部診療所
	(医)あけぼの会
	(公財)パブリックヘルス リサーチセンター 関西支部

都道府県名	施　設　名
	(医)健人会 那須クリニック
	(医)厚生会　厚生会クリニック
	(医)樫本会 樫本病院
	(特医)渡辺医学会　桜橋渡辺病院　附属駅前第三ビル診療所
	(社医)愛仁会　愛仁会総合健康センター
	(医)一翠会　一翠会千里中央健診ｾﾝﾀｰ
	(一財)関西労働保健協会　附属千里LC健診センター
	(一社)オリエンタル労働衛生協会　大阪支部　ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ
	(医)愛悠会　ますむらクリニック
	(医)気象会　東朋八尾病院
兵庫県	(一財)順天厚生事業団
	(公財)兵庫県予防医学協会
	(一社)姫路市医師会
	(医社)泰志会　島田クリニック
	(医社)坂上田病院
	(一社)西宮市医師会
	(医社)尚仁会 平島病院
	(社医)神鋼記念会　神鋼記念病院 健診センター
	(公財)兵庫県健康財団
	(公財)加古川総合保健センター
	(一社)日本健康倶楽部 兵庫支部診療所
	(医社)河合医院
	(一社)神戸市医師会　医療センター診療所
	(一社)日本健康倶楽部　和田山診療所
	(一財)京都工場保健会　神戸健診クリニック
	(社医)愛仁会　カーム尼崎健診プラザ
	(株)LSIメディエンス　関西ラボラトリー
	(株)LSIメディエンス　神戸市医師会ラボラトリー
和歌山県	(社医)黎明会 健診センター・キタデ
	(一財)NSメディカル・ヘルスケアサービス
	(医)南労会　紀和病院
鳥取県	(公財)中国労働衛生協会 鳥取検診所
	(公財)中国労働衛生協会 米子検診所
	(公財)鳥取県保健事業団
島根県	(公財)島根県環境保健公社
	(医社)創健会 松江記念病院
岡山県	(一財)淳風会 健康管理センター
	(一社)岡山県労働基準協会　労働衛生センター
	(公財)中国労働衛生協会 津山検診所
	(一財)倉敷成人病センター　倉敷成人病健診センター
	(公財)岡山県健康づくり財団
	大ケ池診療所

都道府県名	施　設　名
	(医)養寿会 ｳｪﾙ･ﾋﾞｰｲﾝｸﾞ･ﾒﾃﾞｨｶ保健ｸﾘﾆｯｸ
広島県	(一財)広島県集団検診協会 (公財)中国労働衛生協会 (公財)中国労働衛生協会 尾道検診所 (一財)広島県環境保健協会 (公財)広島県地域保健医療推進機構 (社医)里仁会 興生総合病院 (医)健康倶楽部　健康倶楽部健診クリニック (医)広島健康会 アルパーク　検診クリニック (医)あかね会 中島土谷クリニック　健診センター (医社)仁恵会　福山検診所 (株)福山臨床検査センター
山口県	(公財)山口県予防保健協会 (一社)日本健康倶楽部　山口支部
徳島県	(一社)徳島県労働基準協会連合会　健診部
香川県	(一社)香川労働基準協会 (一社)瀬戸健康管理研究所 (医社)重仁　麻田総合病院 (公財)香川成人医学研究所
愛媛県	(社)今治市医師会診療所 (医)菅井内科 (一社)エヒメ健診協会
高知県	(公財)高知県総合保健協会 (医)健会　高知検診クリニック 独立行政法人 地域医療機能推進機構　高知西病院 高知県厚生農業協同組合連合会　JA高知病院 JA高知健診ｾﾝﾀｰ
福岡県	(一財)西日本産業衛生会　北九州産業衛生診療所 (一財)西日本産業衛生会　北九州健診診療所 (公財)福岡県すこやか健康事業団　福岡国際総合健診センター (公財)福岡労働衛生研究所 (一財)日本予防医学協会 九州事業部 (一社)北九州市小倉医師会　小倉医師会健診センター (一財)九州健康総合センター (社医)雪の聖母会　聖マリアヘルスケアセンター (医)心愛 小倉中央放射線科 (一財)医療情報健康財団 (医)原三信病院　健康管理センター (医社)高邦会 高木病院 (一社)日本健康倶楽部 福岡支部 (公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　西日本支部 ㈱シー・アール・シー総合研究所 (一社)日本健康倶楽部　北九州支部診療所

都道府県名	施　設　名
	(医社)生光会 ヘルスポートクリニック
	(公財)福岡県結核予防会　福岡結核予防センター
	(公社)北九州市門司区医師会　門司区医師会診療所
	(一財)西日本産業衛生会　福岡健診診療所
	(公財)福岡県すこやか健康事業団　　総合健診センター診療所
佐賀県	(一財)佐賀県産業医学協会
	(医社)如水会 今村病院
長崎県	(公財)長崎県健康事業団
	(医)西九州健康診断本部診療所
熊本県	(公財)熊本県総合保健センター
	日本赤十字社 熊本健康管理センター
	(医)室原会 菊南病院
	熊本県厚生農業協同組合連合会
大分県	(一財)大分健康管理協会　大分総合健診センター
	(一財)西日本産業衛生会　大分労働衛生管理センター
宮崎県	(公財)宮崎県健康づくり協会
鹿児島県	(公社)鹿児島県労働基準協会
	(公財)鹿児島県民総合保健センター
沖縄県	(一財)沖縄県健康づくり財団
	(一社)中部地区医師会　検診センター
	(一財)琉球生命済生会琉生病院
	(一社)那覇市医師会　生活習慣病検診センター

２．第25回精度管理調査外部測定施設一覧

外部機関ｺｰﾄﾞ	外部機関名
002	(株)LSIメディエンス　中央総合ラボラトリー
006	(株)保健科学研究所
008	㈱ビー・エム・エル BML総合研究所
009	(株)エスアールエル　エスアールエル関西ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
012	(一財)東京保健会 病体生理研究所
024	(一社)京都微生物研究所
029	(株)大阪血清微生物研究所
041	エスアールエル　MUQSラボラトリー
050	(株)エスアールエル練馬ラボラトリー
052	(株)第一岸本臨床検査センター
054	(株)愛媛臨検
057	㈱エスアールエル エスアールエル　愛知ラボラトリー
058	(株)四国中検
060	(株)中央微生物検査所
062	㈱昭和メディカルサイエンス総合研究所
065	(株)岡山医学検査センター
069	(株)協同医学研究所
073	(有)久留米臨床検査センター
075	(株)サンリツ
081	(株)北信臨床
083	(株)ナゴヤ医学学術センター
087	㈱ファルコバイオシステムズ東京研究所
088	(一社)半田市医師会 健康管理センター
089	(株)ビー・エム・エル　BML北陸
090	ファルコバイオシステムズ総合研究所
094	(株)メディック　メディック堺
095	(株)CIS熊本中央研究所
100	(株)保健科学　東日本　総合研究所
102	日本医学(株)
109	㈱シー・アール・シー総合研究所
110	八戸市医師会臨床検査センター
111	㈱江東微生物研究所　微研中央研究所つくば
112	(株)福山臨床検査センター
122	(株)近畿予防医学研究所
126	(株)メディック(滋賀)
128	(株)メディック 長野ラボ
129	(株)メディック 静岡ラボ
136	(株)ビー・エム・エル BML 山形
137	(株)京浜予防医学研究所
144	(株)エスアールエル静岡ラボラトリー
146	熊本市医師会検査センター

151	(社)北九州小倉医師会北九州中央臨床検査センター
154	板橋中央臨床研究所
160	上尾中央臨床検査研究所
161	(株)ファルコバイオシステムズ岡山研究所
165	(株)エスアールエル福岡ラボラトリー
168	(株)エスアールエル 宇都宮ラボラトリー
169	(株)ファルコバイオシステムズ東海中央研究所
171	(株)日研医学
172	(株)メディック愛知ラボ
174	(株)江東微生物研究所　微研東北中央研究所
175	(株)戸田中央臨床検査研究所
176	(株)武蔵臨床検査所
185	(公社)宮城県医師会健康センター
190	(株)アルプ
193	QOLセントラルラボラトリーズ
197	(株)LSIメディエンス関西
198	(株)LSIメディエンス神戸
200	(株)保健科学西日本

第25回全衛連臨床検査精度管理調査回答票

施設コード						

Ⅰ 施設(機関)の名称、所在地等

名 称	所在地	TEL: ー ー	記入責任者 氏 名	

Ⅱ 測定装置コード等記入表(注参照)

項目番号	調 査 項 目	測定装置コード	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名	試薬キットの正式名称	検量用試料(キャリブレータ)の種類	トレーサビリティの確認メーカーコード
1	総コレステロール						
2	中性脂肪						
3	尿 酸						
4	クレアチニン						
5	AST						
6	ALT						
7	γ－GT						
8	血 糖						
9	HDLコレステロール						
10	LDLコレステロール						
11	HbA1c						

項目番号	調査項目	測定装置コード	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名
12	尿糖半定量 ＊			
13	尿蛋白半定量＊			
14	尿潜血半定量＊			

＊ 12～14について用手法の場合はAAZ901と記載してください。

項目番号	調査項目	測定装置コード	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名
15	ヘモグロビン			
16	赤血球数			
17	白血球数			
18	ヘマトクリット			
19	血小板数			

注1:測定装置コードの記入について
①調査項目のすべてについて添付の測定装置コード表から該当するコードを記入してください。
その他(999)の場合には使用装置名とメーカー名を記入してください。
②調査項目1～11は試薬キットの正式名称を記入してください。

注2:「検量用試料の種類・トレーサビリティの確認」欄の記入について
①調査項目1～4および8、9は「検量用試料(キャリブレータ)の種類」及び「トレーサビリティの確認」をコード番号で記入してください。
②調査項目5～7はトレーサビリティの確認をコード番号で記入してください(「検量用試料の種類」は表Ⅲの「検量法」に記入してください。)。
③調査項目10は「検量用試料(キャリブレータ)の種類」をコード番号で記入してください。
④調査項目11は「標準液(キャリブレータ)および検量方法の種類」を番号で記入してください。

Ⅲ 測定結果等記入表(注参照)

委託先が同じの場合も、全ての欄に記載して下さい。

調 査 項 目	測定法・単位・測定温度等	測定値	測定	外部機関コード	委託外部機関名
1.総コレステロール	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1～5	単位 mg/dL	自・外	
2.中性脂肪	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1～5	単位 mg/dL	自・外	
3.尿 酸	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1～5	単位 mg/dL	自・外	
4.クレアチニン	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1～5	単位 mg/dL	自・	
5.AST	測定法 / 単位 / 測定温度 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1～5	単位 U/L	自・外	
6.ALT	測定法 / 単位 / 測定温度 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1～5	単位 U/L	自・外	
7.γ-GT	測定法 / 単位 / 測定温度 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1～5	単位 U/L	自・外	
8.血 糖	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1～5	単位 mg/dL	自・外	
9.HDLコレステロール	測定法 / その他	試料6～8	単位 mg/dL	自・外	

注3:測定法、試薬キットに係る記入について
①調査項目1～15は測定法の番号(10は試薬キット名)を記入してください。調査項目5～7は国際単位、測定温度、検量法を番号で記入してください。
②調査項目1～8は試薬キットの製造元の番号を記入してください。その他(99)の場合は製造販売元を記入してください。
③調査項目11はHPLC法分析装置の製造売元、標準品による校正に関する調査を番号で記入してください。また、試料18、19の残余試料でHbA1cを測定し、その測定値も記入してください。また、測定できなかった場合には、その理由も番号で記入してください。
④調査項目12～14は試験紙の製造元を番号で記入してください。その他(99)の場合は製造販売元を記入してください。

施設コード

調査項目	測定法・単位・測定温度等	測定値	測定	外部機関コード	委託外部機関名
10. LDLコレステロール	試薬キット名 ／ その他（ ）	試料6 ． 試料7 ． 試料8 ． 単位 mg/dL	自・外		
11. HbA1c	測定法・試薬キット名 ／ 試料18・19が測定できなかった理由 その他（ ）	NGSP値 試料9 ． 試料10 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 %	自・		
12. 尿糖半定量	測定法 試験紙の製造元 その他（ ）	試料11 試料12 試料13 試料14 試料15	自・外		
13. 尿蛋白半定量	測定法 試験紙の製造元 その他（ ）	試料11 試料12 試料13 試料14 試料15	自・外		
14. 尿潜血半定量	測定法 試験紙の製造元 その他（ ）	試料11 試料12 試料13 試料14 試料15	自・外		

血球検査の測定委託先が同じ場合は最初のみの記入で結構です。

15. ヘモグロビン（Hb）	測定法 その他（ ）	試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 g/dL	自・外		
16. 赤血球数（RBC）		試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 ×10⁴/μL	自・外		
17. 白血球数（WBC）	試料8および試料16～19についての測定上の注意（測定日時の指定）にご注意ください。	試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 ×10²/μL	自・外		
18. ヘマトクリット（Hct）		試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 %	自・外		
19. 血小板（PLT）		試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 ×10⁴/μL	自・外		
20. 平均赤血球容積（MCV）		試料16 ． 試料17 ． 試料18 ． 試料19 ． 単位 fL	自・外		

右欄に注意書①～③をよく読んで試料8および試料18、19の受領日・測定日を記入してください。

試料8は、測定施設に到着後、なるべく早く測定してください。

試料16、17（加工血）、18、19（生血）については以下の点に注意してください。

① 測定までは試料を冷蔵庫（2～8℃）で保存し、測定時は室温に約15分間放置して（室温にもどして）から測定してください。試料16、17は、到着当日か翌日には測定してください。
試料18、19の測定は、できるかぎり平成29年2月9日午前11時から12時の間に測定してください。試料到着が遅れた場合には、午後3時から4時の間に測定してください。下欄に測定時間をご記入下さい。
測定を外部に委託している場合も可能な限り同日時に測定できるよう依頼して下さい。
同日時に測定できない場合は、下欄に測定日、測定時間をご記入下さい。

② 通常検体と同様のモードで測定してください（精度管理（QC）モードは使用しないでください）。

③ 溶血の有無について、静置時の血球および血漿の分離状態、測定時の粒度分布図の状態などを参考にして確認し、下記の選択肢から回答してください。試料に中等度または強度の溶血が認められた場合は事務局にご連絡ください。その他気のついた点はコメント欄にご記入ください。

試料16 ［ ］ 試料17 ［ ］ 試料18 ［ ］ 試料19 ［ ］

溶血認められず・・・1　軽度の溶血あり・・・2　中等度の溶血あり・・・3　強度の溶血あり・・・4

試料8の受領日・測定日	受領日：平成29年2月 ［ ］［ ］日　測定日：平成29年2月 ［ ］［ ］日
試料18・19を2月9日に測定した。午前、午後に○をして下さい。	測定日：平成29年2月9日　午前　11 ～ 12 時に測定 ・ 午後　3 ～ 4 時に測定
試料18・19を2月9日に測定せず。日時を記入して下さい。	受領日：平成29年2月 ［ ］［ ］日　測定日：平成29年2月 ［ ］［ ］日　午前・午後 ［ ］［ ］時

注4：調査票全体の記入についてのお願い

①調査票記入に際しては、調査票（控）の「記入上の注意事項」を必ず読んだ後、調査票（控用）に記入したデータから間違いのないよう記入してください。

②「測定」欄は、自機関で測定した場合は「自」に、外部機関に委託した場合は「外」に○印をつけてください。外部機関に委託した場合は、添付の「平成28年度　臨床検査精度管理調査外部機関一覧」から実際に測定を実施した外部機関コードを「外部機関コード」の欄に記入し、委託外部機関名および電話番号を「委託外部機関名」の欄に記入してください。

③調査用試料8（生血清）、試料18、19（生血液）は、今回も参考試料として配付します。

参加施設コード

控 用

平成28年度全衛連臨床検査精度管理調査票

平成29年2月（第25回）

1. この「調査票」は貴施設の**控用**です。別添の「回答票」を返送してください。

2. 回答票の返送期限は厳守してください。
返送期限平成29年2月17日（金）午後5時必着で下記に郵送してください。（期日に間に合わない場合はファックスでも可としますが、必ず原本を郵送して下さい。）。

調査票郵送および問い合わせ先	公益社団法人　全国労働衛生団体連合会　精度管理事務局 〒108-0014　東京都港区芝4丁目11番5号　田町ハラビル5階 電話　03－5442－5934　　FAX　03－5442－5937

3. 送付する試料　（試料8および試料18、19は参考調査試料です。）

① 総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖測定用	（試料1～5）	凍結品
② HDLコレステロール、LDLコレステロール測定用	（試料6、7）	凍結乾燥品
	（試料8）	冷蔵品（生血清）
③ HbA1c測定用	（試料9、10）	凍結乾燥品
④ 尿糖、尿蛋白、尿潜血 半定量用	（試料11～15）	凍結乾燥品
⑤ ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積測定用	（試料16、17）	冷蔵品
	（試料18、19）	冷蔵品（生血液）

4. 本調査で使用する試料は、**感染性を有するものとして充分注意して取り扱ってください。**なお、**調査終了後は調査の目的以外に使用せず関係法規類に則した適切な廃棄処理**をしてください。

5. 測定は、次ページの「Ⅰ試料取扱い上の注意」を順守して行ってください。
特に試料18、19の測定は指定する測定日時（Ⅰ試料取扱上の注意　Ⅰ－5に記載）に行ってください。
測定結果は日常検体と同じ扱い（1回測定）で得られた結果を回答してください。
測定結果については貴施設での実測値の回答をお願いします。
外部機関に測定を委託している場合は、送付された試料を通常の方法で確認し、通常測定委託している検査機関に測定させ、当該検査機関からの報告を確認後、所定の様式に記入のうえ報告してください。
なお、尿検査は自施設での測定を推奨します。

6. ⑤の試料18、19においてヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積を測定した後、残余の血液により、HbA1cの測定をお願いします。

7. 本調査票は、日本医師会の許可を得て測定法分類、試薬キット（試験紙）の製造元、単位、温度測定などのコードを日本医師会と同一としております。

施　設　名			
調査票記入者名		部署名	

目　　次

精度管理調査 配付試料一覧 …… 290
臨床検査精度管理調査について …… 291
Ⅰ　試料取扱い上の注意 …… 291
Ⅱ　回答票の記入についての注意 …… 293
測定装置コード表 …… 294
測定装置コード記入について …… 303
測定装置コード記入表 …… 304
トレーサビリティの確認について …… 305
酵素活性値記入上の一般的注意 …… 307

記入上の注意事項・検査項目
１．総コレステロール …… 314
２．中性脂肪 …… 316
３．尿酸 …… 318
４．クレアチニン …… 320
５．AST …… 322
６．ALT …… 324
７．γ-GT（γ-GTP） …… 326
８．血糖 …… 328
９．HDL コレステロール …… 330
10．LDL コレステロール …… 332
11．HbA1ｃ …… 334
12．尿糖半定量 …… 336
13．尿蛋白半定量 …… 336
14．尿潜血半定量 …… 336
15．ヘモグロビン …… 338
16．赤血球数 …… 338
17．白血球数 …… 338
18．ヘマトクリット …… 338
19．血小板数 …… 338
20．平均赤血球容積 …… 338

精度管理調査外部機関一覧 …… 340
送付試料番号控え …… 341

《 精度管理調査 配布試料一覧 》

試料番号	1～5	6・7	8	9・10	11～15	16・17	18・19
試料形状	凍結品	凍結 乾燥品	冷蔵品 (生血清)	凍結 乾燥品	凍結 乾燥品	冷蔵品	冷蔵品 (生血液)
試料数量	1.5mL 5本	1.0mL 2本	0.5mL 1本	0.2mL 2本	5.0mL 5本	1.5mL 2本	1.0mL 2本
保存条件 調査項目	凍結 (-40℃以下)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)	冷蔵 (2～8℃)
コレステロール	○						
中性脂肪	○						
尿 酸	○						
クレアチニン	○						
AST	○						
ALT	○						
γ-GT	○						
血 糖	○						
ＨＤＬコレステロール		○	△注 2)				
ＬＤＬコレステロール		○	△注 2)				
HbA1c				○			△注 4)
尿　糖(半定量)					○		
尿蛋白(半定量)					○		
尿潜血(半定量)					○		
ヘモグロビン						○	△注 3)
赤血球数						○	△注 3)
白血球数						○	△注 3)
ヘマトクリット						○	△注 3)
血小板数						○	△注 3)
平均赤血球容積						△注 1)	△注 3)

注 1) 平均赤血球容積は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 2) 試料 8（生血清）による HDL コレステロールおよび LDL コレステロールの調査は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 3) 試料 18、19（生血液）によるヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数および平均赤血球容積までの調査は参考調査です（評価の対象とはなりません。）。

注 4) 試料 18、19（生血液）により HbA1c の測定をお願いします。
この場合、ヘモグロビン～平均赤血球容積を測定した後の残余の血液により、HbA1c の測定をお願いします。この調査も参考調査となります（評価の対象とはなりません。）。

臨床検査精度管理調査について

Ⅰ　試料取扱い上の注意

1　試料 1～5（ヒト凍結血清）について

① 試料は到着後、直ちに凍結保管（-40℃以下）して下さい。－40℃の冷凍庫がない場合は、－20℃を担保できる冷凍庫に保管して下さい。保管期間は到着日から 7 日間です。

② 試料は流水中で融解して下さい。試料が完全に融解するまでに 5～10 分程度かかります。融解の際、ラベルが剥がれる場合がありますので注意して下さい。

③ **測定する際は、試料融解後、静かに転倒混和（20 回程度）し、1 時間以内に測定して下さい。**

④ 試料はヒト血清を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。

⑤ **試料の測定を外部機関に委託する場合は、凍結状態のまま委託して下さい。**
委託先では、－40℃の冷凍庫に保管して下さい。（－40℃の冷凍庫がない場合は、－20℃を担保できる冷凍庫に保管し、なるべく早めに測定して下さい。）

2　試料 6、7（ヒト凍結乾燥血清）および試料 8（ヒト生血清）について

① 試料 6、7 は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。

② 試料 6、7 を溶解する際は、バイアルを回転しながら軽く叩き、蓋や内壁面に付着した粉末を落としてから開栓し、精製水（室温）をホールピペットで 1.0mL 添加して下さい。

③ 試料 6、7 は、溶解を確認後、静かに転倒混和（20 回程度）し、室温で 1 時間程度静置して下さい。

④ 試料 6、7 を測定する際は、再度、静かに転倒混和（数回）して下さい（**試料 6、7 の調製後の安定性は冷蔵保存（2～8℃）で 1 週間です。保管する場合は冷蔵してください。**）。

⑤ **試料 8 は凍結厳禁です。可能な限り到着当日中に速やかに測定して下さい。**

⑥ 試料 8 を測定する際は、室温に 10 分放置後、静かに転倒混和（20 回程度）して下さい。

⑦ 試料 6～8 はヒト血清を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。

⑧ **試料の測定を外部機関に委託する場合、試料 6～7 は溶解後冷蔵（2～8℃）して、試料 8 は冷蔵状態（2～8℃）のまま委託して下さい。**

3　試料 9、10（ヒトヘモグロビン凍結乾燥品）について

① 試料は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。

② 試料はバイアルを回転しながら軽く叩いてバイアルの蓋及び内壁面に付着した粉末を落としてから開栓して下さい。

③ 試料開栓後、室温の精製水またはメーカー指定の溶解液 0.2mL を静かに添加し、栓をして 10 分程度室温で静置して下さい。

④ 試料は、静置後、バイアルを静かに転倒混和し、約 10 分間ローテーターにかける手でゆっくり 20～30 回静かに転倒混和を繰り返すなどして、内容物を完全に溶解して下さい（注意：決して振とうしないで下さい。）。

⑤ 試料の測定は、溶解後、冷蔵庫に 45 分以上静置してから行って下さい。

⑥ 試料の測定は、それぞれの機関で使用されている試薬(または装置)の取扱説明書に従って適切な希釈を行い、希釈後直ちに測定を行ってください。
なお、溶解後の総ヘモグロビン量は約 10g/dL です。

⑦ 試料はヒト血液を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。

⑧ 試料の測定を外部機関に委託する場合は、溶解後冷蔵状態（2～8℃）で委託して下さい。

4　試料 11～15（ヒト凍結乾燥尿）について

① 試料は到着後、冷蔵保管（2～8℃）して下さい。

② 試料は、バイアルを回転しながら軽く叩いてバイアルの蓋及び内壁面に付着した粉末を落としてから開栓して下さい。

③ 試料開栓後、室温の精製水 5.0mL を静かに添加し、栓をして約 5 分室温で静置して下さい。

④ 試料は、**静置後、バイアルを静かに転倒混和し、5 分間ローテーターにかけるか、手でゆっくり、10～15 回静かに転倒混和を繰り返すなどして、内容物を完全に溶解して下さい（注意：決して振とうしないで下さい。）。**

⑤ **試料は、溶解後、室温に放置して、3 時間以内に測定して下さい。測定前には必ず試料を静かに転倒混和して下さい。**

⑥ 試料はヒト尿を原料とし調整していますので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。

⑦ **試料の測定は必ず自施設で行って下さい。**

5　試料 16、17（ヒト加工血液）、試料 18、19（新鮮ヒト血液）について

① 試料 16、17 は、到着後、冷蔵保管（2～8℃）し、**到着当日か翌日には測定して下さい。**

② **試料 18、19 は、測定日時を統一するため、平成 29 年 2 月 9 日 午前 11 時から 12 時の間に測定して下さい。**
試料到着が遅れた場合には、平成 29 年 2 月 9 日 午後 3 時から 4 時の間に測定して下さい。

測定を外部機関に委託している場合は、試料が施設に到着後速やかに測定を依頼し、可能な限り 2 月 9 日午前 11 時から 12 時の間、または 2 月 9 日午後 3 時から 4 時の間に測定してください。

もしも 2 月 9 日午後 3 時から 4 時の間に測定できなかった場合は、受領日・測定日のほかに測定時間も必ずお書きください。

③ 試料 16～19 は、冷蔵庫から取り出した後室温で約 15 分放置し、両手で挟み、擦り合わせるようにして 10 回程度撹拌し、容器の天地を逆にして同様に 10 回程度撹拌してください。

④ **試料 16、17（加工血）については、容器の底に塊がないことを確認してから測定して下さい。容器の底に塊がある場合は上記③の要領で再度撹拌して下さい。**

⑤ 試料は、劣化を防ぐため、室温に戻してから測定までの室温放置時間をできる限り短くして下さい。

⑥ 試料はヒト血液ですので、感染予防上、患者検体と同じように取り扱って下さい。

Ⅱ　回答票の記入についての注意

① 調査票（控用）各頁の左側記入上の注意事項を必ず読んだ後データを回答票に間違いなく記入して下さい。

② 外部機関に委託している場合は、送付された試料のうち、尿試料等の自施設で測定すべき試料を分別した後、外注する試料を通常の方法で確認し、通常測定委託している検査機関に測定依頼し、当該検査機関からの報告を確認後回答票に記入して下さい。

③ 測定法や試薬（キット名）は評価に影響しますので、測定装置、測定法、単位、温度等間違いなく、空欄のないように記入して下さい。また、小数点の位置についても十分注意して下さい。

④ 訂正する場合は、赤線で消去した後、該当欄のすぐ上か、または同じ位置に、訂正した測定値またはコード等を記入して下さい。

⑤ 記入の際は、黒のボールペンを使用して下さい。

測定装置コード表

簡易	コード	企業名	測定装置名
	A．用手法		
	AAZ901		用手法
	B．臨床化学自動分析装置		
	a．フロー方式		
	BAZ999	その他のフロー方式臨床化学自動分析装置	
	b．ディスクリート方式		
	BBA301	エイアンドティー	502X
	BBA302	エイアンドティー	504X
	BBA501	大塚電子，アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-Plus C，C15，C30
	BBA502	大塚電子，アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-Prime
	BBA604	ベックマン・コールター	AU510，560
	BBA605	ベックマン・コールター	AU400，480，600，640，680
	BBA610	ベックマン・コールター	AU2700，5400，5800
	BBA611	ベックマン・コールター	測定項目Na，K，Clのみを対象としてAU400，480，600，640，680:ベックマン・コールター電極
	BBA612	ベックマン・コールター	測定項目Na，K，Clのみを対象としてAU2700，5400，5800:ベックマン・コールター電極
	BBB005	島津製作所	CL-8000
	BBB806	東芝	TBA-20R，20FR，30R，30FR
	BBB808	東芝	TBA-80FR，80FR NEO，80FR NEO2
	BBB809	東芝	TBA-200FR，200FR NEO，TBA-2000FR
	BBB810	東芝	TBA-120FR，40FR Accute，25FR
	BBB812	東芝	TBA-c16000，c8000，c4000，Architect c8000
	BBB813	東芝	TBA-FX8
	BBC105	日本電子	JCA-HRシリーズ(2100，2200，2300，2400)
	BBC106	日本電子	JCA-BMシリーズ(8，12，1250，1650，2250，6010，6050，6070，8020，8030，8040，8060，9010，9020，9030，9130)
	BBC503	日立ハイテクノロジーズ	7020，7040，7050，7060，7070，7080
	BBC504	日立ハイテクノロジーズ	7140，7150，7170，7170S，7180
	BBC505	日立ハイテクノロジーズ	7250，7350，7450
	BBC506	日立ハイテクノロジーズ	7600シリーズ Pモジュール
	BBC507	日立ハイテクノロジーズ	7600シリーズ Dモジュール
	BBC513	日立ハイテクノロジーズ	7600シリーズ用電解質測定ユニット
	BBC514	日立ハイテクノロジーズ	7700シリーズ Pモジュール
	BBC515	日立ハイテクノロジーズ	7700シリーズ Dモジュール
	BBC516	日立ハイテクノロジーズ	7700シリーズ用電解質測定ユニット
	BBC517	日立ハイテクノロジーズ	9000シリーズ
	BBC518	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT 003
	BBC519	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT 008
	BBC520	日立ハイテクノロジーズ,積水メディカル	積水メディカル EV800
	BBC521	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT 006
	BBC522	日立ハイテクノロジーズ	3100
	BBJ702	ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS-INTEGRA700，800
	BBJ703	ロシュ・ダイアグノスティックス	COBAS-INTEGRA 400，400Plus
	BBJ704	ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス Dモジュール
	BBJ705	ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス Pモジュール
	BBJ706	ロシュ・ダイアグノスティックス	モジュラーアナリティクス用電解質測定ユニット
	BBJ707	ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 c502，6000 c501
	BBJ708	ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス b101
	BBJ709	ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000 c702
	BBJ710	ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス 8000用 電解質測定ユニット
	BBN701	古野電気，カイノス	CA-400
	BBN702	古野電気，カイノス	CA-180
	BBN703	古野電気	CA-90
	BBN704	古野電気	CA-400plus

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BBN705	古野電気, カイノス	CA-270, CA-270plus
	BBP201	日立化成, 積水メディカル	日立クリニカルアナライザ S40, M40, E40
	BBP501	エル・エム・エス	スーパーZ 818
	BBR501	シーメンスHCD	ディメンション AR, RxL, ARx, RxL MAX
	BBR502	シーメンスHCD	ディメンション Xpand, Xpand Plus
	BBR503	シーメンスHCD	Viva-E システム
	BBR504	シーメンスHCD	ディメンション RxL-HM, RxL MAX-HM
	BBR505	シーメンスHCD	ディメンション Xpand-HM, Xpand Plus-HM
	BBR506	シーメンスHCD	ディメンション ビスタ 500, 1000T, 1500, 3000T
	BBR507	シーメンスHCD	ディメンション ExL, ExL LM 200
	BBS301	日本光電	CHM-4100, 4120
	BBS701	日本テクトロン	U-240, 240 PLUS
	BBT403	ベックマン・コールター	シンクロン CX4(CE, デルタ, PRO含む)
	BBT404	ベックマン・コールター	シンクロン CX5(CE, デルタ, PRO含む)
	BBT405	ベックマン・コールター	シンクロン LX20, LX20 PRO
	BBT406	ベックマン・コールター	シンクロン LXi725
	BBT407	ベックマン・コールター	ユニセル DxC 600 PRO, 800 PRO
	BBW201	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	TMS-1024/1024H
	BBW202	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 24i(旧プレステージ 24i)
	BBW203	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 12i
	BBW204	東京貿易メディシス, 東京貿易機械, (東京貿易メディカルシステム)	ビオリス 24i プレミアム
	BBW205	東京貿易メディシス, 東京貿易機械	ビオリス 15i ネオ
	BBW206	東京貿易メディシス, 東京貿易機械	ビオリス 50i スペリア
	BBW207	東京貿易メディシス, 東京貿易機械	ビオリス 30i
	BBW401	古野電気, ニプロ	Compolyse-450
	BDP704	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 5,1FS
	BDP705	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 5600, 5600Ⅱ
	BDP706	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 4600
	FAD004	LSIメディエンス(三菱化学メディエンス)	STACIA

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BBZ999	その他のディスクリート方式 臨床化学自動分析装置	
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野:FA/ FB. 免疫血清検査装置(ラテックス免疫測定装置および免疫比濁測定装置)	
		C．遠心方式	
	BCU801	ローム, 三和化学	バナリスト エース
	BCQ901	セントラル科学貿易	Piccolo, Piccolo xpress
	BCZ999	その他の遠心方式 臨床化学自動分析装置	
		D．ドライケミストリー方式	
	BDA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム SP-4410
	BDA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム SP-4420
	BDA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム EZ SP-4430
	BDA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム D-Concept D-02(SD-4810)
	BDA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム D-Concept D-03(SD-4820)
	BDC701	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 3000, 3030
	BDC702	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 5000, 5500
	BDC704	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 3500, 3500p, 3500i, 3500s
	BDC705	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 7000, 7000i, 7000s, 7000「Z」シリーズ
	BDC706	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム 4000, 4000i, 4000s
	BDC707	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX500, NX500i, NX500s
	BDC708	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX500V, NX500sV
	BDP701	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 250, 350, 350PLUS
	BDP704	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 5,1FS
	BDP705	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 5600, 5600Ⅱ
	BDP706	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス	ビトロス 4600

簡易	コード	企業名	測定装置名
	BDT201	ロシュ・ダイアグノスティックス	レフロトロンS, プラス
	FZT201	ロシュ・ダイアグノスティックス, 三和化学	カーディアックリーダー
	BDZ999	その他のドライケミストリー方式臨床化学自動分析装置	
		E．パック方式	
	BEZ999	その他のパック方式臨床化学自動分析装置	
		Z．その他の方式	
	DBU002	ロシュ・ダイアグノスティックス	AVL-9180, 9181, Roche-9180
	HAK304	ラジオメータ	ABL 505
	HAK310	ラジオメータ	ABL 555
	HAK312	ラジオメータ	ABL 700シリーズ
	HAR603	テクノメディカ	GASTAT-3
	HAR604	テクノメディカ	GASTAT-mini
	HAR605	テクノメディカ	GASTAT-5
	HAU002	ロシュ・ダイアグノスティックス	OMNIシリーズ, OMNI EXシリーズ
	HAV203	扶桑薬品	アイスタット 1
	BZZ999	その他の臨床化学自動分析装置	
		G．専用臨床化学分析装置	
		a．グルコース分析装置	
	GAA301	エイアンドティー	GA03R, GA03T, GA03U, GA02U, GA04, GA05, GA06, GA08, GA08Ⅱ, GA08Ⅲ
	GAA303	エイアンドティー, シノテスト	グルコローダー GXR, GXT, NE
	GAA304	旭テクネイオン, シノテスト	グルコローダー MAX

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GAA305	エイアンドティー	GA09
	GAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート&スタット GA-1140
	GAA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート&スタット GA-1160
	GAA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オート&スタット GA-1120, 1122
S	GAA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	グルコカード GT-1650, 1660
	GAA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスグルコース GA-1170, 1171,1172
	GAA708	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスグルコース GA-1150, 1151, 1152,1153
S	GAA709	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	グルコカード ダイアメーター, ダイアメーターα, マイダイア
S	GAA710	パナソニックヘルスケア, アークレイマーケティング	グルコカード G+メーター
S	GAA711	パナソニックヘルスケア, アークレイマーケティング	グルコカード Gブラック
	GAA712	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ポケットケムBG PG-7320
	GAB601	東亜ディーケーケー	GLU-2
	GAB602	東亜ディーケーケー	GLU-1
	GAC901	堀場製作所	アントセンスⅡ
	GAC902	堀場製作所, フクダ電子	アントセンスⅢ
	GAC903	堀場製作所	アントセンス ロゼ
	GAC904	堀場製作所, フクダ電子, 栄研化学	アントセンス デュオ
	GAJ704	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック コンパクトプラス, アキュチェック コンパクト黒
S	GAJ705	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック アビバ, アビバ ナノ
S	GAJ706	堀場製作所	ケアシスト
S	GAJ708	堀場製作所	ケアシスト Ⅱ
S	GAJ709	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック モバイル
S	GAJ710	ロシュ・ダイアグノスティックス	アキュチェック STメーター
	GAK101	アムコ	ヘモキュー Glu
	GAK301	ラジオメータ	HemoCue Glucose201DMRTアナライザ
	GAK302	ラジオメータ	HemoCue Glucose201RTアナライザ
	GAK303	ラジオメータ	HemoCue Glucose201DMアナライザ
	GAK304	ラジオメータ	HemoCue Glucose+アナライザ
S	GAL901	グンゼ, エーディア(三光純薬)	ライフチェック
S	GAN405	バイエル薬品, パナソニック ヘルスケア	アセンシア ブリーズ2

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GAQ201	協和メデックス	DM-JACK, DM-JACKⅡ, DM-JACK Ex
	GAQ901	セントラル科学貿易	APECグルコースアナライザー
S	GAR405	アボットジャパン, オムロンヘルスケア	プレシジョン エクシード
S	GAR406	アボットジャパン	プレシジョン エクシード プロ
S	GAR407	アボットジャパン	フリースタイルプレシジョンネオ
S	GAR408	アボットジャパン	フリースタイルフリーダム ライト
	GAR409	アボットジャパン	プレシジョン エクシードH
	GAR410	アボットジャパン	フリースタイルプレシジョンプロ
	GAR411	アボットジャパン	フリースタイルプレシジョンネオH
S	GAR702	テルモ	メディセーフボイス GRV-1
S	GAR703	テルモ	メディセーフミニ GR-102
S	GAR704	テルモ	メディセーフフィットプロ
S	GAR705	テルモ	メディセーフフィット
S	GAR706	テルモ	メディセーフフィットボイス
S	GAR707	テルモ	メディセーフフィットスマイル
S	GAS101	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーター
S	GAS102	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーター フラッシュ
S	GAS103	ニプロ	ニプロ フリースタイルメーター フリーダム
S	GAS104	ニプロ	ニプロ ケアファストメーター
S	GAS107	アボットジャパン, ニプロ	ニプロ フリースタイル フリーダム ライト
S	GAS108	ニプロ	ニプロ ケアファストC
S	GAS109	ニプロ	ニプロ トゥルーピコ
S	GAS110	ニプロ	ニプロ ケアファストR
S	GAS401	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチ ウルトラビュー
S	GAS402	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチ ウルトラ
	GAS403	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチベリオビュー
	GAS404	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチベリオプロプラス
	GAS405	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ワンタッチベリオIQ
	GAU101	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ エクスプレス
	GAU102	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップ コネクティビティ
S	GAU103	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ XP2
	GAU104	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ CT2
	GAU105	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップエクスプレス EJ
	GAU106	ノバ・バイオメディカル	スタットストリップエクスプレス 900
	GAU107	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ XP
	GAU108	ノバ・バイオメディカル, ニプロ	ニプロ スタットストリップ CT
	GAU109	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ XP3
	GAU110	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ CT3
	GAV001	日科機バイオス	YSI-2300 STAT PLUS
	GAV301	ジャイマ	コピーライトエージェント
S	GAV501	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト エース
S	GAV502	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト エース R
S	GAV503	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテスト PRO R
S	GAV505	パナソニックヘルスケア, 三和化学	グルテスト Neo スーパー
	GAV506	アークレイファクトリー, 三和化学	グルテストエブリ
S	GAV507	パナソニックヘルスケア, 三和化学	グルテストミント
S	GAV508	パナソニックヘルスケア, 三和化学, アークレイマーケティング	グルテストNEOアルファ
	BDU301	テラメックス	BBx
	GBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスハイブリッド AH-8280
	GBA708	アークレイファクトリー, アークレイ	アダムスハイブリッド AH-8290
	GBK401	塩野義製薬	チェッカートリーダー
	HAR603	テクノメディカ	GASTAT-3
	HAR604	テクノメディカ	GASTAT-mini
	HAR609	テクノメディカ	GASTAT-603ie
	HAR615	テクノメディカ	GASTAT-1830
	HAR616	テクノメディカ	GASTAT-1835
	HAV203	扶桑薬品	アイスタット 1

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GAZ999	その他のグルコース分析装置	
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野:B. 臨床化学自動分析装置、D. 電解質測定装置、H. 血液ガス分析装置	
		b. ＨｂＡ１ｃ測定装置	
	GBA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ハイオートA1c HA-8150
	GBA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1c HA-8160, HA-8170
	GBA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1c HA-8180
	GBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスハイブリッド AH-8280
	GBA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1c HA-8181
	GBA708	アークレイファクトリー, アークレイ	アダムスハイブリッド AH-8290
	GBA709	積水メディカル, アークレイマーケティング	アダムスA1c ミニ HA-8410
	GBA710	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1cライト HA-8380
	GBA711	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1c HA-8180V
	GBA712	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	アダムスA1c HA-8180T
	GBB501	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	Variant Ⅱ, Variant Ⅱ Turbo
	GBB502	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	D-10システム
	GBB906	東ソー, 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G7
	GBB907	東ソー, 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G8
	GBB908	東ソー, 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G9
	GBB909	東ソー, 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723GX
	GBB910	東ソー, 栄研化学, 日本ケミファ	HLC-723G11
	GBC501	日立ハイテクノロジーズ	L-9100
	GBR201	積水メディカル	RC20
	GBJ801	シーメンスHCD	DCA2000, DCA2000+, DCAバンテージ
	GBK201	アリーアメディカル, ニプロ	Quo-Lab
	GBK401	塩野義製薬	チェッカートリーダー
	GBN601	サカエ, 協和メデックス	A1c GEAR K
	GBN602	サカエ, 協和メデックス	A1c iGear K
	GBV501	サカエ, 三和化学	A1c GEAR S
	GBV502	サカエ, 三和化学	A1c iGear S
	GBN401	バイエル薬品	A1CNowプラスモニタ
	BBJ708	ロシュ・ダイアグノスティックス	コバス b101
	BCU801	ローム, 三和化学	バナリスト エース
	FAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム IM SI-3510, 3511
	FZW801	エル・エム・エス, 東洋紡	ニコカードリーダーⅡ
	FAU801	ローム, アークレイマーケティング	スポットケムバナリスト SI-3610, SI-3620
	GAQ201	協和メデックス	DM-JACK, DM-JACKⅡ, DM-JACK Ex
	GBZ999	その他のHbA1c測定装置	
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野:B. 臨床化学自動分析装置	
		Z. その他の専用臨床化学分析装置	
	GZA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム BA PA-4130, PA-4140
	GZA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ラクテートプロ LT-1710, 1730
	GZA705	アルファテクノ, アークレイマーケティング	エムシーファン HR300
	GZA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム IL SL-4720
	GZA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スポットケム フローラSF-5510

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GZB901	東ソー	HLC-725CAⅡ
	GZB902	東ソー	HLC-726VMAⅢ
	GZB903	東ソー	HLC-729LPⅡ
	GZB904	東ソー	HLC-725CAⅢ
	GZC102	日本電子	JLC-500/V
	GZC501	日立ハイテクノロジーズ	L-8930
	GZC701	富士フイルム, 富士フイルムメディカル	富士ドライケム 100N
	GZC703	富士フイルム	富士ドライケム IMMUNO AG1
	GZC801	富士レビオ	マグストリーム 1000, AS, HT
	GZD101	和光純薬	Quick Run, Quick Run(識別記号:Ⅱ)
	GZD501	資生堂	NANOSPACE GA MD-1
	GZJ701	ロシュ・ダイアグノスティックス	アクトレンド GCT
	GZJ702	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ シンフォニー(型式:SYM1)
	GZJ703	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ シンフォニー(型式:SYM2)
	GZJ704	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ ベンチマーク ULTRA
	GZJ705	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ XTシステム ベンチマークモジュール
	GZJ706	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ XTシステム ディスカバリーモジュール
	GZJ707	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ HX ベンチマークモジュール
	GZJ708	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ NX-SSモジュール
	GZJ709	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ ベンチマークGX
	GZJ710	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ ベンチマークSS
	GZJ711	ロシュ・ダイアグノスティックス	ベンタナ HE 600
	GZM301	ヒロセ電子, 和光純薬	FOBITWAKO, FOBITWAKO(識別記号:Ⅱ)
	GZP304	多摩精機, 栄研化学	便潜血用全自動分析装置 OCセンサー μ
	GZP305	日立アロカ, 栄研化学	便潜血用全自動分析装置 OCセンサーneo
	GZP308	日立アロカ, 栄研化学	OCセンサー DIANA
	GZP309	多摩精機, 栄研化学	OCセンサー io
	GZP310	日立製作所, 栄研化学	OCセンサー PLEDIA
	GZQ201	協和メデックス	HM-JACK
	GZQ202	協和メデックス	HM-JACK Plus
	GZQ203	協和メデックス	i6000, OptiMax
	GZQ204	協和メデックス	HM-JACK arc
	GZQ205	協和メデックス	HM-JACK SP
	GZR001	ウイスマー研究所, ウイスマー	Free Radical Elective Evaluator
	GZR601	テクノメディカ	ポケットリピッド
	GZR602	テクノメディカ	アミノサイン
	GZS501	大塚電子, アルフレッサファーマ	ヘモテクト NS-1000
	GZQ502	フクダ産業株式会社, エーディア(三光純薬)	フォトBHメーターⅥ
	GZS901	日本ベクトン・ディッキンソン	BD ベリター システム リーダー
	GZS902	日本ベクトン・ディッキンソン	BD トータリス スライドプレップ, トータリス マルチプロセッサー
	GZT801	利康商事	フィスケ自動浸透圧計 210
	GZU101	ノバ・バイオメディカル	スタットセンサー i
	GZU102	ノバ・バイオメディカル	スタットセンサー エクスプレスi クレアチニン
	GZU105	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ エクスプレス グルコース ケトン
	GZV501	アークレイファクトリー, 三和化学	ケトメータ N
	BDC709	富士フイルム, 富士フイルムメディカル, 和光純薬	富士ドライケム NX10N
	FDM401	テカンジャパン, 医学生物	サンライズ プレートリーダー
	GAU110	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ CT3
	GAU109	ノバ・バイオメディカル	ニプロ スタットストリップ XP3
	GZZ999	その他の専用臨床化学分析装置	
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野:B. 臨床化学自動分析装置	

J. 血球計数装置

a. 全自動、b. 半自動

簡易	コード	企業名	測定装置名
	JAA301	エイアンドティー	MYTHIC18 (J)

簡易	コード	企業名	測定装置名
	JAA302	エイアンドティー	MYTHIC22OT (J), 22CT (J)
	JAA701	ベックマン・コールター, アークレイマーケティング	スポットケムBC SB-1410
	JAA702	日本光電, アークレイマーケティングアークレイ	スポットケムCL SB-1420
	JAA703	日本光電, アークレイマーケティングアークレイ	スポットケムCL SB-1430
	JAA704	日本光電, アークレイマーケティングアークレイ	スポットケムCL SB-1440
	JAA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	thinka CB-1010
	JAB502	シスメックス	Eシリーズ(2000, 2500, 3000, 4000, 5000)
	JAB504	シスメックス	K-800, 1000, 2000
	JAB505	シスメックス	NEシリーズ(4500, 6000, 7000, 8000)
	JAB507	シスメックス	SE-9000, SE-9000/RAM-1
	JAB508	シスメックス	SF-3000
	JAB509	シスメックス	KX-21, 21N, 21NV
	JAB511	シスメックス	K-4500
	JAB512	シスメックス	XE-2100, 2100L, 2100D, 5000
	JAB514	シスメックス	XT-2000i, 1800i, 4000i
	JAB515	シスメックス	pocH-100i, 100iV
	JAB516	シスメックス	XS-1000i, 800i, 500i
	JAB517	シスメックス	XN-1000, 2000, 3000, 9000
	JAB518	シスメックス	XP-100, 300
	JAB519	シスメックス	XN-350, 450, 550
	JAC905	堀場製作所	MICROS (LC-150, 151), FL-250 CBC, LC-550
	JAC908	堀場製作所, フクダ電子	LC-170CRP, LC-175CRP, FL-270CRP, FL-275CRP
	JAC910	堀場製作所	PENTRA 60(LC-5000), PENTRA 80(LC-5501J), PENTRA XL80(LC-5601J)
	JAC918	堀場製作所, フクダ電子	FL-278CRP, LC-178CRP
	JAC919	堀場製作所, フクダ電子	LC-667CRP, 687CRP, 767CRP
	JAC911	堀場製作所	Pentra MS CRP
	JAC912	堀場製作所, フクダ電子	LC-660, LC-661
	JAC916	堀場製作所, (シーメンスHCD)	ADVIA 60
	JAJ005	ベックマン・コールター	マックスエム・シリーズ, コールターHmX, コールターLH500
	JAJ008	ベックマン・コールター	Gen・S, STKS, Gen・S System 2
	JAJ009	ベックマン・コールター	AcT8, AcT10, AcTdiff
	JAJ010	ベックマン・コールター	コールターAcT5diff A/L, AcT5diff C/P
	JAJ011	ベックマン・コールター	コールターLH700シリーズ, コールターLH780
	JAJ012	ベックマン・コールター	ユニセルDxH600, ユニセルDxH800
	JAJ803	シーメンスHCD	アドヴィア 120, 2120, 2120i
	JAJ804	シーメンスHCD	アドヴィア 560
	JAJ805	シーメンスHCD	アドヴィア 360
	JAK101	アムコ	ヘモキューHb
	JAK301	ラジオメータ	HemoCue Hb201DM アナライザ
	JAK302	ラジオメータ	HemoCue WDC アナライザ
	JAK303	ラジオメータ	HemoCue WDC DIFF アナライザ
	JAP603	エルマ販売	PCE-310
	JAR403	アボットジャパン	セルダイン 3700
	JAR405	アボットジャパン	セルダイン 3200
	JAR408	アボットジャパン	セルダイン サファイア
	JAR409	アボットジャパン	セルダイン ルビー
	JAS301	日本光電	MEK-6108, 6208, 6308
	JAS302	日本光電	MEK-6318, 7222
	JAS303	日本光電	MEK-6400, 6420, 6500, 6510
	JAS304	日本光電	MEK-7300
	JAS305	日本光電	MEK-8222
	JAS306	日本光電	MEK-9100
	JBP601	エルマ販売	PCE-120, 170
	JBS301	日本光電	MEK-5103, 5105, 5204, 5207, 5216
	JBS302	日本光電	MEK-5108, 5208
	JZZ999		その他の血球計数装置

簡易	コード	企業名	測定装置名
	L. 尿検査装置		
	a. 全自動、b. 半自動		
	LAA701	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	スーパーオーションアナライザ SA-4230, 4250
	LAA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	PSP AUTO, PSP-3110, 3120
	LAA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションマックスAX-4280, 4030, 4060
	LAA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションマスター UM-3410
	LAA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションアイキュー IQ-5210
	LAA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションハイブリッド AU-4050
	LAB501	シスメックス	UF-50,100, 110i
	LAB502	シスメックス	UF-1000i
	LAB504	シスメックス	URISYS 2400
	LAB506	シスメックス	UX-2000
	LAB507	シスメックス	UF-3000, 4000, 5000
	LAC502	日立ハイテクノロジー	6700, 6800
	LAC801	富士レビオ	アイキュー 200スプリント, アイキュー 200エリート
	LAD101	和光純薬	ZD-401, 501, 601, RM-7000
	LAD701	TOTO, 大和ハウス工業	尿糖検査機ウエルユー Ⅱ, TOTO体温計付き尿糖計
	LAJ501	日立ハイテクノロジーズ, シスメックス	Super UA
	LAJ802	シーメンスHCD	クリニテック アトラス, クリニテック アトラス XL
	LAR602	テクノメディカ	UA・ROBO-700 i
	LAR603	テクノメディカ	UA・ROBO-1000AD
	LAR604	テクノメディカ	UA・ROBO-R250A
	LAR801	ミユキエレックス, 東洋紡, エイアンドティー	U-SCANNER, U-SCANNER Ⅱ, USCANNER(E)
	LAR802	ミユキエレックス, 東洋紡	USCANNER plus
	LAT801	利康商事	オズモメーター3250, 3900, 3320, 210
	LAU301	テラメックス, 栄研化学	US-3100, US-3100R, US-3100R Plus, US-3500, US-3500 MS
	LAU302	テラメックス, 栄研化学	US-3200
	LAU303	テラメックス, 栄研化学	US-3300

簡易	コード	企業名	測定装置名
	LBA501	大塚電子, 協和メデックス	UR-S600
	LBA702	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ミニオーションアナライザ MA-4240
	LBA703	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	マイクロオーションアナライザ MA-4260
	LBA704	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションジェット AJ-4270
	LBA705	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーション ミニAM-4290
	LBA706	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	ポケットケムUA PU-4210, 4010
	LBA707	アークレイファクトリー, アークレイマーケティング	オーションイレブン AE-4020, AE-4021
	LBB501	シスメックス	UA-1000, 2000
	LBB505	シスメックス	URISYS 1800
	LBD101	和光純薬	プレテスター RM405, 505, 505L, 605, 805, 905, 6050
	LBJ501	ロシュ・ダイアグノスティックス, シスメックス	Miditron M
	LBJ801	シーメンスHCD	クリニテック 10, 50, 100
	LBJ803	シーメンスHCD	クリニテック 200, 200+
	LBJ804	シーメンスHCD	クリニテック 500
	LBJ805	シーメンスHCD	クリニテック ステータス, クリニテック ステータスプラス
	LBJ806	シーメンスHCD	クリニテック アドバンタス
	LBJ807	シーメンスHCD	クリニテック ノーバス
	LBP601	エルマ販売	臨床屈折計, デジタル臨床屈折計SU-202
	LBT202	ロシュ・ダイアグノスティックス	ユリラックス S
	LBT203	ロシュ・ダイアグノスティックス	ユリシス 1100
	LBU301	テラメックス, 栄研化学	US-2100R, US-2200
	LBU302	テラメックス, 栄研化学	US-1000
	LBU601	アタゴ	アナログ/デジタル尿比重屈折計(UR-D,U, UG-D, ユリコン:URC-S,J E, PAL-09S, MASTER-URC/Ja, MASTER-URC/JM)
	LBU602	アタゴ	臨床用屈折計 SPR-T2, SPR-NE, T2-SE, SUR-JE, MASTER-URC/Ja, MASTER-URC/JM)
	LBU901	和光純薬	ユリペット, ユリペットⅡ D
	LBV501	三和化学	Uテスター
	LBV502	三和化学	ビジュアルリーダー
	LBV503	三和化学	ビジュアルリーダーⅡ

簡易	コード	企業名	測定装置名
	GZD101	和光純薬	Quick Run, Quick Run(識別記号:Ⅱ)
	LZZ999	その他の尿検査装置	
		該当する装置がこの項にない場合は、下記の関連分野を検索してください	
		関連分野:B. 臨床化学自動分析装置、C. 医用分光光度計、G. F4専用臨床化学分析装置	

測定装置コード記入について

測定装置コードは評価上大変重要です。

項目によっては評価できなくなりますので、必ず間違いのないように記入してください。

記入に際しては測定装置コード表をよく確認し、安易に「その他」としないでください。

〔記入方法〕

- ▶ 用手法の場合には、検査の分野に関係なく「AAZ901」と測定装置コード記入表に記入してください。
- ▶ 測定装置コード表から、使用した測定装置名に該当するコードを測定装置コード記入表に記入してください。
- ▶ もし、調査項目に関連した分類の中に該当する装置が見つからない場合には、装置コード表に示してある関連分野の中から測定装置コードを選んでください。
- ▶ その他の場合には、使用装置名ならびに装置メーカー名を必ず記入してください。
- ▶ 自己血糖測定装置(SMBG)につきましては評価対象外です。該当する機器は、測定装置コード表に「S」と示しております。

測定装置コード記入表

調 査 項 目		測定装置コード	その他の場合のみ記入	
			使用装置名	メーカー名
1	総コレステロール			
2	中性脂肪			
3	尿酸			
4	クレアチニン			
5	ＡＳＴ			
6	ＡＬＴ			
7	γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）			
8	血糖			
9	ＨＤＬコレステロール			
10	ＬＤＬコレステロール			
11	ＨｂＡ１ｃ			
12	尿糖(半定量)			
13	尿蛋白(半定量)			
14	尿潜血(半定量)			
15	ヘモグロビン			
16	赤血球数			
17	白血球数			
18	ヘマトクリット			
19	血小板数			
20	ＭＣＶ			

トレーサビリティの確認について

1. トレーサビリティの確認に関する調査

（トレーサビリティの概念は、補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」、【トレーサビリティとは】をご参照ください。）

以下の調査項目についてトレーサビリティの調査を行います。

AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、血糖、HDLコレステロール、LDLコレステロール。

2. 調査対象となる標準品

各項目共に、標準品の供給元（認証元）を中心に便宜的に分類してあります。次ページの表を参考に、記入してください。

（JCCLSの標準品、NISTの標準品、HECTEFの標準品、ReCCSの標準品、企業の標準品その他の標準品）

3. 標準品の種類

補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」の図1に示すように、日常検査法の測定結果から順に上位の標準物質、規準測定操作法に途切れなく遡ることができる事をトレーサビリティが確保されているといいます。各校正物質は以下の通りです。

- ・一次校正物質　：高次の標準物質、国際的に認知された標準品などで認証値と不確かさが表記されています。（WHO、IRMM、JCCLS、NISTなどから供給されています。）
- ・二次校正物質　：一次校正物質にトレーサビリティがあり、実試料標準物質など（HECTF、ReCCS)があります。
- ・製造業者実用校正物質　：メーカーが持つ社内規準物質（高次の校正物質を使用する場合もあります。）で、主に製造業者製品校正物質の値付けに使用されます。
- ・製造業者製品校正物質　：日常検査で使用するキャリブレータです。

4. 調査設問に対する記入上の注意

・日常検査において、メーカー指定の製造業者製品校正物質によりキャリブレーションを実施している場合、このキャリブレータを検体として測定した場合（打ち返し）には、企業の標準品にてトレーサビリティを確認したことになりますので、企業の標準品のコード番号（7）を記入してください。

・それ以外に上位の一次校正物質、二次校正物質（次ページの表に記載されている標準品）を購入し、実施した場合にはそれぞれ供給元（認証元）の標準品のコード番号を選択して下さい。（この場合、標準品に添付されている認証書を確認することで判別は可能です。）

・これらいずれの確認を実施していない場合には、「実施していない」に該当するコード番号（9）を記入してください。

トレーサビリティの確認は、毎日実施する必要はありませんが、年に数回行って内部精度管理でその測定値が厳密に管理されていれば、精度管理調査の直前に確認操作をしていなくても、トレーサビリティがとれていると判断します

5. 組織の略号

WHO(World Health Organization)
JCCLS (Japanese Committee for Clinical Laboratorory Standards、日本臨床検査標準協議会)
NIST (National Institute of Standards and Technology、米国)
IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements、旧BCR、欧州連合)
HECTEF (Health Care Technology Foundation、一般社団法人 HECTEF)
ReCCS (Reference Material Institute for Chemistry Standards、検査医学標準物質機構)

6. 標準品に関する参考資料(本精度管理調査に関連する項目のみ記載)

JCCLSの標準品(供給機関はJCCLSあるいはHCTEFあるいはReCCS)

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
JCCLS CRM-001	常用参照標準物質:JSCC 常用酵素	AST、ALT、γ-GT

NISTの標準品

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
SRM 909	記号／略号と同じ	総コレステロール、中性脂肪、クレアチニン、尿酸
SRM 965	記号／略号と同じ	ブドウ糖
SRM 1951	記号／略号と同じ	総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
SRM 1952	記号／略号と同じ	総コレステロール

ReCCSの標準品

記号／略号	標準物質名	調査対象項目
JCCRM 223	コレステロール・中性脂肪常用標準物質	総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
JCCRM 224	脂質測定用常用参照標準物質	中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
JCCRM 411	IFCC法HbA1c測定用常用参照標準物質	HbA1c
JCCRM 423	HbA1c認証実用標準物質	HbA1c
JCCRM 521	含窒素・グルコース常用標準物質	ブドウ糖、尿酸、クレアチニン
JCCRM 211	コレステロール一次実試料標準物質	総コレステロール
JCCRM 121	イオン電極用認証実用標準物質	ブドウ糖
JCCLS 021	尿酸測定用JCCLS認証標準物質	尿酸

酵素活性値記入上の一般的注意

1. 測定法：標準化対応法については次ページからの補足を読んで、よく理解して下さい。この概念は、1997年から利用されており、例えばJSCC常用基準法で測定した値が検量物質などにより伝達される場合、JSCC標準化対応法となります。測定キットの説明書を読んで回答して下さい。わからない場合は、是非、該当するメーカーにお問い合わせ下さい。標準化対応法の考え方は、常用参照標準物質：JSCC常用酵素・ChE JCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002もしくは企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）を用いてトレーサビリティを確認している場合だけでなく、勧告法準拠法を使用し実測Kファクターを利用して37℃（管理されていること）で測定している場合も含むことに留意して下さい。標準化対応法であるにもかかわらず、それ以外を選んでいる施設が少なくないので、この点に関しては試薬メーカーにおたずね下さい。

2. 単位：標準化対応法、もしくは該当する測定法の**国際単位**で記載して下さい。

3. 測定温度：標準化対応法は37℃で測定することが前提です。測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。

4. 検量法、トレーサビリティのチェック：標準化対応法を使用する場合、日常分析でどのようにトレーサビリティをチェックしているかを記載する欄です。国際標準品、国内標準品、企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）などのいずれかを選んで下さい。次ページからの補足資料の図2に示したように、トレーサビリティ連鎖上、日常検査法をすぐ上位の製造業者内標準測定操作法にトレースするためには企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）で十分です。ただし、企業の測定試薬が正しい測定体系を示しているかを検証するためにも、JCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002でトレーサビリティの確認をすることも必要です。

5. 以上の記載を補足するために、資料として、検量法の確認記入フロー、トレーサビリティの確認記入フロー、分類コード入力のためのQ&Aを示してあります。さらに各項目の追加資料として、該当酵素の測定法分類記入フローを設けました。ただし、基本骨格について説明しただけですので、概念・考え方の参考に使用するだけにして下さい。また、不足している情報、不明なことは使用している試薬メーカーにおたずね下さい。

補足「酵素項目の標準化対応法とトレーサビリティについて」

【はじめに】

酵素活性測定は、その量を測定するものではなく活性値として測定されるため、使用する測定系により得られる結果は異なる。特にアミラーゼについては、日本国内で十数種の基質が存在し、得られる結果は数倍も異なり混乱を呈していた。したがって、酵素活性測定の標準化を実践するためには、基準測定操作法・標準物質の設定を行い、トレーサビリティ体系を組むことが必須であった。

日本国内では、日本臨床化学会（JSCC）によってヒト血清中の酵素活性測定の勧告法、および常用酵素標準物質の規格が順次示され、1998年には日本臨床検査標準協議会（JCCLS）により、我が国で最初の**常用酵素標準物質（JC・ERM）**が作製され、頒布が開始された。現在は常用参照標準物質：JSCC常用酵素JCCLS CRM-001と改名され第6ロットまでリリースされ、また、2006年5月よりコリンエステラーゼ常用酵素標準物質（JC・ERM for pseudo-ChE）（現在の名称：常用参照標準物質：ChE JCCLS CRM-002）の頒布も開始され、我が国の臨床検査における酵素活性測定の標準化は格段の進歩を遂げている。


しかしながら、日本医師会精度管理調査では、毎年、誤記入が後を絶たない。これはJCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002の使用方法、用語の解釈など、理解の曖昧さに起因していると考えられる。そこで、トレーサビリティの確認とJSCC標準化対応法の概念について説明する。

【トレーサビリティとは】

通常各試薬メーカーは、国際的、もしくは国家において、権威ある組織が作成した一次基準測定操作法やそれによって値付けられた一次校正物質を基に、その表示値を製造業者の校正物質に伝達し、最終的には臨床検査室で使用される日常検査法に伝達する。このような場合、最終使用者による測定結果は、製造業者による測定操作法とは逆の方向を経て、標準物質が本来定めた表示値に戻ることが可能となる。これが計測に係わる**トレーサビリティ**であり、これにより日本のみならず国際的にも測定結果の整合性が確保できる。

このトレーサビリティの確保は、図1で示すごとく最終的な日常検査法による患者試料の測定結果から最上位の一次校正物質、一次基準測定操作法まで各階層を経て、とぎれなく校正と値付けが繰り返される。


図1．校正の階層段階全体とSI単位への計量学的トレーサビリティ

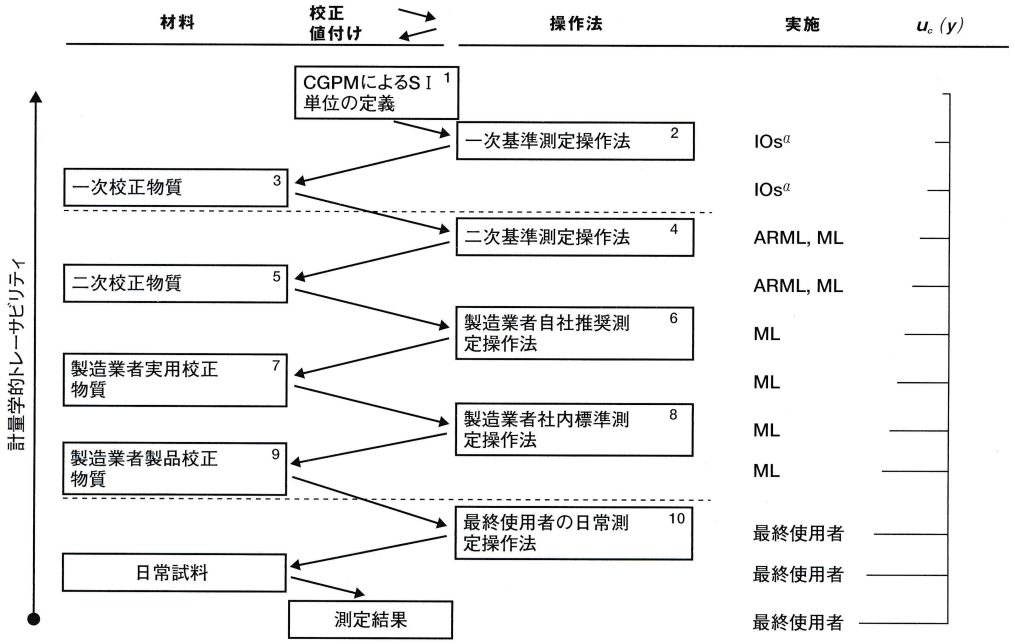

IO s = International Scientific Organization （国際学術団体）
ARML = Accredited Reference Measurement Laboratory （認定標準測定検査室）*
ML = Measurement Laboratory （測定検査室）*
（＊本図のARMLとMLは、一般に製造業者の値付けラボを指す）

日本国内における酵素活性測定においては、先述したようにそれぞれJSCC/JCCLS常用基準法とJCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002が存在するので、トレーサビリティ体系は図2のように示すことができる。このような測定体系中で機能する日常検査法をJSCC標準化対応法という。

図2．わが国における血清酵素活性測定のトレーサビリティ連鎖

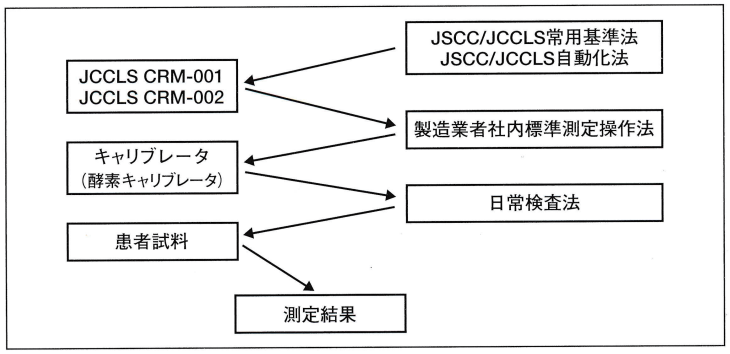

【JSCC標準化対応法とは】

JSCC標準化対応法とは、血清酵素活性測定のための日常検査法のうち、その測定法による患者試料(患者血清)の測定値が、JSCC/JCCLS常用基準法による測定値と比例互換性(コミュータビリティ)が得られることが保証された測定法である。具体的には、日常検査法の検量をキャリブレータ(酵素キャリブレータ)で行うことで、患者血清の測定値が最終的にJSCC/JCCLS常用基準法による測定値で表すことができるものをいう。したがって図2のごとくの測定体系を組んでいる日常検査法のことである。JSCC標準化対応法はトレーサビリティがとれていることのバリデーション(妥当性確認)がされていなくてはならない。通常はメーカーによりJSCC標準化対応試薬として準備され、かつメーカーが指定した企業のキャリブレータ(酵素キャリブレータ)を用いて、メーカーのSOP(標準操作法)にしたがって実施することになる。

JSCC標準化対応法は、JSCC/JCCLS常用基準法の試薬条件(試薬組成、試薬濃度など)の指定はないが、ヒト血清試料の測定値がJSCC/JCCLS常用基準法による測定値と合致することが保証されなければならない。

一般に日常検査法で得られる測定値のトレーサビリティの取り方は大別して2つある。

1)「ヒト試料とJCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002の反応性が同じと確認された日常検査法の検量を、直接JCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002で行い、その値を用いてキャリブレータ(酵素キャリブレータ)へ値付けする方法」である。このとき、ヒト試料とJCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002、キャリブレータ(酵素キャリブレータ)がJSCC/JCCLS標準化対応法に対して、反応性が同じであることが必須条件となる。

2)「日常検査法の検量を実測Kファクターで行って得られたヒト試料の測定値と、同一試料をJSCC/JCCLS常用基準法あるいはJSCC/JCCLS自動化法で得られた測定値を、相関分析によってJSCC/JCCLS常用基準法あるいはJSCC/JCCLS自動化法に合わせる(Working Calibratorを使用する方法)」。JCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002はヒト由来酵素を使用しているが患者試料中の酵素と特性が同じではないため、日常検査法(試薬キット)によってはJSCC/JCCLS常用基準法あるいはJSCC/JCCLS自動化法に対して酵素の反応性が一致しない場合がある。JSCC標準化対応法は、患者試料(ヒト血清)の測定値を最終的にJSCC/JCCLS常用基準法の値にトレースするので、ヒト血清の測定値がJSCC/JCCLS常用基準法に一致していれば、JCCLS CRM-001およびJCCLS CRM-002の表示値と日常検査法(試薬キット)により直接測定したときの測定値が一致しなくとも許容される。内部・外部精度管理で使用される試料も、試料の特性によっては通常の患者試料と反応性が異なり、ヒト血清と同様な反応性を示さないことがある。このような精度管理用の試料は、厳密にいうとJSCC標準化対応法でのトレーサビリティを正しく把握することができないことになるが、大規模調査では生血清を使用できないため、代用しているのが現状である。

【参考資料】


・㈶機械システム振興協会：医療診断システム構築のための基盤整備に関するフィージビリティスタディ報告書(システム開発16-F-14)．2005;03:11-13
・日本臨床化学会学術連絡委員会：常用酵素標準物質の規格(1996-02-15)．臨床化学 1996;25:135-148
・日本臨床検査標準協議会認証委員会：日本・常用酵素標準物質(Lot004)使用ガイド(Ver1.0)．日本臨床検査標準協議会会誌 2004;19:15-16

【分類コード入力のためのQ&A】

＊ 分類コードを入力する前に、必ず使用されている試薬の添付文書、キャリブレータの添付文書、表示値表をよく確認して下さい。


Question	Answer
測定結果に従来法との相関補正式などの係数を設定している場合の測定法分類は？	相関補正などの係数が設定されている場合は、たとえJSCC標準化対応法の条件を満たしていても「99. その他」になります。ただし、相関補正式によりJSCC標準化対応法に合わせている場合もありますので、補正係数の由来を確認して下さい。
AST、ALTで、試薬キットに「IFCC法」「SSCC法」と記載されているが、検量にJSCC標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	IFCC法のPALP添加以外の場合では、基本的に「11. JSCC標準化対応法」を選択で構いません。
AST、ALTで、試薬はPALPを添加したIFCC法を使用しているが、検量にJSCC標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	IFCC法でPALPを添加している場合は、必ず指定のキャリブレータを使用し、指定の表示値を使用して下さい。また測定法分類も合わせて「12. IFCC標準化対応法（PALP添加）」を選択して下さい。
AST、ALTで、試薬キットは「JSCC法」と記載された試薬を使用しているが、検量にIFCCの値を使用している。この場合の測定法分類は？	この時使用されている表示値はPALP無添加であることをご確認下さい。その場合基本的には「13. IFCC標準化対応法」となります。もし使用する表示値が「PALP添加」の場合は、速やかに正しい使用方法に変更することをお勧め致します。
γ-GT（γ-GTP）で、試薬キットに「JSCC法」との記載がない（例えばSzasz法試薬使用の場合）が、検量にJSCC標準化対応法の値を使用している。この場合の測定法分類は？	基本的に「11. JSCC標準化対応法」を選択で構いませんが、試薬キットによっては精度管理試料に対する反応性がヒト試料と異なる場合がありますので、各試薬メーカーにお問い合わせ下さい。
γ-GT（γ-GTP）で、試薬キットは「JSCC法」と記載された試薬を使用しているが、検量にSzaszの値を使用している。この場合の測定法分類は？	基本的に「22. Szaszの条件」を選択することになりますが、正しい方法ではありませんので、速やかに正しい使用方法に変更されることをお勧め致します。
試薬キット指定のキャリブレータ以外のものを使用している場合の検量法分類は？	標準化対応法という概念は、試薬キットと指定のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）の組み合わせがあって、初めて成立します。したがって、試薬キット指定以外のキャリブレータなどを使用している場合の検量法は、「9-0その他」を選択して下さい。この場合には速やかに正しい使用方法に変更されることをお勧め致します。
現在、ルーチン測定は、キャリブレーションとしてブランクだけを実施している。ただし「Kファクター」は指定のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）を用いて決定した。この場合の検量用分類は？	基本的には、「11. JSCC標準化対応法」を選択しますが、ファクターを決定した時期以降の変動要因による影響を確認するために、定期的に検量を取り直す、もしくは企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）によるトレーサビリティの確認を実施して下さい。

【参考】検量法の確認記入フロー

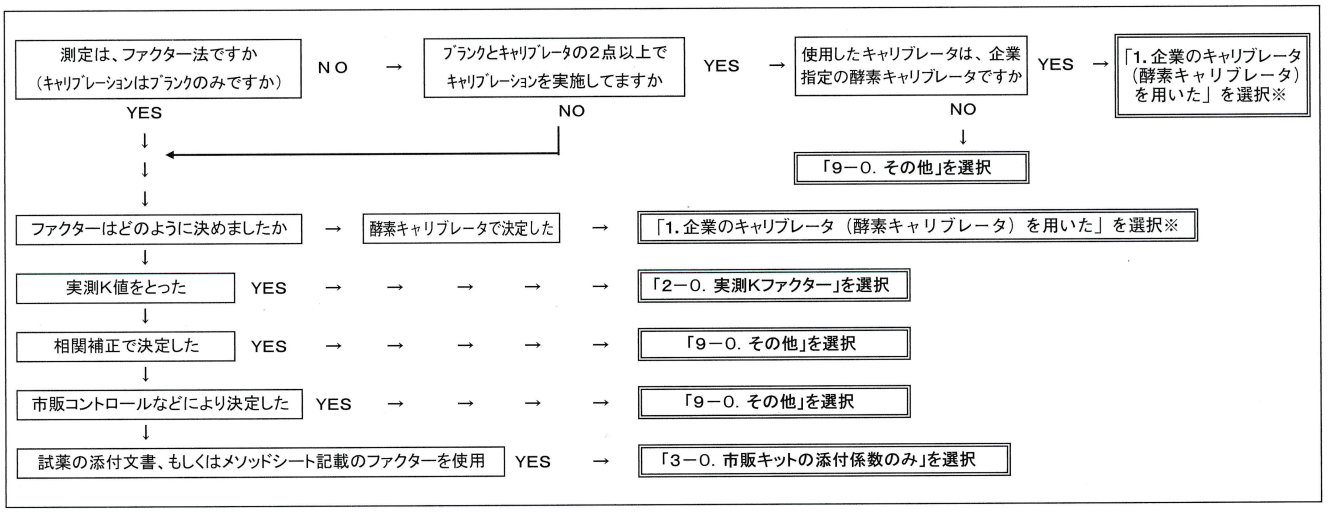

※「1. 企業のキャリブレータ（酵素キャリブレータ）」については、製造販売元指定は「1-1」、製造販売元以外は「1-2」を選択して下さい。

【参考】トレーサビリティの確認記入フロー

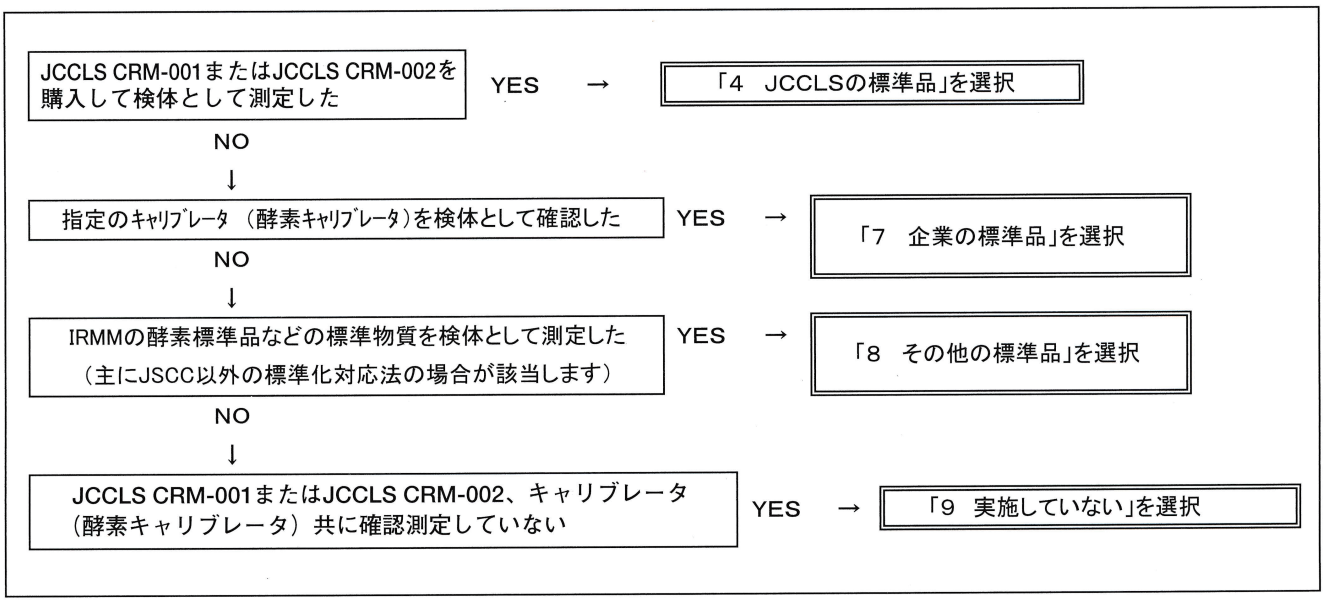

記入上の注意事項について

〔調査項目ごとの記入上の注意事項〕

〔調査票記入控〕

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

1. 総コレステロール

▶測　定　法　1) 11 はコレステロールオキシダーゼを用いる酵素法で、最終的に発色反応に導く比色法および電極法を含みます。
2) 21 はコレステロールデヒドロゲナーゼを用いる酵素法です。
3) 化学法（例えば Abell-Kendall 法）は、その他 99 です。
4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
5) その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶試　　薬　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検量用試料（キャリブレータ）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレータの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

1. 総コレステロール

測定法

コレステロール酸化酵素法 …… 11
コレステロール脱水素酵素法 …… 21
ドライケミストリ法
ビトロス（オーソ） …… 81
富士ドライケム（富士フイルム）…… 82
スポットケム（アークレイ） …… 83
D コンセプト（アークレイ） …… 84

その他（ ）‥ 99

検量用試料（キャリブレータ）種類

製造販売元指定のもの
溶媒ベース …… 1
血清ベース …… 2
製造販売元指定以外のもの
溶媒ベース …… 3
血清ベース …… 4
磁気カード・バーコード等キャリブレーション …. 5
その他（ ）‥ 9

※ 検量用試料の種類で 3、4、9を選んだ場合は、左ページの製造販売元コード表より製造販売元のコード番号を記入してください。

トレーサビリティの確認

販売元コード
NISTの標準品 …… 5
ReCCSの標準品 …… 6
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。

その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

2. 中性脂肪

▶測　定　法　**グリセロールを消去する方法としない方法（直接法）の誤登録がまだかなり存在します。測定原理を十分調査して間違いなく記入して下さい。**

1) 酵素法には UV 法と比色法があり、NADH の 340nm の吸光度変化を測定する方法は UV 法で、最終的に発色反応に導く方法は比色法です。
2) グリセロールを消去する方法には、血清盲検をとることにより結果的に遊離グリセロールを消去する方法と、あらかじめ反応の中で遊離グリセロールを消去した後に発色を行う方法の 2 種類があり、その両方が含まれます。グリセロールを消去しない方法（直接法）は、遊離グリセロールを消去することなく測定する直接法です。
3) 有機溶媒抽出による化学法（たとえば Hantzsch 反応法）は 99 です。
4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
5) その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下第１位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶**試　　薬**　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶**検量用試料（キャリブレータ）**とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。

・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレータの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

2. 中性脂肪

測定法

酵素UV法
- ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法 …… 11

酵素比色法
- ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法 …… 21
- ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去しない方法(直接法) 22

ドライケミストリ法
- ビトロス(オーソ) …… 81
- 富士ドライケム(富士フイルム)…… 82
- スポットケム(アークレイ) …… 83
- D コンセプト(アークレイ) …… 84

その他(　　)‥ 99

検量用試料(ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ)種類

製造販売元指定のもの
- 溶媒ベース …… 1
- 血清ベース …… 2

製造販売元指定以外のもの
- 溶媒ベース …… 3
- 血清ベース …… 4

磁気カード・バーコード等キャリブレーション …. 5

その他(　　)‥ 9

※ 検量用試料の種類で 3、4、9を選んだ場合は、左ページの製造販売元コード表より製造販売元のコード番号を記入してください。

トレーサビリティの確認

販売元コード
- NISTの標準品 …… 5
- ReCCSの標準品 …… 6
- 企業の標準品 …… 7
- その他の標準品 …… 8
- 実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。

その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL	. mg/dL

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

3. 尿　　酸

▶**測　定　法**　1）同じメーカーで異なった種類の製品が発売されていることもあるので、よく調べた上、記入して下さい。
2）POD-4AA-フェノール、EMSE、DEA などを発色試薬に用いるものは 31 です。
3）ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
4）その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶**測　定　値**　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下第２位を四捨五入のうえ、小数点以下第１位で記入して下さい。
小数点以下０の場合は、０を必ず記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999.9 と記入して下さい。

▶**試　　薬**　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶**検量用試料（キャリブレータ）**とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、１成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレータの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、１成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

3. 尿酸

測定法

ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法…… 31
ウリカーゼ・UV法 …… 41
ドライケミストリ法
ビトロス(オーソ) …… 81
富士ドライケム(富士フイルム)…… 82
スポットケム(アークレイ) …… 83
D コンセプト(アークレイ) …… 84

その他(**)**·· 99

検量用試料
(キャリブレータ)種類

製造販売元指定のもの
溶媒ベース …… 1
血清ベース …… 2
製造販売元指定以外のもの
溶媒ベース …… 3
血清ベース …… 4
磁気カード・バーコード等
キャリブレーション …. 5
その他(**)**·· 9

※ 検量用試料の種類で 3、4、9を選んだ場合は、左ページの製造販売元コード表より製造販売元のコード番号を記入してください。

トレーサビリティの確認

販売元コード

NISTの標準品 …… 5
ReCCSの標準品 …… 6
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。

その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

4. クレアチニン

▶**測　定　法**　1）ピクリン酸による rate 法は 12 と記入して下さい。
2）ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
3）その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶**測　定　値**　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下第 3 位を四捨五入のうえ、小数点以下第 2 位で記入して下さい。
0 の場合または数値がない場合は、00 を必ず記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、999.99 と記入して下さい。

▶**試　　薬**　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶**検量用試料（キャリブレータ）**とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレータの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

4. クレアチニン

測定法

Jaffé法

除蛋白しない方法

rate法 …… 12

酵素法 …… 21

ドライケミストリ法

ビトロス(オーソ) …… 81

富士ドライケム(富士フイルム)…… 82

スポットケム(アークレイ) …… 83

D コンセプト(アークレイ) …… 84

その他(　　)‥ 99

検量用試料(キャリブレータ)種類

製造販売元指定のもの

溶媒ベース …… 1

血清ベース …… 2

製造販売元指定以外のもの

溶媒ベース …… 3

血清ベース …… 4

磁気カード・バーコード等キャリブレーション …. 5

その他(　　)‥ 9

※ 検量用試料の種類で 3、4、9を選んだ場合は、左ページの製造販売元コード表より製造販売元のコード番号を記入してください。

トレーサビリティの確認

販売元コード

NISTの標準品 …… 5

ReCCSの標準品 …… 6

企業の標準品 …… 7

その他の標準品 …… 8

実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。

その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

5. ＡＳＴ

▶測　定　法　使用している試薬の添付文書をよく読んで記入して下さい。標準化対応法の考え方を基本とします。

1) JSCC 標準化対応法は、日本臨床化学会の勧告法の測定値を伝達している測定法です。添付文書に JSCC 標準化対応法と記載されています。測定法の分類は 11 です。
2) IFCC（国際臨床化学連合）の勧告法の測定値を伝達している方法が IFCC 標準化対応法です。この測定法は PALP が添加されています。測定法の分類は 12 です。
3) IFCC の勧告法は基本的に PALP が添加されている測定法です。PALP 添加をしていない IFCC 標準化対応法は現実には存在しません。しかし、そのような試薬をご利用の方は 13 に分類して下さい。
4) ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
5) その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**自動分析装置からは整数で出力されます。用手法で分析した場合でも整数値で記入して下さい。**
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶測定温度　実際に測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。その他と回答した施設は、（　　）内に温度を記入して下さい。

▶試　　薬　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検　量　法　平成 27 年度から、5-0 として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。

▶記　入　例　A 社の JSCC 標準化対応法を用いて、37 ℃で、A 社の酵素キャリブレータを用いて測定した施設の記入例は

測定法―― JSCC 標準化対応法（11）を選択し、
試薬キットの製造販売元は A に該当するコード番号（aa）を選択し、
検量法は企業の酵素キャリブレータを用いた（1-1）を選択し、
測定値欄には標準化対応法での測定値を記入します。

5. ＡＳＴ

測定法
標準化対応法

JSCC標準化対応法 …… 11
IFCC標準化対応法(PALP添加) …· 12
IFCC標準化対応法(PALP無添加) · 13
ドライケミストリ法
富士ドライケム（富士フイルム)…… 82
スポットケム（アークレイ） …… 83
D コンセプト（アークレイ） …… 84
ビトロスJ（オーソ） …… 85
その他（)… 99

検量法

企業の酵素キャリブレータを用いた
製造販売元指定 …… 1-1
製造販売元指定以外 …… 1-2
実測Kファクターのみである …… 2-0
市販キットの添付係数のみである · 3-0
磁気ｶｰﾄﾞ･ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ等ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ · 5-0
その他 …… 9-0
その他(9-0)の場合の具体的検量法
（ ）

利用している単位

標準化対応法の国際単位 ·· 1
その他の国際単位 …… 2
Karmen単位 …… 3
その他の単位 …… 9

測定温度

37℃ …… 1
30℃ …… 2
25℃ …… 3
その他（ ℃） …… 9

トレーサビリティの確認

販売元コード

･実施した
JCCLSの標準品 …… 4
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
･実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。
その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:


使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1 ＿＿＿＿. U/L
測定値 試料 2 ＿＿＿＿. U/L
測定値 試料 3 ＿＿＿＿. U/L
測定値 試料 4 ＿＿＿＿. U/L
測定値 試料 5 ＿＿＿＿. U/L

【参考】測定法分類記入フロー

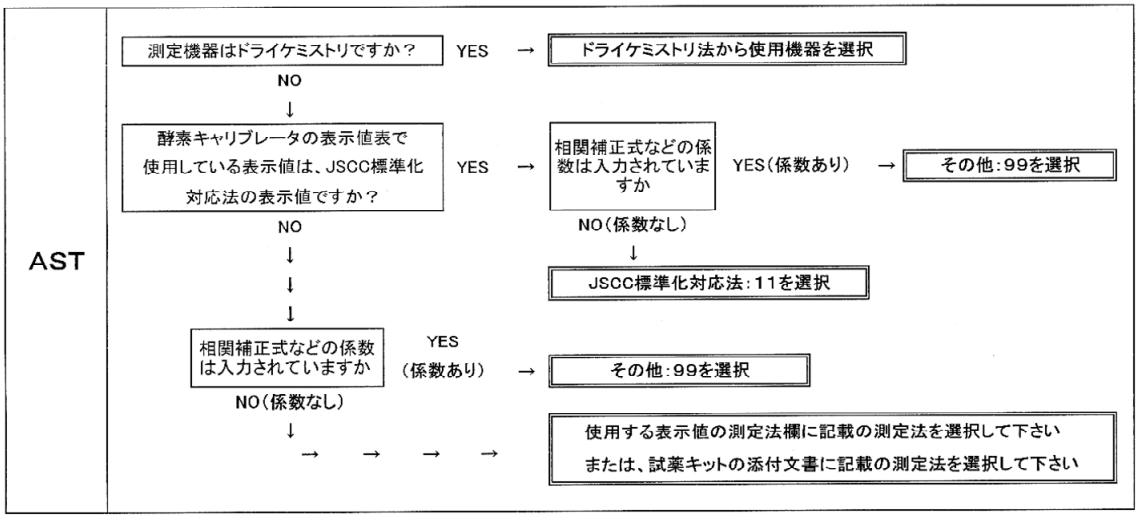

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

6. ＡＬＴ

▶測　定　法　使用している試薬の添付文書をよく読んで記入して下さい。その他の注意事項は AST と同様です。
その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**自動分析装置からは整数で出力されます。用手法で分析した場合でも整数値で記入して下さい。**
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶測定温度　AST と同様です。

▶試　　薬　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検　量　法　平成 27 年度から、5-0 として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。

▶記　入　例　AST と同様です。

6. ALT

測定法
標準化対応法 □□

JSCC標準化対応法 …… 11
IFCC標準化対応法(PALP添加) …· 12
IFCC標準化対応法(PALP無添加) · 13
ドライケミストリ法
富士ドライケム (富士フイルム)…… 82
スポットケム (アークレイ) …… 83
D コンセプト (アークレイ) …… 84
ビトロスJ (オーソ) …… 85
その他(　　)… 99

検量法 □-□

企業の酵素キャリブレータを用いた
　製造販売元指定 …… 1-1
　製造販売元指定以外 …… 1-2
実測Kファクターのみである …… 2-0
市販キットの添付係数のみである · 3-0
磁気ｶｰﾄﾞ･ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ等ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ · 5-0
その他 …… 9-0
その他(9-0)の場合の具体的検量法
(　　)

利用している単位 □

標準化対応法の国際単位 ·· 1
その他の国際単位 …… 2
Karmen単位 …… 3
その他の単位 …… 9

測定温度 □

37℃ …… 1
30℃ …… 2
25℃ …… 3
その他(　　℃) …… 9

トレーサビリティの確認 □-□□

販売元コード

･実施した
JCCLSの標準品 …… 4
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
･実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元 □□

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。
その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:


使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□
U/L	U/L	U/L	U/L	U/L

【参考】測定法分類記入フロー

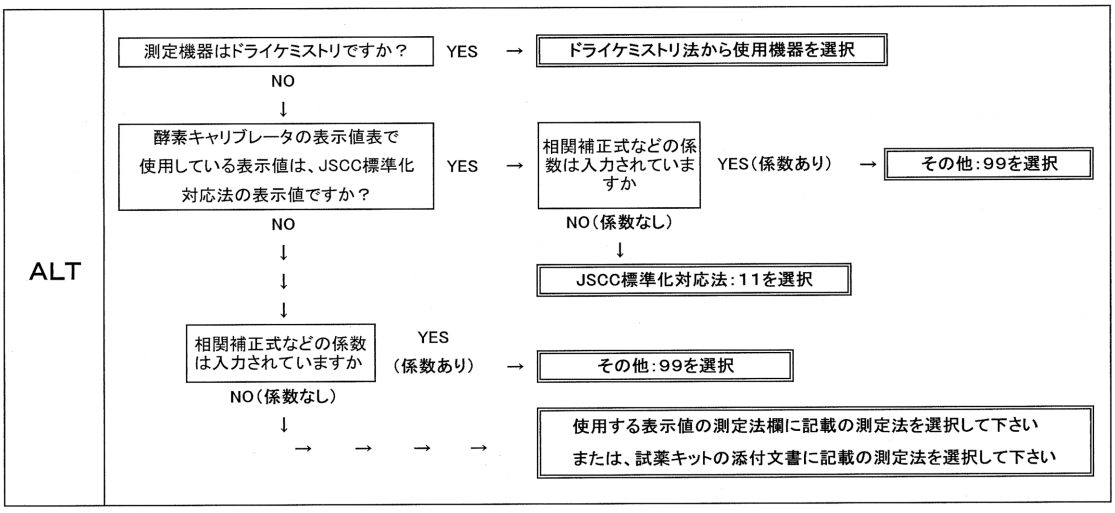

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

7. γ－ＧＴ（γ－ＧＴＰ）

▶測　定　法　1）測定法は JSCC 標準化対応法を基本とします。
2）γ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリド以外の基質を用いても、標準化対応法としての条件がととのえば対応法として考えることは可能です。添付文書をよく読んで、基質にこだわらずに測定法を分類して下さい。
3）その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**自動分析装置では計測値は整数で出力されます。用手法で分析しても整数値で記入して下さい。**
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶測定温度　実際に測定に用いている温度のコード番号を記入して下さい。その他と回答した施設は、（　　）内に温度を記入して下さい。

▶試　　薬　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検　量　法　平成 27 年度から、5-0 として「磁気カード・バーコード等キャリブレーション」を加えました。該当する場合は、適切な回答をお願いします。

▶記　入　例　A 社の基質はγ-グルタミル-3-カルボキシ-4-ニトロアニリドではありませんが、JSCC 勧告法と比例互換性が優れているので、A 社では、JSCC 勧告法の測定値を伝達する係数を Y 社の自動分析装置を利用する場合に提示しています。そして、この方法を IFCC 標準化対応法と定義しています。
測定法は、JSCC 標準化対応法として（11）、
試薬キットの製造販売元は A 社に相当する（aa）、
利用している単位の欄は標準化対応法の国際単位の（1）と記載します。

7. γ－GT（γ－GTP）

測定法 □□

JSCC標準化対応法 …… 11
JSCC標準化対応法(ﾛｼｭﾘｷﾃｯｸ) …… 12
3-ｶﾙﾎﾞｷｼ-4-ﾆﾄﾛｱﾆﾘﾄﾞを基質とする方法 Szaszの条件 …… 22
ドライケミストリ法
富士ドライケム（富士フイルム)…… 82
スポットケム（アークレイ） …… 83
D コンセプト（アークレイ） …… 84
ビトロスJ（オーソ） …… 85
その他(　　)…… 99

検量法 □－□

企業の酵素キャリブレータを用いた
製造販売元指定 …… 1-1
製造販売元指定以外 …… 1-2
実測Kファクターのみである …… 2-0
市販キットの添付係数のみである ・3-0
磁気ｶｰﾄﾞ･ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ等ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ ・5-0
その他 …… 9-0
その他(9-0)の場合の具体的検量法
(　　)

利用している単位 □

標準化対応法の国際単位 ‥ 1
その他の国際単位 …… 2
Szasz法の条件での単位 … 3
その他の単位 …… 9

測定温度 □

37℃ …… 1
30℃ …… 2
25℃ …… 3
その他(　　℃) …… 9

トレーサビリティの確認 □－□□

販売元コード

・実施した
JCCLSの標準品 …… 4
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
・実施していない …… 9

試薬キット製造販売元 □□

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。
その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名:

使用したキットの名称


正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称:

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□
U/L	U/L	U/L	U/L	U/L

【参考】測定法分類記入フロー

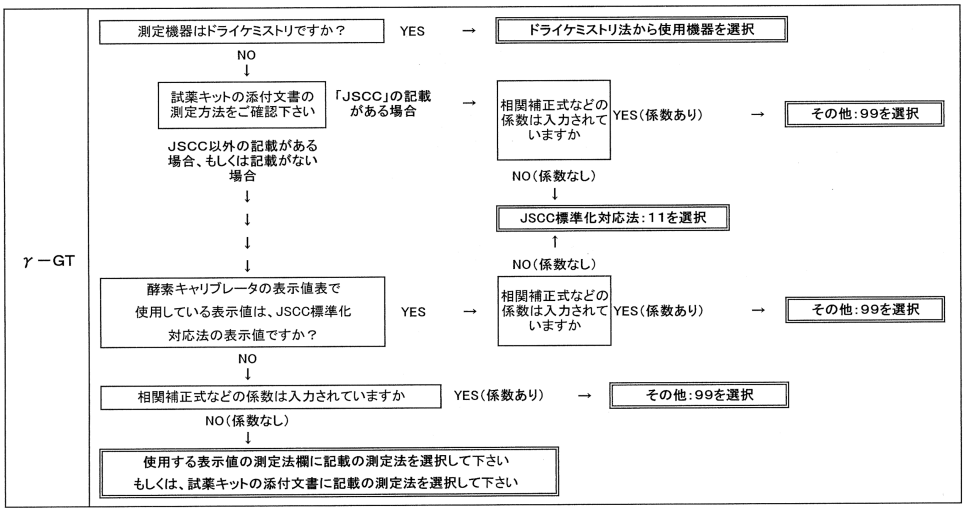

記入上の注意事項

製造販売元コード表

コード	製造販売元名
02	栄研化学
04	カイノス
06	関東化学
07	協和メデックス
08	極東製薬
09	シスメックス
10	エーディア
11	シノテスト
12	常光
13	セロテック
14	アボットジャパン
15	積水メディカル
18	デンカ生研
19	東洋紡
20	日水製薬
21	アルフレッサ ファーマ
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
26	富士フイルム
27	ベックマン・コールター
29	シーメンスＨＣＤ

コード	製造販売元名
30	ミズホメディー
31	LSIメディエンス
32	和光純薬
33	富士レビオ
34	日本凍結乾燥研究所
36	旭化成
37	ニットーボーメディカル
38	アークレイ
39	ニプロ
40	オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス
42	日本ケミファ
43	日立
44	東ソー
45	BML
46	バイオ・ラッド ラボラトリーズ
47	エイ アンド ティー
48	日本ベクトン・ディッキンソン
49	生化学工業
53	日立化成
54	堀場製作所

コード	製造販売元名
55	岸本医科学研究所
58	合同酒精
59	塩野義製薬
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社：協和メデックス)
62	東洋濾紙(販社：三和化学研究所)
63	バイエル薬品
64	三洋化成工業
65	オリエンタル酵母
66	フレイヤ
67	日本光電工業
68	扶桑薬品
69	日本電子
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名ではなく必ず製造販売元のコード番号を記入して下さい。**
コード番号 99 のその他の場合は必ず製造販売元名を記入して下さい。

8. 血　糖

▶測　定　法　1）グルコキナーゼを用いた方法は 21 です。
2）ブドウ糖脱水素酵素（グルコースデヒドロゲナーゼ；GDH）法には UV 法と比色法とがありますが、いずれも 31 と記入して下さい。
3）ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
4）その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶自己血糖測定装置（SMBG）　SMBG につきましては、適切な試料が提供できないため、評価対象外とします。該当する機器は、測定装置コード表に「S」と示しておりますので、ご確認下さい。

▶測　定　値　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下第１位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶試　　薬　試薬の製造販売元は、上記のコード表にしたがってコード番号を記入して下さい。

▶検量用試料（キャリブレータ）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・溶媒ベースとは、成分を溶解する基材として水または溶解補助物質を含む水、有機溶媒などをベースとしたもので、1 成分のみ溶解した単一成分タイプと複数成分を溶解した多成分タイプ（マルチタイプ）があり、これらの両方が含まれます。
注意：粘性物質を添加したキャリブレータの場合も、「溶媒ベース」に分類して下さい。不明な場合はメーカーに問い合わせて下さい。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、1 成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「1」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、溶媒ベースを使用している施設は、コード番号「3」を、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

8. 血 糖

測定法 [ ][ ]

ブドウ糖酸化酵素比色法 …… 11
ブドウ糖酸化酵素電極法 …… 12
ヘキソキナーゼ・UV法 …… 21
ブドウ糖脱水素酵素法 …… 31
ドライケミストリ法
ビトロス（オーソ） …… 81
富士ドライケム（富士フイルム）…… 82
スポットケム（アークレイ） …… 83
D コンセプト（アークレイ） …… 84
その他（ ）‥ 99

検量用試料（キャリブレータ）種類 [ ]-[ ][ ]

製造販売元指定のもの
溶媒ベース …… 1
血清ベース …… 2
製造販売元指定以外のもの
溶媒ベース …… 3
血清ベース …… 4
磁気カード・バーコード等キャリブレーション …. 5
その他（ ）‥ 9

※ 検量用試料の種類で 3、4、9を選んだ場合は、左ページの製造販売元コード表より製造販売元のコード番号を記入してください。

トレーサビリティの確認 [ ]-[ ][ ]
販売元コード

NISTの標準品 …… 5
ReCCSの標準品 …… 6
企業の標準品 …… 7
その他の標準品 …… 8
実施していない …… 9

※ 企業の標準品 7 を選んだ場合は、7 に続く枠内に、製造販売元コード2 桁を記入してください。

試薬キット製造販売元 [ ][ ]

左ページコード表より、該当する製造販売元コード番号を記入して下さい。

その他(99)を選んだ場合は、製造販売元名を記入してください。

製造販売元名：

使用したキットの名称

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称：

測定値 試料 1	測定値 試料 2	測定値 試料 3	測定値 試料 4	測定値 試料 5
[ ][ ][ ][ ].[ ]	[ ][ ][ ][ ].[ ]	[ ][ ][ ][ ].[ ]	[ ][ ][ ][ ].[ ]	[ ][ ][ ][ ].[ ]
mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL

記入上の注意事項

9. ＨＤＬコレステロール

▶測　定　法　1）沈殿操作を行わない方法は、試薬ごとに測定法コードを設定してありますので、自施設の試薬に相当する測定法コードを記入して下さい。
2）ドライケミストリは別に分類項目を作成しています。
3）その他と回答した施設は、その測定法を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**単位はmg/dLで記入して下さい。**
小数点以下第１位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999と記入して下さい。

▶検量用試料（キャリブレータ）とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・血清ベースとは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、１成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

9. ＨＤＬコレステロール

測定法 □□ - □□□□

沈殿操作を行わない方法

- 関東化学（シカリキッドHDL） …… 01 - 0301
- 協和メデックス（メタボリード HDL-C） …… 01 - 0403
- シスメックス（HDL-C試薬・KL「コクサイ」） …… 01 - 0601
- シノテスト（クイックオート ネオ HDL-C） …… 01 - 0801
- セロテック（HDL-L） …… 01 1001
- 積水メディカル(コレステストN HDL、クオリジェント HDL …… 01 - 1201
- デンカ生研（EX N） …… 01 - 1301
- 東洋紡（ダイヤカラー・HDL） …… 01 - 1401
- BCKK(シンクロンシステム HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ（HDLD）試薬） …… 01 - 1901
- シーメンスHCD（ディメンションカートリッジHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙAHDL） 01 - 2001
- 和光純薬（L タイプワコーHDL-C・M(3)） …… 01 - 2304
- 日立化成（セラテスタムHDL） …… 01 - 4601

ドライケミストリ法

- 富士ドライケム（富士フイルム） …… 08 - 1801
- スポットケム（アークレイ） …… 08 - 2701
- D コンセプト（アークレイ） …… 08 - 2702
- ビトロス（オーソ） …… 08 - 2801

その他 …… 99 - 9999

検量用試料（ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ）種類 □

製造販売元指定のもの

- 血清ベース …… 2

製造販売元指定以外のもの

- 血清ベース …… 4

磁気カード・バーコード等キャリブレーション …. 5

その他（ ）.. 9

トレーサビリティの確認 □

- NISTの標準品 …… 5
- ReCCSの標準品 …… 6
- 企業の標準品 …… 7
- その他の標準品 …… 8
- 実施していない …… 9

測定値 試料6	測定値 試料 7	測定値 試料 8
□□□□.□	□□□□.□	□□□□.□
mg/dL	mg/dL	mg/dL

その他測定法の名称 試薬キット製造販売元

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

測定法名称及び製造販売元：

記入上の注意事項

10. ＬＤＬコレステロール

▶**試　　薬**　1）試薬ごとにコードを設定してありますので、自施設の試薬に相当するコードを記入して下さい。
2）Friedewald の式（F 式）により計算している場合は、「Friedewald の式（F 式）により算出」を選択し、**測定装置（ZZZ999）および検量用試料（キャリブレータ）の種類はその他を選択して下さい。**
3）ドライケミストリについては、試薬を市販していないことから、調査をしないこととしています。
4）その他と回答した施設は、その試薬の名称、製造販売元名を（　　）内に記入して下さい。

▶**測　定　値**　**単位はmg/dL で記入して下さい。**
小数点以下第１位を四捨五入の上、整数値で記入して下さい。
測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、9999 と記入して下さい。

▶**検量用試料（キャリブレータ）**とは、測定値を得るために標準液（スタンダード）として測定する試料を指します。
・血清ベースの検量用試料とは、基材として血清（またはアルブミンなどの蛋白）をベースとしたもので、１成分のみの表示値を有するものと複数成分の表示値を有するマルチタイプがあり、これらの両方が含まれます。
・製造販売元指定のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「2」を記入して下さい。
・製造販売元指定以外のもので、血清ベースを使用している施設は、コード番号「4」を記入して下さい。
・キットに付属している磁気カード・バーコード等を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。
・検量用試料を自施設で測定し直して使用している施設は、コード番号「9」を記入して下さい。

10. ＬＤＬコレステロール

測定法 □□ - □□□□

沈殿操作を行わない方法

関東化学（シカリキッドLDL）	01 - 0301
協和メデックス（メタボリード　LDL-C）	01 - 0403
シスメックス（LDL-C試薬・KL「コクサイ」）	01 - 0601
シノテスト（クイックオート　ネオ LDL-C）	01 - 0801
セロテック（LDL-L）	01　1001
積水メディカル（コレステスト LDL、クオリジェント LDL	01 - 1201
デンカ生研（LDL-EX N）	01 - 1301
デンカ生研（デュアルCHO　T&L）	01 - 1302
東洋紡（ダイヤカラー・LDL）	01 - 1401
ベックマン・コールター（LDLD）試薬	01 - 1901
シーメンスHCD（LDLコレステロールALDL）	01 - 2001
和光純薬（L タイプ　LDL-C　M）	01　2302
オーソ（ビトロス　マイクロチップ dLDL）	01 - 2801
日立化成（セラテスタムLDL）	01 - 4601
Friedewaldの式（F式）により算出	03 - 9999
その他	99 - 9999

検量用試料（ｷｬﾘﾌﾞﾚｰﾀ）種類 □

製造販売元指定のもの

血清ベース	2

製造販売元指定以外のもの

血清ベース	4
磁気カード・バーコード等キャリブレーション	5
その他（　　）	9

トレーサビリティの確認 □

NISTの標準品	5
ReCCSの標準品	6
企業の標準品	7
その他の標準品	8
実施していない	9

測定値 試料6	測定値 試料 7	測定値 試料 8
□□□□.　mg/dL	□□□□.　mg/dL	□□□□.　mg/dL

その他測定法の名称 試薬キット製造販売元

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称及び製造販売元：

記入上の注意事項

11. ＨｂＡ１ｃ

▶測　定　法　1）HPLC 法は不安定分画を除去する方法のみコードを設定しました。試薬ではなく分析装置の製造販売元による分類となります。

2）不安定分画を除去しない HPLC 法、イオン交換樹脂などでミニカラムを使用する用手的な方法はその他を記入して下さい。

3）免疫学的方法、酵素法は、試薬の製造販売元ごとにコードを設定しましたので、自施設の試薬に相当するコードを記入して下さい。

4）その他と回答した施設は、その測定法または試薬キットの名称、製造販売元名を（　　）内に記入して下さい。

▶測　定　値　**単位は％で記入して下さい。**

小数点以下第２位を四捨五入のうえ、小数点以下第１位で記入して下さい。

小数点以下０の場合は０を必ず記入して下さい。

測定不能あるいは「測定値」が不等号で表示された場合は、999.9 と記入して下さい。

測定結果は NGSP 値を記載して下さい。

なお、NGSP 値と JDS 値は以下の式で換算が可能です。

NGSP 値（％）＝ 1.02 × JDS 値（％）＋ 0.25 ％

▶**標　準　液（キャリブレータ）および検量方法の種類**については、製造販売元指定の標準液、製造販売元指定以外の標準液、自家製標準液、標準液を用いない、その他の５種類に大別しています。

・製造販売元指定の標準液で製造販売元の表示値をそのまま使用している施設は、コード番号「1」を記入して下さい。自施設で独自に値付けを行うなど何らかの形で表示値を変更して使用している施設は、すべてコード番号「2」を記入して下さい。

・製造販売元指定以外の標準液で製造販売元の表示値をそのまま使用している施設は、コード番号「3」を記入して下さい。自施設で独自に値付けを行うなど何らかの形で製造販売元の表示値を変更して使用している施設は、すべてコード番号「4」を記入して下さい。

・自家製標準液を使用している施設は、コード番号「5」を記入して下さい。

・標準液を用いないで装置の係数をそのまま使用している施設は、コード番号「6」を記入して下さい。装置の係数を何らかの形で補正している施設は、コード番号「7」を記入して下さい。

・その他の方法で検量を行っている施設は、コード番号「9」を記入し、その方法を（　）内に記入して下さい。

参考調査

平成28年度においても生血液２試料において参考調査を行います。試料18および19において、ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積を測定した残余の血液により、HbA1cの測定値を記入してください。なお、HbA1cを測定できなかった場合その理由を記入してください。

11. ＨｂＡ１ｃ

分析装置の製造販売元名・試薬キットの製造販売元名　□□ - □□□□

HPLC法
- アークレイ …… 01 - 2701
- 東ソー …… 01 - 2901
- バイオ・ラッド …… 01 - 3001

免疫学的方法
- 協和メデックス（汎用自動分析装置）凍乾品 …… 02 0401
- 協和メデックス（DM-JACKシリーズ）凍乾品 …… 02 - 0402
- 協和メデックス（汎用自動分析装置）液状品 …… 02 - 0403
- 協和メデックス（DM-JACKシリーズ）液状品 …… 02 - 0404
- ロシュ（コバス試薬HbA1c Ⅲ） …… 02 - 1705
- ベックマン・コールター（AU680） …… 02 - 1901
- シーメンスHCD（DCAシステム） …… 02 - 2001
- シーメンスHCD（ディメンションフレックスカートリッジHB1c） …… 02 2002
- 和光純薬 …… 02 - 2301
- 富士レビオ …… 02 - 2401
- アークレイ （スポットケム） …… 02 - 2701
- オーソ （ビトロス マイクロチップHbA1c） …… 02 2803
- サカエ（三和化学研究所・協和メデックス）（メディダスHbA1c） …… 02 4501
- 日本光電（CHM-4100） …… 02 4701

酵素法
- 協和メディックス …… 03 0401
- 積水メディカル …… 03 1201
- アークレイ …… 03 2701
- 日本電子 …… 03 3501

その他 …… 99 - 9999

標準液（キャリブレータ）および検量方法の種類　□

製造販売元指定の標準液
- 表示値をそのまま使用 …… 1
- 表示値を変更して使用 …… 2

製造販売元指定以外の標準液
- 表示値をそのまま使用 …… 3
- 表示値を変更して使用 …… 4

自家製標準液 …… 5

標準液を用いない
- 装置（または試薬）の係数をそのまま使用 …… 6
- 装置（または試薬）の係数を補正して使用 …… 7

その他 …… 9

その他測定法の名称 試薬キット製造販売元

正式名称を省略しないで下欄に記入してください。

キットの名称及び製造販売元 :

試料18、19でヘモグロビンA1cが測定できなかった理由　□
1 試料が少なく測定できなかった
2 参考調査なので不参加

NGSP値

測定値 試料 9	測定値 試料 10	測定値 試料 18	測定値 試料 19
%	%	%	%

記入上の注意事項

製造販売元コード表

02	栄研化学
06	関東化学
07	協和メデックス
09	シスメックス
22	ロシュ・ダイアグノスティックス
29	シーメンスHCD

32	和光純薬
33	富士レビオ
38	アークレイ
39	ニプロ
60	テルモ
61	東洋濾紙(販社:協和メディックス)

62	東洋濾紙(販社:三和化学研究所)
70	テクノメディカ
98	自家調製
99	その他

製造販売元と販売会社が異なることがあります。**販売会社名でなく必ず製造販売元のコード番号を記入してください。**
コード番号99のその他の場合は必ず製造販売元名を記入してください。
また東洋濾紙は、販売会社によりコードが異なります。販売会社を確認のうえ製造販売元名を記入してください。

尿検査の一般的注意

1. 試験紙法で試行してください。
2. 測定項目は**尿糖、尿蛋白は定性・半定量検査、尿潜血は定性検査です**。
3. 測定法は、日常健診で用いている方法で測定してください。
4. 試験紙は、各製品で判定基準、標準色調の濃度表示が少し異なります。
   得られた測定値が右ページの(結果)の表示に一致しない場合は、その測定値に最も近い数値のコード番号を記入して下さい。

12. 尿糖半定量

▶ **結 果** 試験紙は表示が陰性、±、1＋、2＋、3＋のみになっているものと、濃度表示が併記されているものとがありますが、各試験紙の添付文書に従っておおよその濃度に換算して回答してください。
シスメックスのユリシス2400、スーパーUA(スーパートロン)、ミディトロンの300mg/dLとロシュ・ダイアグノスティックスのユリラックスS、ユリシス1100の300mg/dLは、250mg/dLを選択してください。
アークレイの試験紙において測定結果が30、50㎎/dLとなった場合は50㎎/dL前後を、70、100、150㎎/dLとなった場合は100㎎/dL前後を、200、300㎎/dLとなった場合は250㎎/dL前後を、OVERとなった場合は2,000㎎/dL前後を選択して下さい。

13. 尿蛋白半定量

▶ **結 果** 試験紙は表示が陰性、±、1＋、2＋、3＋のみになっているものと、濃度表示が併記されているものとがありますが、各試験紙の添付文書に従っておおよその濃度に換算して回答してください。
アークレイの試験紙において測定結果が10㎎/dLとなった場合は15㎎前後を、20、30、 50mg/dLとなった場合は30㎎/dL前後を、70、100、200㎎/dLとなった場合は100㎎/dL前後を、OVERとなった場合は1,000㎎/dL前後を選択して下さい。テルモの250㎎/dLは300㎎/dLを選択して下さい。
ロシュ・ダイアグノスティックスの25mg/dLの場合には30mg/dLを、75mg/dLと150mg/dLは100mg/dLを選択してください。

14. 尿潜血半定量

▶ **結 果** 試験紙は表示が陰性、±、1＋、2＋、3＋のみになっているものと、濃度表示が併記されているものとがありますが、今回の調査では各試験紙の添付文書に従って定性法で回答してください。

12. 尿糖半定量

測定法

試験紙法
目視判定・・・・・・・・・・・・・・・ 1
機器測定・・・・・・・・・・・・・・・ 2
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

その他(9)測定法

試験紙の製造元

製造販売元コード表から該当する番号を選んで記入してください。

その他(99)製造販売元の名称

結果

陰性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
50mg/dL前後・・・・・・・・ 2
100mg/dL前後・・・・・・・・ 3
250mg/dL前後・・・・・・・・ 4
500mg/dL前後・・・・・・・・ 5
1000mg/dL前後・・・・・・・・・ 6
2000mg/dL前後・・・・・・・・・ 7

試料11	
試料12	
試料13	
試料14	
試料15	

13. 尿蛋白半定量

測定法

試験紙法
目視判定・・・・・・・・・・・・・・・ 1
機器測定・・・・・・・・・・・・・・・ 2
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

その他(9)測定法

試験紙の製造元

製造販売元コード表から該当する番号を選んで記入してください。

その他(99)製造販売元の名称

結果

陰性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
15mg/dL前後・・・・・・・・ 2
30mg/dL前後・・・・・・・・ 3
100mg/dL前後・・・・・・・・・ 4
300mg/dL前後・・・・・・・・・ 5
500mg/dL前後・・・・・・・・・ 6
1000mg/dL前後・・・・・・・・・ 7

試料11	
試料12	
試料13	
試料14	
試料15	

14. 尿潜血半定量

測定法

試験紙法
目視判定・・・・・・・・・・・・・・・ 1
機器測定・・・・・・・・・・・・・・・ 2
その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

その他(9)測定法

試験紙の製造元

製造販売元コード表から該当する番号を選んで記入してください。

その他(99)製造販売元の名称

結果

陰性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
± ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
1＋ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2＋以上 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4

試料11	
試料12	
試料13	
試料14	
試料15	

記入上の注意事項

全血算(CBCについて)

本項目(15～19)の評価・評点は機種別に行います。ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、および血小板数を測定するのに用いた機種名を測定装置コード表から選んで記入してください。ただし用手法で実施した場合は「AAZ901」と記入して下さい。 使用機種に該当する測定装置コードが見当たらないときは、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

15. ヘモグロビン

▶ **測定値　単位はg/dLで記入してください、**
小数点以下が0の場合は0を記入してください。
測定不能の場合は99.9と記入してください。

▶ **測定法　メーカーに測定法を確認してから記入してください。**

注) SLS(ラウリル硫酸ナトリウム)法、アルキルアミンオキサイド法はともに非シアン界面活性剤法です。

16. 赤血球数

▶ **測定値　単位が$\times 10^4$/μLとなっています。桁間違いのないように注意してください。**
測定不能の場合は999と記入してください。

17. 白血球数

▶ **測定値　単位が$\times 10^2$/μLとなっています。桁間違いのないように注意してください。**
測定不能の場合は999と記入してください。
試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

注1) ベックマン・コールター、ユニセルDxH800、LH750、LH755、LH780、LH785は、UWBCを記入してください。

注2) ADVIA120/2120/2120iはWBCBを記入してください。
WBCB値表示が不明の場合はメーカーにお問い合わせください。

注3) シスメックスXN、XN-L(XN-350、450、550)、XE、XT、XSシリーズは"CBCのみ測定(ディスクリート)を選択して測定ください。また、XNシリーズでは、TNC-Nを記入してください。

注4) アボットセルダインサファイヤは、NRBCの測定値が得られた場合、そのNRBC数値をWBC数値に加えてWBC数報告値としてください。
アボットセルダインルビーおよびセルダイン3200は、コントロールモードで測定し、NOC数値をWBC報告値として下さい。コントロールモード・NOC値が不明な場合はメーカーにお問い合わせ下さい。

18. ヘマトクリット

▶ **測定値　単位は%で記入してください。桁間違いのないように注意してください。**
小数点以下が0の場合は0を必ず記入してください。
測定不能の場合は99.9と記入してください。
試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。

19. 血小板数

▶ **測定値　単位は$\times 10^4$/μLで記入してください。桁間違いのないように注意してください。**
小数点以下が0の場合は0を必ず記入してください。
測定不能の場合は999.9と記入してください。
試料を測定した際に測定装置から測定データの信頼性に配慮が必要なメッセージフラグが付加された場合は、測定装置のメーカーにお問い合わせください。
注) アボットセルダインサファイアは、電気抵抗法(PLTi)の測定値を報告値として下さい。

20. 平均赤血球容積

▶ **測定値　単位はfLで記入してください。桁間違いのないように注意してください。**
小数点以下が0の場合は0を記入してください。
小数点以下が2桁表示可能な計数機の場合は少数点2桁目を四捨五入してください。

15. ヘモグロビン

測定法 [ ]

シアンメトヘモグロビン法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
非シアン界面活性剤法・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

その他(9)測定法記入 [ ]

測定装置コード	測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
	g/dL	g/dL	g/dL	g/dL

16. 赤血球数

測定装置コード	測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$

17. 白血球数

測定装置コード	測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
	$\times 10^2/\mu L$	$\times 10^2/\mu L$	$\times 10^2/\mu L$	$\times 10^2/\mu L$

18. ヘマトクリット

測定装置コード	測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
	%	%	%	%

19. 血小板数

測定装置コード	測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$	$\times 10^4/\mu L$

20. 平均赤血球容積

測定値 試料 16	測定値 試料 17	測定値 試料 18	測定値 試料 19
fL	fL	fL	fL

平成28年度精度管理調査外部機関一覧

《本表の掲載機関は、全衛連が平成26年度に実施した精度管理調査において受託機関となった検査施設及び新規登録機関です。》

外部機関コード	機関名
001	中央労働災害防止協会　労働衛生調査分析センター
002	(株)LSIメディエンス
006	(株)保健科学研究所
008	(株)ビー・エム・エル BML総研
009	(株)エスアールエル 関西ラボラトリー
010	(公社)関西労働衛生技術センター
012	(一財)東京保健会　病体生理研究所
013	岐阜労働基準協会連合会
015	東京労災病院　健康診断センター
017	(公財)岩手県予防医学協会
024	(一社)京都微生物研究所
028	(公財)東京都予防医学協会
029	(株)大阪血清微生物研究所
030	中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター
033	(公財)福岡県すこやか健康事業団
035	(一財)京都工場保健会
036	(公財)神奈川県予防医学協会
037	(一社)瀬戸健康管理センター
040	(医)豊田健康管理クリニック
041	(株)エスアールエルMUQSラボラトリー
042	(一財)西日本産業衛生会 大分労働衛生管理センター
046	(一財)東海検診センター
048	(株)フジモトバイオメディカルラボラトリーズ
049	(公財)兵庫県予防医学協会
052	(株)第一岸本臨床検査センター
054	(株)愛媛臨検
057	(株)エスアールエル 愛知ラボラトリー
058	(株)四国中検
059	(株)新日化環境エンジニアリング
060	(株)中央微生物検査所
062	(株)昭和メディカルサイエンス 総合研究所
065	(株)岡山医学検査センター
068	(株)いかがく
069	(株)協同医学研究所
073	(有)久留米臨床検査センター
075	(株)サンリツ
079	中国労災病院　健康診断部(健康診断センター)
080	(公財)中国労働衛生協会　福山本部
081	(株)北信臨床
083	(株)ナゴヤ医学学術センター
085	(株)日本医学臨床検査研究所
087	(株)ファルコバイオシステムズ東京
088	(一社)半田市医師会 健康管理センター
090	(株)ファルコバイオシステムズ総合研究所
094	(株)メディック堺
097	(一財)近畿健康管理センター
098	(一財)西日本産業衛生会 北九州産業衛生診療所

外部機関コード	機関名
100	(株)保健科学 東日本
102	日本医学(株)
105	(一財)労働衛生協会
106	(一財)労働衛生協会 長野県支部
109	(株)シー・アール・シー
110	八戸市医師会臨床検査センター
111	(株)江東微生物研究所 微研中央研究所つくば
112	(株)福山臨床検査センター
113	パナソニック産業衛生科学センター
114	(株)第一臨床検査センター
120	(株)和歌山医化学研究所
122	(株)近畿予防医学研究所
126	(株)メディック滋賀ラボ
127	(株)メディック岐阜ラボ
128	(株)メディック長野ラボ
129	(株)メディック静岡ラボ
130	(株)エスアールエル 北海道ラボラトリー
133	(一財)全日本労働福祉協会
134	(社福)聖隷健康診断センター
136	(株)ビー・エム・エル BML 山形
137	(株)京浜予防医学研究所
138	(株)サカイ生化学研究所
140	(株)エスアールエル 八王子ラボラトリー
141	(株)昭和メディカルサイエンス総合研究所
142	(株)メディック横浜ラボ
143	(株)メディック富士ラボ
144	(株)エスアールエル静岡ラボラトリー
146	熊本市医師会検査センター
151	(社)北九州小倉医師会北九州中央臨床検査センター
152	(財)東京顕微鏡院
154	板橋中央臨床研究所
160	上尾中央臨床検査研究所
162	(株)近畿エコサイエンス
164	(株)兵庫県登録衛生検査センター和田山
165	(株)エスアールエル福岡ラボラトリー
167	
168	(株)エスアールエル 宇都宮ラボラトリー
169	(株)ファルコバイオシステムズ東海中央研究所
171	(株)日研医学
172	(株)メディック愛知ラボ
197	(株)LSIメディエンス関西
198	(株)LSIメディエンス神戸
199	(株)LSIメディエンス宮城
999	コード表に無い受託施設または追加および不明の場合は、
	コード番号999を調査票にご記入ください。

送付試料番号控え

今年度臨床検査精度管理調査実施に際して、試料に関するお問い合わせの際に使用することがございますので、事前に下記試料の外箱（ｹｰｽ）およびﾊﾞｲｱﾙに記載されている６桁の番号を控え**貴施設にて保管**していただきますようよろしくお願い申し上げます。

生化学試料１（資料 No.1～No.5）
項目：総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪・
AST･ALT･γ-GT･血糖

ケース番号：	
試料 1：	
試料 2：	
試料 3：	
試料 4：	
試料 5：	

生化学試料 2（試料 No.6～No.8）
項目：HDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ LDL ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ

ケース番号：	
試料 6：	
試料 7：	
試料 8：	

血液（血算）試料（No.16～No.19）
項目：ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ･赤血球数･ﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ･
血小板数･平均赤血球容積

ケース番号：	
試料 16：	
試料 17：	
試料 18：	
試料 19：	

HbA1c（試料 No.9、10）および
尿試料（試料 No.11～No.15）

ケース番号：	
試料 9：	
試料 10：	
試料 11：	
試料 12：	
試料 13：	
試料 15：	

～～～

平成 28 年度臨床検査精度管理調査実施要領

1　目的

本調査は、健康診断施設及び登録衛生検査所が実施する臨床検査の検査精度を確認するとともに、必要な指導を行うことにより信頼性の高い優良な健康診断施設及び登録衛生検査所を育成することを目的とする。

2　対象施設

健康診断施設及び登録衛生検査所

3　調査の対象項目

1.総コレステロール　2.中性脂肪　　3.尿酸　4.クレアチニン　5.AST　　6.ALT
7.γ-GT　8.血糖　9.HDLコレステロール　10.LDLコレステロール
11.HbA1c　12.尿糖（半定量）13.尿蛋白（半定量）　14.尿潜血（半定量）
15.ヘモグロビン　16.赤血球数　17.白血球数　18.ヘマトクリット　19.血小板数
20.平均赤血球容積

4　実施方法

調査試料を全参加施設に送付し、測定結果を回収した上、測定値の精度を評価する。ただし、参考試料に関しては仮評価とする。

(1)　調査項目及び送付試料数

①	総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT、血糖測定用	5 試料
②	HDL コレステロール、LDL コレステロール測定用	3 試料 （1 試料生血清）
③	HbA1c 測定用	2 試料
④	尿糖、尿蛋白、尿潜血半定量測定用	5 試料
⑤	ヘモグロビン、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット、血小板数、平均赤血球容積測定用	4 試料 （2 試料新鮮血液）

注）参考試料について

(ア) 上記②（HDLコレステロール、LDLコレステロール測定試料）のうち生血清 1試料は参考試料とする。

(イ) 上記⑤（血液 6 項目（調査の対象項目 15～20 ）測定試料）のうち新鮮血液 2 試料は、参考試料とする。

(ウ) 新鮮血液2 試料の残余試料でHbA1cを測定することとするが、この測定結果については、評価の対象としない。

(2) 実施時期等

① 試料送付　　平成 29 年 2 月 7 日（火）
② 報告期限　　平成 29 年 2 月 20 日（月）
③ 集計分析　　平成 29 年 2 月～3 月
④ 報告書作成　平成 29 年 5 月

(3) 試料の送付・測定等

調査試料は精度管理参加施設に全数（全調査項目について）送付する。なお、生化学関係の項目の一部または全部について、自施設では測定せず外部の登録衛生検査所に委託している場合にあっては、送付された試料を確認し、自施設で測定する試料を分別した後、外部委託する項目の試料を通常委託している登録衛生検査所に送付して測定させる。

(4) 測定結果の報告

（ア）測定結果の回答は、所定の様式に記入して報告する。
（イ）自施設で測定を行っていない調査項目については、当該外部委託する項目の試料を通常委託している登録衛生検査所に送付して測定させ、当該衛生検査所からの測定結果報告を確認後、所定の様式に記入して報告する。

(5) 補助調査

（ア）精度管理調査に関し必要な事項については、別途文書報告による調査を実施する。
（イ）健康診断施設が行う内部精度管理調査および健康診断施設が登録衛生検査所等に対して行う外部精度管理調査の実施内容等についても報告するものとする。

5 評価規準

別紙「臨床検査精度管理調査評価規準一覧」により評価する。
なお、評価は臨床検査専門委員会が行う。

6 参加申込期限

平成 28 年 11 月 21 日（月）

7 申込先

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
〒108-0014
東京都港区芝 4－11－5　田町ハラビル 5 階
TEL　03-5442-5934　FAX　03-5442-5937

8 参加費用

全衛連会員　50,000 円（税込 54,000 円）　その他会員以外　62,000 円（税込 66,960 円）

平成28年度（第25回）　臨床検査精度管理調査 補助調査票

参加施設コード							外部施設コード（＊検査機関のみ）			
施　設　名							記入者氏名			

1．精度管理等の実施　　＊２７年度実績で記入してください。

1-1臨床検査精度管理実施体制　◆該当項目に○をしてください。

担　当	選　任	職　　種	職 位・職 制（注）
精度管理責任者	有 ・ 無	a .医師　b.臨床検査技師　c. その他	a.　b.　c.　d.
精度管理担当者	有 ・ 無	a .医師　b.臨床検査技師　c. その他	a.　b.　c.　d.

注）職位・職制は、a:所長・局長クラス　b:部長・次長クラス　c:課長・補佐クラス　d:その他　のいずれかに○を付してください。

1-2全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無◆該当項目に○をして下さい。(　)には具体的に記入してください。複数選択可。

a.日本医師会　b.都道府県市　c.臨床衛生検査技師会　d.衛生検査所協会　e.総合健診医学会　f.ﾒｰｶｰ等(　　)

1-3 内部精度管理記録 ◆ 作製あるいは実施している項目に○をして下さい。複数選択可

a. 自施設測定に係る精度管理標準作業書　b. 精度管理図等図表記録　c. 関連項目との相関チェック　d. 測定装置の保守管理記録　e. 検査担当者の研修記録

1-4 内部精度管理の実施　◆ 該当項目に○を記入してください。その他の場合は（　）に具体的に記入してください。

検査項目	実施の有無	実施頻度		コントロール試料（複数使用している場合は全て記入してください。）		
		毎日1回以上	その他	市販品	自家製	濃度
生化学	有 ・ 無	(　　)	(　　)	a. 凍結コントロール血清 b. 凍結乾燥コントロール血清 c. 液状コントロール血清 d. その他　(　　)	(　　)	a. 2濃度 b. その他(　　)
血液	有 ・ 無	(　　)	(　　)	a. メーカー指定のコントロール試料 b. その他　(　　)	(　　)	a. 2濃度 b. その他(　　)
尿	有 ・ 無	(　　)	(　　)	a. メーカー指定のコントロール試料 b. その他　(　　)	(　　)	a. 2濃度 b. その他(　　)

1-5 外部委託先への精度管理調査　◆ 該当項目に○を、その他は具体的に記述して下さい

注）「同一検体ブラインド挿入」とは、同じ検体を2分割以上にして、2人分以上の検体として測定を依頼することをいいます。

検査項目	実施の有無	実施頻度および実施方法	同一検体ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入(注)	既知試料挿入	その他
生化学	有 ・ 無	a. 年1回　b. 半年1回　c. 月1回　d. その他	有 ・ 無	有 ・ 無	(　　)
血液	有 ・ 無	a. 年1回　b. 半年1回　c. 月1回　d. その他	有 ・ 無	有 ・ 無	(　　)

1-6 委託先との契約、管理体制　◆ 該当項目に○、所要日数以外複数選択可、その他を選択した場合は具体的に記述。

検査所要日数	a. 3日以内　b. 4日以上　c. その他（　　）
個人情報管理	a. P-マーク　b. ISO27001　c. その他（　　）
品質管理認定・認証	a. ISO 9001　b. ISO 15189　c. CAP　d. 日臨技　e. 医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ　f. その他（　　）
情報公開（注）	a. ホームページ　b. パンフレット　c. その他（　　）

注）測定項目および内部精度管理、外部精度管理に係る情報公開をどの媒体を使って行っているかについて回答

２．臨床検査実施数及び実施状況（平成27年度実績）

◆未実施・非該当項目には項目欄に斜線（/）を引いてください。

◆ 施設内測定を、自施設･職員が実施、運営委託(FMS方式)で実施、ブランチラボで実施別に「○印」を記入してください。

検査項目		年間施設内測定件数	年間外部委託測定件数	施設内測定の実態「○印」		
				自施設･職員	FMS方式	ブランチラボ
生化学項目	総コレステロール	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	中性脂肪	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	HDL コレステロール	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	LDL コレステロール	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	ＡＳＴ（ＧＯＴ）	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	ＡＬＴ（ＧＰＴ）	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	γ-ＧＴ(γ-ＧＴＰ)	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	尿酸	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	クレアチニン	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	血糖	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	ＨｂＡ1ｃ	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
血液項目	ヘモグロビン	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	赤血球数	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	白血球数	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	血小板数	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	ヘマトクリット値	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
尿項目	尿糖	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	尿蛋白	件	件	（　　）	（　　）	（　　）
	尿潜血	件	件	（　　）	（　　）	（　　）

３．検体の採取・搬送・授受等

3-1 血液検体（生化学･血液検査）

◆該当欄のa.b.c.d.のいずれかに○を記入してください。
◆複数の手法を採用している場合は、主たる手法(最も件数の多い手法)を記入してください。

検体の採取法	a. JCCLS ガイドライン準拠	b. ガイドライン未対応	c. ガイドライン準備中	d. 測定受託機関のため該当せず
検体の回収者	a. 健診スタッフ	b. 健診施設回収担当者	c. 測定機関回収担当者	d. 委託業者
検査外部委託までの保存法	a. 室　温	b. アイスボックス	c. 冷蔵庫	d. 測定受託機関のため該当せず
検査外部委託の記録	a. あ り	b. な し	c. 測定受託機関のため該当せず	
検体搬送時の温度管理	a. 実施し記録あり	b. 実施しているが記録なし	d. 未実施	

3-2 尿検体（尿糖･蛋白等検査）

◆該当欄のa.b.c.d.のいずれかに○印を記入してください。
◆複数の手法を採用している場合は，主たる手法(最も件数の多い手法)を記入してください。

尿検体の採取法	a. 自宅採尿	b. 健診現場で採尿（健診現場･自施設）		
尿検査の実施場所	a.出張健診現場	b. 自施設検査室	c. 外部委託検査機関	

＊ b.または c. を選択した場合のみ下記項目に回答してください。

尿検体の回収者	a. 健診スタッフ	b. 委託検査機関担当者		
尿検査実施までの保存法	a. 室　温	b. アイスボックス	c. 冷蔵庫	
尿検体授受担当者の記録	a. あ り	b. な し		
尿検体搬送時の温度管理	a. 実施し記録あり	b. 実施しているが記録なし	d. 未実施	

［提出用］

参加施設コード							外部施設コード ＊検査機関			
施設名						記入者氏名				

臨床検査の基準範囲に関する調査票（平成２８年度）

下記事項をお読みの上、検査基準範囲に関してご回答ください。

1. 「基準範囲」欄には、貴施設としてデータを判定する尺度として使用している基準範囲を記入してください（健診依頼先の要請による基準範囲等は除外）。
2. 男女別に基準範囲を設定していない場合は、項目欄の「男」を抹消してその欄に基準範囲を記入してください。
   また、男女別に基準範囲を設定している場合であって、記入欄が男女に区分されていない場合は、備考欄に女性の基準範囲を記入してください。
3. 「基準範囲の決め方」と、「基準範囲の変更」欄は、該当するアルファベット若しくは数字を○で囲んでください。
4. HbA1cについては、NGSP値で記入してください。
5. 血液学項目で標記単位が異なる場合は、単位を抹消し、新たに備考欄に使用単位を記入してください。
6. 「その他」を選択した場合は、出来るだけ具体的に備考欄に記入してください。

◆ 平成27年度以降の変更について記入してください。

［基準範囲の決め方］

a ：使用試薬の添付説明書記載値
b ：自機関で算出
c ：日本人間ドック学会の基準範囲
d ：日本臨床検査医学会の学生用基準範囲
e ：日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の共用基準範囲
f ：日本検査血液学会の血球計数項目の基準範囲
g ：学術文献の値
h ：その他（　　）

［基準範囲の変更］

0 ：変更なし
1 ：検査方法の変更
2 ：使用機器の変更
3 ：試薬の変更
4 ：基準範囲引用の変更
5 ：その他（　　）

項　目（単位）			基準範囲（下限～上限）	基準範囲の決め方	基準範囲の変更	備　考
総コレステロール	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
中性脂肪	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
HDL コレステロール	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
LDL コレステロール	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			

臨床検査の基準範囲に関する調査票（平成２８年度）

項　　目	(単位)		基準範囲（下限～上限）	基 準 範 囲 の 決 め 方	基準範囲の変更	備　　考
ＡＳＴ(GOT)	(U/L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ＡＬＴ(GPT)	(U/L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
γ－ＧＴ	(U/L)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
尿　　酸	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
クレアチニン	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
血　　糖	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ＨｂＡ１ｃ	(%)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ヘモグロビン	(g/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
赤 血 球 数	($10^4/\mu$L)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
白 血 球 数	($10^2/\mu$L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
血 小 板 数	($10^4/\mu$L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ヘマトクリット	(%)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ＭＣＶ	(fL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			