令和５年度（第32回）

臨床検査精度管理調査結果報告書

令和６年１２月

（公社）全国労働衛生団体連合会
総 合 精 度 管 理 委 員 会
臨 床 検 査 専 門 委 員 会

はじめに

労働者の健康診断は、労働安全衛生法の規定により事業者にその実施が義務づけられているが、多くの場合、企業外の健康診断機関によって行われている。

健康診断には、問診・診察・採血・採尿や各種生理機能検査等の実施、検体の運搬・保存・測定・健康診断結果の総合判定、さらには健康診断結果の事業場への報告および受診者個人への報告と多くのステップがあり、これらの各ステップで、医師・保健師・看護師・臨床検査技師・診療放射線技師・医療事務担当者等多くの職種の人たちがかかわっている。

そして健康診断の品質を良質なものとするためには、生産における品質管理と同様に健康診断の各ステップにおいて精緻な管理が求められる。このためひとつひとつの検査が十分な精度管理のもとで実施されることが重要である。

公益社団法人全国労働衛生団体連合会（全衛連）では、労働衛生検査（生物学的モニタリング検査）・臨床検査・胸部Ｘ線検査・胃Ｘ線検査および腹部超音波検査に係る精度管理調査を実施している。

本報告書は、令和５年度臨床検査に関する精度管理調査の実施結果をまとめたものである。なお、臨床検査精度管理調査の実施細目は巻末参考資料の項に掲載の「令和５年度臨床検査精度管理調査実施要領」を参照されたい。

また、各精度管理調査を企画・運営・管理するために設置されている総合精度管理委員会、及び臨床検査専門委員会委員は次ページのとおりである。

【総合精度管理委員会委員】

委員長　圓藤　吟史　中央労働災害防止協会　大阪労働衛生総合センター　所長
委　員　伊藤　春海　福井大学　名誉教授　岐阜大学　客員教授
同　　入口　陽介　地方独立行政法人　東京都立病院機構 東京都がん検診センター所長
同　　大内　憲明　東北大学　名誉教授　東北大学大学院　医学系研究科　特任教授
同　　岡庭　信司　飯田市立病院　診療技幹　内視鏡センター長
同　　神村　裕子　公益社団法人　日本医師会 常任理事
同　　川本　俊弘　中央労働災害防止協会　労働衛生調査分析センター　所長
同　　高木　　康　昭和大学　名誉教授
同　　福田　崇典　社会福祉法人　聖隷福祉事業団　理事　常務執行役員

【臨床検査専門委員会委員】

委員長　高木　　康　昭和大学　名誉教授
委　員　大久保滋夫　文京学院大学　保健医療技術学部　臨床検査学科　教授
同　　川合　陽子　国際医療福祉大学　臨床医学研究センター　教授
同　　久保田　亮　埼玉県立大学　保健医療福祉学部　健康開発学科　准教授
同　　久保野勝男　順天堂大学　医療科学部　臨床検査学科　特任教授
同　　栗原由利子　東京工科大学　医療保健学部　臨床検査学科　教授
同　　近藤　　弘　関西医療大学　保健医療学部　教授
同　　関　　顯　東海大学　医学部基礎診療学系　臨床検査学
同　　中川 央充　慶應義塾大学病院　臨床検査科
同　　森　　雄一　公益財団法人　神奈川県予防医学協会　専門委員
同　　安原　　努　昭和大学　准教授
同　　竹田　知広　関西医療大学　保健医療学部　臨床検査学科　教授

目　　次

Ⅰ．調査結果の概要
調査の目的 …… 3
調査対象施設 …… 3
調査の対象項目 …… 3
調査の実施方法 …… 3
調査参加施設数及び調査状況 …… 4
調査に使用した試料 …… 7
評価規準について …… 10
評価方法 …… 18

Ⅱ．調査試料測定結果（1）
調査項目の測定方法・測定機別実施施設数について …… 27
調査項目の測定方法別試料ごとの参加施設数・標準偏差・平均値について …… 27
調査項目の測定方法別試料ごとの平均値および平均値評価規準について …… 27

Ⅱ．調査試料測定結果（2）
調査項目別の評価点ランク別施設数・構成比 …… 47
測定法別の評価点ランク別施設数・構成比 …… 47
生血清・新鮮血液　測定法別の評価点ランク別施設数・構成比 …… 47
尿検査の測定法別の評価点ランク別施設数・構成比 …… 47

Ⅱ．調査試料測定結果（3）
調査参加全施設調査項目評価点一覧表 …… 65

Ⅱ．調査試料測定結果（4）
自施設測定施設の調査項目ごと測定法及び報告値一覧 …… 79
５試料を送付した項目について …… 79
３試料を送付したHDL・LDLコレステロール項目について …… 79
３試料を送付し、新鮮血液２試料の残余で検査したHbA1c項目について …… 79
５試料を送付した尿半定性検査について …… 79
加工血３試料と新鮮血液２試料を送付した血液検査について …… 79

Ⅱ．調査試料測定結果（5）
解析値結果 …… 157

Ⅲ. 各論的考察

【臨床化学検査】 …… 185
1）総コレステロール …… 188
2）中性脂肪 …… 190
3）尿酸 …… 192
4）クレアチニン …… 193
5）AST・ALT …… 195
6）γ-GT …… 197
7）血糖 …… 198
8）HDLコレステロール …… 200
9）LDLコレステロール …… 202
１０）HbA1c …… 204
【血液学検査】 …… 206
1）血液学検査評価方法 …… 206
2）測定試料 …… 206
3）調査項目 …… 207
4）まとめ …… 209
【尿検査】 …… 211
1）評価方法 …… 213
2）結果及び考察 …… 213
3）まとめ …… 219

Ⅳ. 補助調査集計結果

調査の目的 …… 223
調査実施時期 …… 223
調査対象期間 …… 223
調査対象施設 …… 223
調査事項 …… 223
調査票の回収率 …… 223

Ⅴ. 臨床検査の基準範囲に関する調査集計結果

基準範囲調査票集計結果について …… 243
基準範囲の決め方について …… 243
基準範囲の変更理由について …… 243

参考資料

１．令和５年度（第３２回）　臨床検査精度管理調査実施要領　…… 265
２．令和５年度（第３２回）　参加施設一覧　…… 268
３．令和５年度（第３２回）　精度管理外部機関一覧　…… 277
４．令和５年度（第３２回）　全衛連臨床検査精度管理調査 回答票　…… 279
５．令和５年度（第３２回）　臨床検査精度管理調査　補助調査票　…… 280
６．令和５年度（第３２回）　臨床検査の基準範囲に関する調査票　…… 283

Ⅰ．調査結果の概要

調査の目的

健康診断施設及び、測定依頼を受ける登録衛生検査所において、実施する臨床検査の検査精度を確認するとともに必要な指導を行うことにより、信頼性の高い優良な健康診断施設及び登録衛生検査所を育成することを目的としている。

調査対象施設

健康診断施設及び登録衛生検査所

調査の対象項目

1. 総コレステロール　2. 中性脂肪　3. 尿酸　4. クレアチニン　5. AST　6. ALT
7. γ-GT　8. 血糖　9. HDLコレステロール　10. LDLコレステロール　11. HbA1c
12. 尿糖（半定量）　13. 尿蛋白（半定量）　14. 尿潜血（定性）
15. ヘモグロビン量　16. 赤血球数　17. 白血球数　18. ヘマトクリット値
19. 血小板数　20. 平均赤血球容積　21. 白血球百分率

調査の実施方法

精度管理調査参加施設に下記に示す調査項目の試料すべてを送付して、測定結果を回答してもらい、測定値の精度を評価した。

(1) 調査項目及び送付試料数

① 総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖測定用

凍結品　5 試料

② HDLコレステロール・LDLコレステロール測定用

凍結乾燥品　2 試料 、 冷蔵品（生血清）　1 試料

③ HbA1c測定用

凍結乾燥品　2 試料 、冷蔵品（新鮮血液の残余）　2 試料

④ 尿糖・尿蛋白半定量、尿潜血定性用

凍結乾燥品　5 試料

⑤ ヘモグロビン量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット値・血小板数・平均赤血球容積測定用

冷蔵品（加工血液）2 試料

⑥ ヘモグロビン量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット値・血小板数・平均赤血球容積・白血球百分率測定用

冷蔵品（新鮮血液）2 試料

注 1）上記②の試料のうち、生血清 1 試料は参考試料とした。

注 2）上記⑥の試料のうち、新鮮血液 2 試料は 5 項目（調査の対象項目 17～21）の参考調査試料とした。

注３）上記⑥の新鮮血液２試料の残余を③の HbA1c の参考調査試料とした。

(2) 調査実施時期

試料送付　令和６年　１月　３０日（火）

報告期限　令和６年　２月　１３日（火）

(3) 検体検査を外部委託している場合

生化学関係の項目について全部あるいは一部を自施設では測定しないで登録衛生検査所に委託している施設については、全衛連より送付した試料のうち、外部委託する項目の試料を通常委託している登録衛生検査所に送付して測定させ、その上でその数値を回答していただいた。

調査参加施設数及び調査状況

第32回全衛連臨床検査精度管理調査の参加施設数は338施設で前回336施設より健康診断施設と登録衛生検査所それぞれに1施設増えた。参加機関から測定を受託する登録衛生検査所は60施設で、前回と同様であった。調査項目別に参加施設数を見ると、測定結果を回答しない施設があり、参加施設数に若干の差がある。参加施設数について、自施設測定施設数・外部施設測定施設数の構成比率および測定を受託する外部の登録衛生検査所数を表Ⅰ-1に示す。

調査対象とした項目は、従来通り総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖・HDLコレステロール・LDLコレステロール・HbA1c・尿糖（半定量）・尿蛋白（半定量）・尿潜血（定性）・赤血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積・白血球百分率の合計21項目である。これらの項目中、臨床化学検査では、HDLコレステロール及びLDLコレステロールについて前回同様に新鮮血清1種類を参考調査試料として加え、各施設では凍結乾燥品2種類のほかに、新鮮血清1種類を測定していただいた。

血液学検査では、平成１８年度(第15回)調査よりヒト生血液を参考調査試料として加えているが、今回も2種類のヒト生血液を参考調査試料として、全施設でこの試料2種類を測定していただいた。なお、平成２３年度（第20回）から血液学検査用新鮮血液試料にHbA1cの測定に可能な残余があれば、当該試料血液を利用してHbA1cを測定していただいているが、今回も同様に測定いただいた。

全衛連精度管理調査では、試料の凍結、破損等で測定不可能な場合には試料を再送付している。ただし、新鮮血液試料は保存に関して条件が異なってしまうため原則再送は行ってない。今回は溶血が認められた2施設より再送依頼があり、加工血試料の再送対応を行った。血液学検査用試料については必ず、測定前に溶血の有無の確認を行い、溶血が認

められた場合はその程度を4段階に分けて回答票により報告していただいているが、試料到着時には、ミクロヘマトクリット管を用いて遠心を行い、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が必要である。強溶血を認めた場合はコメント欄に記入するだけでなく、試料再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。また生血試料でのフィブリン析出、凝集などの報告数については「血液学」の項を参照されたい。

尿検査については338施設が参加しているが、このうち65施設（19.2%）が外部委託（前回59施設17.6%）している。健診の採算性を考慮した結果と想定されるが、逐年増加傾向である。採尿から検査実施までの時間的経過を考慮すると、尿検査の外部委託は推奨される方法ではない。尿検体は、採尿後2時間以内に検査することが望ましいため、全衛連では精度維持の観点から外部委託は推奨していないことを付記する。

表 I－１　項目別参加施設数および委託状況

調 査 項 目	参加 施設数	自施設 測定数	構成比 (%)	外部施設 測定数	構成比 (%)	受託 施設数
総コレステロール	337	129	38.3%	208	61.7%	60
中性脂肪	337	129	38.3%	208	61.7%	60
尿酸	337	129	38.3%	208	61.7%	60
クレアチニン	337	129	38.3%	208	61.7%	60
AST	337	129	38.3%	208	61.7%	60
ALT	337	129	38.3%	208	61.7%	60
γ-GT	337	129	38.3%	208	61.7%	60
血糖	337	129	38.3%	208	61.7%	60
HDL コレステロール	337	129	38.3%	208	61.7%	60
LDL コレステロール	337	129	38.3%	208	61.7%	60
HbA1c	336	127	37.8%	209	62.2%	59
尿糖	338	273	80.8%	65	19.2%	27
尿蛋白	338	273	80.8%	65	19.2%	27
尿潜血	338	273	80.8%	65	19.2%	27
赤血球数	336	127	37.8%	209	62.2%	60
ヘモグロビン量	336	127	37.8%	209	62.2%	60
ヘマトクリット値	336	127	37.8%	209	62.2%	60
白血球数	336	127	37.8%	209	62.2%	60
血小板数	336	127	37.8%	209	62.2%	60
平均赤血球容積	335	127	37.9%	208	62.1%	60
好中球	334	126	37.7%	208	62.3%	60
リンパ球	334	126	37.7%	208	62.3%	60
単球	334	126	37.7%	208	62.3%	60
好酸球	334	126	37.7%	208	62.3%	60
好塩基球	334	126	37.7%	208	62.3%	60

※ 特定項目だけの参加も参加施設数に含んでいます。

調査に使用した試料

全衛連では本調査開始当初（平成元年）から生化学 8 項目（総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT および血糖）については、ヒトプール血清を無菌処理したものを凍結試料としてきたが、ヒトプール血清の入手が極めて困難となったことなどから、平成２４年度（第 21 回）よりプール血清の代用としてオフクロット血清（Serum Off the Clot）を使用してきた。しかし、できるだけ新鮮血清に近いものという観点から、平成３１年度（第 28 回）から日本赤十字社による献血血液を基とした試料の調製に変更した。この変更に関し、従来の精度管理調査試料と同等な反応性を確認したうえで、同様な評価ができることを確認できたことから、その後継続して精度管理調査試料として使用することを決めた。今回（第 32 回）も同様の試料を基としている。

１）調査項目別試料

（1）総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖測定用試料

8 項目に係わる試料は今年度も日本赤十字社による献血血液を基とした試料を用いた。なお、試料調製に際してはメンブランフィルター（サイズ 0.45μm）で濾過後に、酵素活性レベルを高くするため、ヒト型のリコンビナント酵素を添加し、尿酸・クレアチニンおよびグルコースも前回同様にそれぞれ純品を添加した。保存剤・防腐剤および安定化剤の添加はしていない。配付用試料はさらに濃度調整を行い試料とした。

（2）HDL コレステロールおよび LDL コレステロール測定用試料

調査用に調製された凍結乾燥試料を用意した。さらに今回も健常成人ボランティア 2 名から採取した 2 種類の新鮮血清（以下「生血清」）を参考調査試料とした。

（3）HbA1c 測定用試料

調査用に作製したヒトヘモグロビン凍結乾燥試料。また、血液学試料として配付した新鮮血液 2 試料に残余ある場合、当該試料を参考調査試料とした。

（4）尿糖・尿蛋白半定量、尿潜血定性用試料

調査用に作製された凍結乾燥試料である。

（5）血液学検査用試料

従来通り各血球を個々の方法で固定し、安定剤を加えた加工血液（低・中・高値）を用意した。ただし、過去に配付した試料で、白血球数低値試料において測定機器

の関係もあって施設間差が大きかったことから、今回も白血球数が著しく低い試料は選択から除外している。また、今回も参考調査として健常成人ボランティア 2 人から採取した新鮮抗凝固血液（以下「新鮮血液」）2 本を参加施設に配付した。

２）調査試料のランダム化

全衛連精度管理調査の最大の特徴は調査試料のランダム化である。配付する試料数より多い濃度の試料を作製し、下記の条件で参加施設に送付した。

（1）総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖項目

今回も調査試料を 8 濃度（または 8 活性値）準備し、直線性の評価が可能なように最低濃度（または最低活性値）と次に低い濃度（または活性値）の試料のいずれかおよび最高濃度（または最高活性値）と次に高い濃度（または活性値）の試料のいずれかが必ず入る条件を設定し、選択された試料を除く残りの試料をランダム化した合計 5 試料を各施設に送付した。

（2）HDL・LDL コレステロール項目

濃度の異なる凍結乾燥品 3 試料をランダム化して 2 試料と、ボランティアから採取した生血清 2 試料をランダム化して 1 試料の、合計 3 試料を各施設に送付した。

（3）HbA1c 項目

濃度の異なる 3 試料をそれぞれランダム化して 2 試料を各施設に送付した。また、血液学検査用試料の新鮮血液 2 試料の残余血液を利用して、HbA1c の測定をお願いした。

（4）血液項目

調査用測定試料として、精度管理用に調製された濃度の異なる 3 種類の加工血試料（以下「加工血」）から全施設で測定する 1 試料と、残りの 2 試料のうち 1 試料をランダムに組み合わせた合計 2 試料及び、ボランティアから採取した新鮮血液 2 試料の、合計 4 試料を各施設に配付した。

（3）尿項目

調査用試料として精度管理用調査用に調製された、濃度の異なる 8 種類の加工尿試料（凍結乾燥試料）から、5 試料をランダムに組み合わせ各施設に配付した。

３）配付試料の安定性等確認

平成３１年度（第 28 回）より生化学検査項目の試料原料を従来のオフクロット血清から日本赤十字社献血血液を基とした血清に変更し、できる限り添加等を避けるよう配慮して作製した試料について、配付前に精度管理調査試料として試料の反応性と安定性を確認し、評価に特段問題が生じないことを確認したうえで今年度（第 32 回）も、精度管理調査試料として供することとした。

評価基準について

臨床検査精度管理調査における参加施設の報告値評価は、従来、一般的には報告値を同一測定法群（peer group）に分類した後、平均値、標準偏差を計算して平均値±3SD（または平均値±2SD*1）を越えるデータを極端値として棄却し、棄却後のデータから求めた平均値、標準偏差を基準として評価してきた。しかし、このようにして求めた平均値が真の値（true value）を代表する目標値（target value）として適切であるか否かについては長らく論議の的になってきた。この問いに答える目的で、全衛連総合精度管理委員会・臨床検査専門委員会は、参考値検討委員会を組織して検討を行った。

平成４年度（第 1 回）臨床検査精度管理調査においては、総コレステロール・AST（JSCC 標準化対応法）・ALT（JSCC 標準化対応法）・ヘモグロビンの 4 項目について参考値*2 を求めた。

平成５年度（第 2 回）からは、日本臨床化学会（JSCC）から中性脂肪測定の勧告法が発表されたことから、中性脂肪の参考値を加えた。平成６年度（第３回）からは、γ-GT の勧告法が発表されたことから、γ-GT（JSCC 標準化対応法）の参考値を加えた。血糖は平成１１年度（第８回）から参考値を求めた。

そして、平成１２年度（第９回）から上記７項目全ての測定法について、参考値を基準濃度として評価することにした。しかし、回を経るごとに参加機関の平均値と参考値が近接し、極めてよく一致してきた。この結果は日常検査の精密さ、正確さが年々向上しており、極端値棄却後の参加機関の平均値を真の値を代表する目標値として用いてもほぼ問題がないことを示した。

以上のことから、平成１９年度（第 16 回）から参考値評価を廃止し、全ての項目について同一測定法群の極端値棄却後の平均値を基準濃度（基準活性値）として用いて評価することとした。

なお、測定法分類で同一測定法群の n 数が 5 未満の測定法で、測定原理上他の平均値を用いて評価できない測定法については、計算された同一測定法群の統計量の統計的意義が乏しいことから「評価せず」としている。

*1 日医調査のように n 数が著しく多い場合には、極端値を平均値±3SD で棄却するが、本調査のように n 数が比較的小さい場合には、シミュレーションの結果から平均値±2SD で棄却する方が適切であることが判明している。

*2 参考値検討委員会（reference 施設 8 機関）で複数回（各施設ごとに、各々の試料につき 5 重測定を 3 日間（3 回）実施。各施設 1 試料につき合計 15 回）測定して得られた測定値の平均値。

１）全衛連の評価規準

臨床検査領域における測定法、測定試薬、測定技術を含む測定装置等の進歩により、精度管理調査における報告値の施設間差は、いずれの施設で実施されている調査結果を見ても近年著しく縮小している。その結果、報告値の評価法として一般的に用いられてきた

同一測定法群の SD（標準偏差）を基本とした統計学的評価法は、測定値の施設間差が縮小しても、常に同一比率で A・B・C・D が出現し、項目により必要以上に厳しい評価となることから、評価法に限界があることが問題となってきた。

欧米においては、個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準が測定法の性能評価の主流となりつつあったことから、全衛連臨床検査専門委員会では、個体の生理的変動を基本とした許容誤差規準の利用の可能性について検討を進めた。

その結果、この許容誤差規準を全衛連調査における評価規準として採用できることが判明したので、平成１８年度（第 15 回）全衛連調査から従来の評価規準を個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更して評価することにした。

この評価規準は全衛連の精度管理調査のみで使用されているため、評価規準設定の根拠および評価法の概要について今回も引き続いて解説する。

２）生理的変動を基本とした評価規準

(1) 生理的変動の性能評価への活用

個体の生理的変動は、個体内生理的変動と個体間生理的変動に分類されるが、その活用は、1996 年、北村[1)] が個体内生理的変動の標準偏差の 1/2 を測定誤差の許容範囲とする考え方を提唱したことに端を発している。現在では、その考え方が測定の“精密さ”の許容誤差として国際的にも広く認識されている。その後、測定の“精密さ”だけでなく、個体内生理的変動および個体間生理的変動から計算された測定値の“かたより”、および精密さとかたよりを統合した“総誤差”の許容誤差が加わっている。

以下にそれぞれの許容誤差に関する基本的な計算式とその解釈について示す。

① 精密さの許容誤差　CVA＜0.50CVI

分析の変動係数（CVA）が、個体内生理的変動（CVI）の 1/2 以下であるべきことを示す計算式となっている。

② かたよりの許容誤差　BA＜0.25（CVI2＋CVG2）1/2

分析のかたより（BA）が、個体内生理的変動と個体間生理的変動（CVG）から求めた総変動〔（CVI2＋CVG2）1/2〕の 1/4 以下であるべきことを示す計算式となっている。

③ 許容総誤差　TEa＜1.65（0.50CVI＋0.25（CVI2＋CVG2）1/2

許容総誤差（TEa）が、精密さの許容誤差の 1.65 倍（測定値の分布の片側 95%信頼区間に対する係数）とかたよりの許容誤差を加算した合計値以下であるべきことを示す計算式となっている。

(2) 生理的変動のデータベース

個体内生理的変動および個体間生理的変動に関する基礎データについては国内外において多くの報告が見られる。Fraser[2]は、生理的変動は人種、年齢、地域等に関係なくほぼ一定であるという十分な証拠があるので、この Ricos[3]らのデータベースを国際的に共通に活用することを提唱している。このデータベースは、米国においても Westgard[4]により管理法の設計の基礎デタとしても利用されている。そこで、全衛連臨床検査専門委員会では基礎データの国際的互換性の観点から、評価規準の計算に Ricos らのデータベースを使用することとした。

(3) Fraser による性能評価段階

Fraser は前述（1）①～③の許容誤差を、基本的な“望ましい性能”として位置づけ、この“望ましい性能”を中心として、さらにその 1/2 を“最適性能”、最適性能の 3 倍を“最低限の性能”とする 3 段階の評価段階を、上記①～③のそれぞれの許容誤差に設けている。彼は、これら 3 段階の許容誤差について以下のように述べている。すなわち、日常検査の実際の性能を考慮したとき、生理的変動から計算された“望ましい性能”を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用いる必要があり、一方、“望ましい性能”を満たすことが困難な成分については“最低限の性能”を評価規準として用いる必要があると述べており、普遍性のある生理的変動という明確な根拠を基本とした、性能規準の活用を推奨しながらも、現在の技術水準を考慮した許容誤差段階の選択という柔軟性のある対応をすることを勧めている。この Fraser の 3 段階の評価段階は、従来用いられてきた統計学的評価法の評価段階である 1SD、2SD、3SD の 3 段階と類似した形式になっているため、利用しやすい特長がある。

３）生理的変動を基本とした評価規準の一般的解釈

①精密さの許容誤差、②かたよりの許容誤差、③許容総誤差の 3 種類の許容誤差の適用範囲を考えると、一般的に①は、測定値の精密さの管理を目的とする内部精度管理用の規準として、②は、主として測定値の正確さの評価を目的とする場合の規準として、③は、検査室認定等の規準として適切であると考えることができる。

そのような観点から、全衛連臨床検査専門委員会では、評価規準の基本を②のかたより％の”望ましい性能”とすることとし、この性能を容易に満たすことができる成分については“最適性能”を評価規準として用い、また日常の性能が②のかたより％の望ましい性能を満たさない場合は、③の許容総誤差の望ましい性能を基本とすることにした。

なお、日本臨床化学会のクオリティマネジメント専門員会[6]においても、臨床化学成分の外部精度評価（精度管理調査）における許容誤差限界としてかたよりの許容誤差（BA）を用いることが適切であると述べている。

４）全衛連調査における評価規準としての考え方

(1) 評価規準の比較および検討

平成１７年度（第 14 回）全衛連調査結果をもとに、調査対象項目のうち臨床化学項目については比較的施設数の多い代表的な測定法の平均値、標準偏差およびそのデータから計算した CV%・2CV%・3CV%、血液学検査項目については従来の段階的評価規準（%）を用い、一方、各項目に対応する生理的変動のデータベースから②のかたよりの許容誤差、③の許容総誤差および Fraser の提唱する“最適性能”・“望ましい性能”・“最低限の性能”の 3 段階について計算し、平成１８年度（第 15 回）の評価規準の基礎データとした。

さらに臨床化学項目については、平成１８年度（第 15 回）全衛連の調査結果および平成１８年度（第 40 回）日本医師会臨床検査精度管理調査（日医調査）結果報告書から、全衛連調査対象項目について同様の計算を行った。

これらの比較データについて検討を行った結果、臨床化学項目については、かたより%の“望ましい性能”を基本的な評価規準として、精度管理調査からの日常の性能がそれよりも良好な場合には、“最適性能”を評価規準（A）とした。ただし、総コレステロールおよび血糖については、平成１８年度（第 15 回）は “最適性能”を評価規準（A）としたが、全衛連調査結果の CV%に比較して日医調査結果の CV%が大きいため、日医調査結果との整合性を考慮し、平成１９年度（第 16 回）から“望ましい性能”を評価規準とすることとした。HbA1c については日常の性能（CV%）が計算されたかたより%のいずれの性能規準をも超えることから、この項目に限って総誤差%の基本的な評価規準である”望ましい性能“を評価規準（A）とした。

血液学検査項目については平成１８年度（第 15 回）設定では、赤血球数・ヘマトクリット値の 2 項目で、従来の評価規準%がかたより%の“望ましい性能”を満たさず、一方“最低限の性能”を評価規準（A）として選択するとその%が総誤差%の“最適性能”を超えることとなった。血液検査項目間におけるかたより%と総誤差%の混在を避けるため、血液学検査項目全てについて総誤差%の“望ましい性能”を基本とするといずれの項目も従来の評価規準%がそれよりも小さいことから、平成１９年度（第 16 回）から総誤差%の“最適性能”を評価規準（A）とすることにした。しかし、その後の調査結果について検討を行ったところ、総誤差%の“最適性能”では、項目によりなお厳しい結果となることが判明したので、平成２３年度（第 20 回）から、ヘマトクリット値については、総誤差%の“望ましい性能”を評価基準（A）とした。参考調査項目の MCV についても同様に総誤差%の“望ましい性能”を評価基準（A）とした。

(2) 報告最小単位による評価規準

従来の評価で、調査結果の標準偏差が、報告最小単位以下となる項目があり、必要以上に厳しい評価となっていた問題については、この評価規準でも、同様に報告最小

単位から計算された%が、最小評価%（A）を超える項目が発生するため、主として米国で行われている例にならい、そのような項目については±報告最小単位による評価規準を別途設けて%評価といずれか大きい方を評価規準とする方式をとった。対象となった項目は、尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT、HbA1c・白血球数の 7 項目である。

(3) 第 32 回（令和 5 年度）全衛連精度管理調査の評価規準

（1）の評価規準の検討結果を踏まえて、今回も臨床化学検査と血液学検査項目では、表Ⅰ-2-1（臨床化学検査）・表Ⅰ-2-2（血液学検査）・表Ⅰ-2-3（血液学検査／白血球百分率）に示した基準表を作成し、報告値の点数付けと評価を行った。
尿検査の評価については、Ⅲ章各論的考察の【尿検査】の項を参照されたい。

参考文献

1）北村元仕：精度管理の方法と問題点.臨床化学検査.医学の歩み、
59 分冊：383-394,1966.
2）Fraser CG, Hyltoft Petersen P, Ricós C, Haeckel R: Proposed quality specifications for the imprecision and inaccuracy of analytical systems for clinical chemistry. Eur J Clin Chem Biochem, 30: 311-317, 1992.
3）Ricos C, Alverez V, Cava F, Garcia-Lario JV, Hernandez a, Jimenez CV, Minchinela J, Perich c, simon M,:Current databases on biologiCV ariation:p;ros,cons and progress. Scand J Clin Lab Invest 59:491-500,1999.
4）Westgard JO: Six Sigma Quality Design & Control. Westgard Inc.(Madison WI53717,USA),2006.
5）日本臨床化学会クオリティマネジメント専門委員会:プロジェクト報告生理的変動に基づいた臨床化学検査 36 項目における測定の許容誤差限界臨床化学
35：144-.153,2006.

表Ⅰ-2-1　生理的変動を基本とした測定値の評価規準（臨床化学検査）

調　査　項　目	試　料	評　価　規　準		評価点	評価
総コレステロール	試料番号 1～5		±0～4.0%	3	A
			±4.1～8.0%	2	B
			±8.1～12.0%	1	C
			±12.1%～	0	D
中性脂肪	試料番号 1～5		±0～5.3%	3	A
			±5.4～10.7%	2	B
			±10.8～16.0%	1	C
			±16.1%～	0	D

調　査　項　目	試　料	評価規準(いずれか大きい方)		評価点	評価
尿酸	試料番号 1～5	±0.1 mg/dL	±0～2.4%	3	A
			±2.5～4.8%	2	B
			±4.9～7.2%	1	C
			±7.3%～	0	D
クレアチニン	試料番号 1～5	±0.05 mg/dL	±0～3.4%	3	A
			±3.5～6.8%	2	B
			±6.9～10.2%	1	C
			±10.3%～	0	D
AST	試料番号 1～5	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D
ALT	試料番号 1～5	±1 U/L	±0～6.0%	3	A
			±6.1～12.1%	2	B
			±12.2～18.1%	1	C
			±18.2%～	0	D
γ-GT	試料番号 1～5	±1 U/L	±0～5.4%	3	A
			±5.5～10.8%	2	B
			±10.9～16.2%	1	C
			±16.3%～	0	D

調　査　項　目	試　料	評価規準		評価点	評価
血糖	試料番号 1～5		±0～2.2%	3	A
			±2.3～4.4%	2	B
			±4.5～6.6%	1	C
			±6.7%～	0	D

調　査　項　目	試　料	評価規準		評価点	評価
HDLコレステロール	試料番号 6～7		±0～2.6%	7	A
			±2.7～3.5%	6	B
			±3.6～4.4%	5	
			±4.5～5.2%	4	
			±5.3～6.5%	3	C
			±6.6～7.8%	2	
			±7.9～9.1%	1	D
			±9.2%～	0	
LDLコレステロール	試料番号 6～7		±0～3.4%	7	A
			±3.5～4.5%	6	B
			±4.6～5.6%	5	
			±5.7～6.8%	4	
			±6.9～8.7%	3	C
			±8.8～10.2%	2	
			±10.3～12.0%	1	D
			±12.1%～	0	

項　目		評価規準(いずれか大きい方)		評価点	評価
HbA1c	試料番号 9～10	±0.1%(結果)	±0～2.7%	7	A
			±2.8～3.6%	6	B
			±3.7～4.5%	5	
			±4.6～5.4%	4	
			±5.5～6.8%	3	C
			±6.9～8.1%	2	
			±8.2～9.5%	1	D
			±9.6%～	0	

表Ⅰ-2-2　生理的変動を基本とした測定値の評価規準（血液学検査）

調　査　項　目	試　料	評　価　規　準		評価点	評価
ヘモグロビン量	試料番号16～19		±0～2.1%	7	A
			±2.2～2.6%	6	B
			±2.7～3.3%	5	
			±3.4%～4.1%	4	
			±4.2～5.5%	3	C
			±5.6～6.2%	2	
			±6.3～7.6%	1	D
			±7.7%～	0	
赤血球数	試料番号16～19		±0～2.2%	7	A
			±2.3～2.8%	6	B
			±2.9～3.6%	5	
			±3.7%～4.4%	4	
			±4.5～5.9%	3	C
			±6.0～6.6%	2	
			±6.7～8.1%	1	D
			±8.2%～	0	

調　査　項　目	試　料	評価規準(いずれか大きい方)		評価点	評価
白血球数	試料番号16～19	$\pm 1\times10^{2}$	±0～7.3%	7	A
			±7.4～9.1%	6	B
			±9.2～11.7%	5	
			±11.8%～14.6%	4	
			±14.7～19.5%	3	C
			±19.6～21.9%	2	
			±22.0～26.8%	1	D
			±26.9%～	0	

調　査　項　目	試　料	評　価　規　準		評価点	評価
ヘマトクリット値	試料番号16～19		±0～4.1%	7	A
			±4.2～5.2%	6	B
			±5.3～6.7%	5	
			±6.8%～8.2%	4	
			±8.3～11.0%	3	C
			±11.1～12.3%	2	
			±12.4～15.2%	1	D
			±15.3%～	0	
血小板数	試料番号16～19		±0～6.7%	7	A
			±6.8～8.4%	6	B
			±8.5～10.8%	5	
			±10.9%～13.4%	4	
			±13.5～17.9%	3	C
			±18.0～20.1%	2	
			±20.2～24.6%	1	D
			±24.7%～	0	
平均赤血球容積(MCV	試料番号16～19		±0～2.3%	7	A
			±2.4～3.1%	6	B
			±3.2～3.8%	5	
			±3.9%～4.6%	4	
			±4.7～5.8%	3	C
			±5.9～6.9%	2	
			±7.0～8.1%	1	D
			±8.2%～	0	

表Ⅰ-2-3　生理的変動を基本とした測定値の評価規準（血液学検査/白血球百分率）

参考調査項目	試料	評価規準		評価点	評価
白血球百分率 好中球(%)	試料番号18～19		±0～11.2%	7	A
			±11.3～14.9%	6	B
			±15.0～18.7%	5	
			±18.8%～22.4%	4	
			±22.5～28.0%	3	C
			±28.1～33.6%	2	
			±33.7～29.2%	1	D
			±39.3%～	0	
白血球百分率 リンパ球(%)	試料番号18～19		±0～8.0%	7	A
			±8.1～10.7%	6	B
			±10.8～12.3%	5	
			±13.4%～16.0%	4	
			±16.1～20.0%	3	C
			±20.1～24.0%	2	
			±24.1～28.0%	1	D
			±28.1%～	0	
白血球百分率 単球(%)	試料番号18～19		±0～14.0%	7	A
			±14.1～18.7%	6	B
			±18.8～23.3%	5	
			±23.4%～28.0%	4	
			±28.1～35.0%	3	C
			±35.1～42.0%	2	
			±42.1～49.0%	1	D
			±49.1%～	0	
白血球百分率 好酸球(%)	試料番号18～19		±0～18.6%	7	A
			±18.7～24.8%	6	B
			±24.9～31.0%	5	
			±31.1%～37.2%	4	
			±37.3～46.5%	3	C
			±46.6～55.8%	2	
			±55.9～65.1%	1	D
			±65.2%～	0	
白血球百分率 好塩基球(%)	試料番号18～19		±0～19.3%	7	A
			±19.4～25.7%	6	B
			±25.8～32.2%	5	
			±32.3%～38.6%	4	
			±38.7～48.3%	3	C
			±48.4～57.9%	2	
			±58.0～67.6%	1	D
			±67.7%～	0	

評価方法

１）平均値評価

前述のとおり、全ての項目で同一測定法群（peer group）の極端値棄却後の平均値を基準濃度とし、評価範囲は生理的変動を基本とした測定値の評価規準に示した評価規準で評価した。ただし、測定原理上同一平均値が得られると判断できる測定法群は、まとめて平均値を計算してその平均値を基準濃度とした

(1) 各試料の評価点および評価

各調査項目での試料測定濃度について、評価基準内の評価点、および評価点に対する（A～D）評価については前ページに掲載した表Ⅰ-2-1・表Ⅰ-2-2・表Ⅰ-2-3のとおりとした。

(2) 複数試料の評価点

①8試料（各施設への送付は5試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した点数をその施設の評価点とした。

5試料の評価点の例：各試料の評価点が3点（A）であった場合は、3×5＝15点で100点満点となる。

評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表Ⅰ-3のとおりである。

表Ⅰ-3　15点満点の評価点と100点満点換算点対比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	6.7	13.3	20.0	26.7	33.3	40.0	46.7	53.3	60.0
評価点合計	10	11	12	13	14	15			
換算点合計	66.7	73.3	80.0	86.7	93.3	100			

②3試料（各施設への送付は2試料）の評価点

各試料の評価点を合計し、100点満点に換算した換算点をその施設の評価点とした。

3試料の評価点の例：各試料の評価点が7点（A）であった場合は、7×2=14点で100点満点となる。評価点合計を100点満点に換算した換算点合計の関係は表Ⅰ-4のとおりである。

表Ⅰ-4　14点満点の評価点と100点満点換算点対比

評価点合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
換算点合計	7.1	14.3	21.4	28.6	35.7	42.9	50.0	57.1	64.3
評価点合計	10	11	12	13	14				
換算点合計	71.4	78.6	85.7	92.9	100				

③ 尿検査の評価

尿糖半定量、尿蛋白半定量および参考項目である尿潜血半定量の評価方法は従来どおりであるが、その内容はⅢ章各論的考察の「尿検査」の項を参照されたい。

２）解析値評価

段階的に混合した試料5試料を送付している総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT の8項目については、従来通り測定値評価に加えて試料濃度に対する直線性、各試料間の関係、及び精密度などの解析値による評価を行った。

なお、HDL コレステロール・LDL コレステロール・HbA1c・ヘモグロビン量・赤血球数・白血球数・ヘマトクリット値・血小板数については送付試料数が少ないため、解析値評価は行なっていない。

(1) 解析値評価の種類と計算

各施設の全測定結果（5試料）について、施設別と項目別に、以下の5種類の計算を行った。

1. 方向係数　$Y = a + bX$　の b （以下これを回収率という）
2. ばらつきの程度(再現性) （$\sqrt{V_E}$）
3. 測定値を含む確率楕円の長軸の傾きの正切（測定のばらつき） (tanθ)
4. パフォーマンス・インデックス1 (PI-1)
5. パフォーマンス・インデックス2 (PI-2)

(2) 解析値評価の解説

① 回帰分析

試料濃度を X_i、測定値を Y_iとすると、試料数から5組の変数ができる。

いま X を指定変数、Y を従属変数とすると、

回帰直線　　$Y = a + bX$

を求めることができる。測定値が全て平均値と一致した場合には

回帰式は　　$Y = 1.00X$

となるが、実際には平均値と測定値の間に差があるため、

$Y = a + bX$ という形になる。

したがって、この方向係数、すなわち b によって比例系統誤差（濃度に関係なく一定比率で生じている誤差）を推定できる。そこで、b を回収率として評価すると、b が1.00に近いほど評価点が高くなる。

一方、回帰直線が Y 軸と交わる切片 a によって一定系統誤差（濃度に関係なく一定

の大きさで生じる誤差）が推定でき、aの値が0から大きくずれていると、測定値に一定の大きさでかたよりが生じていることになるので、aでも評価できる。しかし、測定値に対する評価を試料ごとに行っているので、aについては評価項目としてとりあげていない。

また、回帰分析に対する分散分析を行って、再現性（$\sqrt{V_E}$）を求めると、この値が小さいほど評価点が高くなる。

② 方向係数（回収率）b

回帰分析の手順にしたがって、次式により、方向係数bを求め、これを回収率とした。

$$b=\frac{n\sum \mathrm{X}i\mathrm{Y}i-\sum \mathrm{X}i\sum \mathrm{Y}i}{n\sum \mathrm{X}i^2-\left(\sum \mathrm{X}i\right)^2}$$

③ 再現性$\sqrt{V_E}$

測定値Y_iの変動（全変動SO）は、指定変動である平均値の変動（回帰による変動SR）と、測定誤差による変動（回帰からの変動SE）とを含んでいる。測定誤差による変動は直接求めることはできないが、全変動SOから、回帰によるSRを差し引いたものとして求めることができる。

全　　変　　動 ―――― SO $=\Sigma\left(Y_i-\overline{Y}\right)^2$

回帰による変動 ―――― SR $=b^2\Sigma\left(X_i-\overline{X}\right)^2$

であるので、

回帰からの変動 ―――― SE ＝SO－SR

となり、これによって測定誤差による変動を求めることができる。

このSEを自由度（n-2）で割ったものの平方根$\sqrt{V_E}$を再現性としたが、これはσｙｘとして表されたり、回帰直線に関する標準偏差ともいわれているものである。

$\sqrt{V_E}$の値が小さければ小さいほど評価点はよくなる。この値は平均値の値によっても変わることから、できるだけ同じ条件で評価できるように、$\sqrt{V_E}$の評価に当っては

$$\sqrt{\frac{1}{n}\sum \chi_i^{\,2}}$$

に定数を掛けた数値を区切り値とした。

④ tanθ（確率楕円の長軸の傾き角の正切）

回帰直線は、測定値群から最小2乗法によって求められるものである。

測定値をグラフ上にプロットしてみると、それらの点は当然回帰直線の両側にばらつ

いている。それからそれらの測定値を含む確率楕円を求めることができる。理想的な場合にはこの確率楕円のふくらみはなくなり、回帰直線と一致するはずである。しかし、測定値のばらつきが大きくなるとこのふくらみが大きくなり、さらに楕円の長軸の方向も回帰直線の方向から離れてくる。したがって、この確率楕円の長軸の傾き角によって測定のばらつきを知ることができる。実際には次式を用いて、長軸の傾き角の正切（tanθ）によってばらつきを調べている。tanθは、次式により求めた。（土屋・杉田・桜井　産業医学、247, 20　1978）

$$\tan\theta = \frac{-\left(\sigma^2\chi - \sigma^2 y\right) + \sqrt{\left(\sigma^2\chi - \sigma^2 y\right)^2 + 4\sigma^2\chi y}}{2\sigma\chi y}$$

σ^2χ、σ^2ｙ は平均値X_i、測定値Y_iの分散、σχｙは共分散で、X_i、Y_iの変動（平均からの差の平方和）を自由度（n-1）で割ったものであるが、上式で明らかなように、変動そのもので計算しても同じ結果が得られるので、変動そのもので計算した。

tanθによる評価：
実際には測定結果一覧表から、tanθの値を求めると、ほとんどの場合回収率 b の値に一致しているか、それと近い値であるが、$\sqrt{V_E}$ の値が大きくなればなるほど、2つの間の差が大きくなる。そこで回収率は、方向係数 b とこのtanθの値とを合わせて総合評価することとした。

⑤ パフォーマンス・インデックス

Performance Index（PI）は、誤差（測定値と平均値の差）の絶対値と、平均値の比で表したもので、次の2つの計算式から求める。

$$\mathrm{PI}-1 = \frac{\sum\left|Y_i - X_i\right|}{\sum X_i}$$

$$\mathrm{PI}-2 = \frac{1}{n}\sum\frac{\left|Y_i - X_i\right|}{X_i}$$

PI-1は、各調査項目の5試料全部の各平均値と測定値との間の差の絶対値の合計と、平均値の合計との比であり、PI-2はそれぞれの試料ごとの平均値と測定値との間の差の絶対値と、平均値との比を求めた、5試料についてのものである。

以上から、測定項目ごとの平均値が同程度であれば、いずれのPIも、ほぼ同じ値にな

るが、平均値が低濃度から高濃度までの広い範囲にわたっている場合には、PI-1とPI-2の間には、差が生じることがある。

PIは測定誤差の絶対値と、平均値との間の比を表す値であるので、当然PI値が小さければ小さい程、評価点は高くなり、PIの値が0.1以下であれば、信頼度が非常に高いと考えてよい。令和5年度の解析値平均と標準偏差を表Ⅰ-5に示す。

表Ⅰ-5　解析値平均と標準偏差

	調査項目	測定法	区分	y切片	回収率	再現性	tan θ	PI1	PI2
1	総コレステロール	コレステロール酸化酵素法	平均値	-0.066013167	1.001587938	0.600128343	1.001806084	0.004934142	0.004980309
			標準偏差	2.135252531	0.012578471	0.290358805	0.012558094	0.002745212	0.002794251
2	中性脂肪	酵素UV法･比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	平均値	0.467627679	0.997031525	0.449262278	0.997112124	0.006774277	0.006886191
			標準偏差	1.306034766	0.012975454	0.226693075	0.013050603	0.003966329	0.004028755
3	尿酸	ｳﾘｶｰｾﾞ･ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	平均値	-0.021523239	1.003913696	0.026519189	1.004114205	0.005651894	0.005831428
			標準偏差	0.112398101	0.017348629	0.020906018	0.016997191	0.003893027	0.00380968
4	クレアチニン	酵素法	平均値	-0.008694826	1.003141285	0.013811737	1.003175475	0.009642401	0.012024854
			標準偏差	0.031130315	0.014119455	0.008203421	0.014134072	0.004931619	0.005763196
		ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘ法富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ(富士ﾌｲﾙﾑ)	平均値	0	1	0	1	0	0
			標準偏差	0	0	0	0	0	0
5	AST	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	0.053987158	0.998268662	0.431175634	0.998315287	0.009239964	0.009886975
			標準偏差	0.488762735	0.012410492	0.236628109	0.012401281	0.006113377	0.007137966
6	ALT	標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	0.076486827	0.995565228	0.508202867	0.995644623	0.012241023	0.014161629
			標準偏差	0.652041522	0.01353504	0.222483103	0.013526419	0.006433774	0.006265414
7	γ-GT	JSCC標準化対応法	平均値	0.211707025	1.001772305	0.475904204	1.001828542	0.011755347	0.012692874
			標準偏差	0.679408485	0.012101013	0.210747513	0.012112417	0.006601271	0.00690615
8	血糖	ﾌﾟﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ･UV法/ﾌﾟﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	平均値	0.041322565	1.001484969	0.351624292	1.001517026	0.005438973	0.005460294
			標準偏差	0.702750142	0.007782589	0.18214824	0.007782667	0.003841319	0.004063684

3）評価点

5種類の解析値評価法のそれぞれについて全施設の解析値の2SD以内をA、3SD以内をB、4SD以内をC、これを超えるものをDとした。なお、配点は平均値評価と同じである。5種類の解析評価法全てが評価Aであれば、合計15点となる。これを100点満点に換算して解析値評価点とする。

4）総合点評価

掲載する図Ⅰ-1と図Ⅰ-2は各施設に送付する「評価評点一覧票」である。測定値記入欄には試料の基準濃度（平均値）とその施設の測定値を二段にわけて記載されるが、ここで、鎖線「-------」の表記があるのは、ランダム配付を行っているため、該当する試料が当該施設に送られてないことを示す。「試料ナンバー別測定評価」欄には、送られた試料についての評価結果（A～D）となる。

評価結果（A～D）を項目別に表Ⅰ-2-1（臨床化学検査）・表Ⅰ-2-2（血液学検査）・表Ⅰ-2-3（血液学検査／白血球百分率）に示した基準表に基づいて点数換算して、換算した測定値評価点（換算点合計）・解析値評価点（換算点合計）を平均して総合評価点とした。

図Ⅰ－1

《令和5年度　全衛連　第32回　臨床検査精度管理調査　評価評点一覧票》

施設名［　　］

調査項目	外部機関コード		測定法	測定値 試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	試料NO別測定評価 1 2 3 4 5 6 7 8	測定値評価点	解析値評価点	総合評価点	過去の評価点 第31回	第30回	第29回
総コレステロール		平均値	11	149	161	172	184	196	207	219	231							
		測定値		=====	160	173	184	=====	205	=====	229	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	86.7	93.3	100.0	100.0	100.0
中性脂肪		平均値	21	78	87	96	105	114	123	132	141							
		測定値		=====	87	96	105	=====	123	=====	141	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
尿酸		平均値	31	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8							
		測定値		=====	5.4	5.8	6.2	=====	6.9	=====	7.8	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
クレアチニン		平均値	21	0.48	1.11	1.75	2.39	3.05	3.70	4.34	4.99							
		測定値		=====	1.12	1.74	2.39	=====	3.68	=====	4.97	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
AST		平均値	11	19	37	55	73	91	109	128	146							
		測定値		=====	37	55	73	=====	109	=====	145	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
ALT		平均値	11	18	34	50	65	81	97	112	128							
		測定値		=====	34	49	65	=====	96	=====	128	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0
γ－GT		平均値	11	30	48	66	84	102	121	139	157							
		測定値		=====	48	66	84	=====	120	=====	156	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	100.0	100.0	100.0	90.0	100.0
血糖		平均値	21	72	91	110	129	148	167	186	205							
		測定値		=====	90	110	128	=====	166	=====	203	－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ－－Ａ	100.0	86.7	93.3	86.7	100.0	93.3
HDLコレステロール		平均値	01-0403	34	46	49	76	55										
		測定値		33	=====	49	77	=====				Ａ－－Ａ Ａ－－	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	92.9
LDLコレステロール		平均値	01-0403	71	100	133	88	170										
		測定値		71	=====	133	87	=====				Ａ－－Ａ Ａ－－	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	100.0
HbA1c		平均値	02-0404	5.7	＊ 6.7	7.7	6.5	5.1										
		測定値		5.7	=====	7.7	6.6	5.1				－－－－－－－－－－－－－－	=====	=====	=====	100.0	100.0	100.0
尿糖		設定値	1	1	3	3	3	4	4	1	4							
		判定値		1	=====	=====	3	4	4	=====	4	Ａ－－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	100.0
尿蛋白		設定値	1	3	1	3	4	3	4	4	1							
		判定値		3	=====	=====	4	3	4	=====	1	Ａ－－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	100.0
尿潜血		設定値	1	1	1	4	3	1	3	3	3							
		判定値		1	=====	=====	3	1	3	=====	3	Ａ－－－Ａ Ａ Ａ－－Ａ	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	92.0

図Ⅰ－2

施設名［　　］

調査項目	外部機関コード		測定法/装置コード	測定値 試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8	試料NO別測定評価 1 2 3 4 5 6 7 8	測定値評価点	解析値評価点	総合評価点	過去の評価点 第31回	第30回	第29回
赤血球数		平均値	JAB519	537	465	242	372	363										
		測定値		540	444	=====	374	361				Ａ Ｃ－－Ａ Ａ	100.0	=====	100.0	=====	100.0	100.0
ヘモグロビン		平均値	2	16.8	12.4	5.9	10.2	12.0										
		測定値		16.9	12.5	=====	10.2	12.1				Ａ Ａ－－Ａ Ａ	100.0	=====	100.0	100.0	100.0	100.0
ヘマトクリット		平均値	JAB519	47.4	＊ 38.0	＊ 17.0	32.4	35.1										
		測定値		47.1	34.9	=====	32.4	35.1				－－－－－－－－－－－－－－	=====	=====	=====	=====	=====	=====
白血球数		平均値	JAB519	33	＊ 62	＊ 78	88	37										
		測定値		32	71	=====	85	36				－－－－－－－－－－－－－－	=====	=====	=====	=====	=====	=====
血小板数		平均値	JAB519	13.8	＊ 21.5	＊ 31.9	35.6	18.4										
		測定値		14.6	24.6	=====	36.9	18.7				－－－－－－－－－－－－－－	=====	=====	=====	=====	=====	=====
平均赤血球容積（※）		平均値	JAB519	88.4	＊ 81.4	＊ 70.4	86.8	97.5										
		測定値		87.2	78.6	=====	86.6	97.2				－－－－－－－－－－－－－－	=====	=====	=====	=====	=====	=====
好中球（※）		平均値	JAB519	=====	=====	=====	54.3	59.0					全試料平均点		99.1			
		測定値					54.6	59.7				－－－－－－－－						
リンパ球（※）		平均値	JAB519	=====	=====	=====	38.1	31.0										
		測定値					37.5	30.9				－－－－－－－－						
単球（※）		平均値	JAB519	=====	=====	=====	4.5	7.1										
		測定値					4.5	6.9				－－－－－－－－						
好酸球（※）		平均値	JAB519	=====	=====	=====	2.7	1.4										
		測定値					2.8	1.3				－－－－－－－－						
好塩基球（※）		平均値	JAB519	=====	=====	=====	0.6	1.5										
		測定値					0.6	1.2				－－－－－－－－						

■調査項目に（※）が付いているのは、参考調査項目です。

■同じ測定方法もしくは測定装置コードの参加施設数が5件未満の試料の平均値には＊印が付いています。【評価せず】の対象です。

■全試料平均点には、平均赤血球容積（※）、試料4、5（生血清）のHDL・LDLコレステロール、および試料4、5（生血）のHbA1c、ヘマトクリット、白血球数、血小板数、および試料4、5（生血清）の赤血球数、試料1、2、3（加工血）のヘモグロビンの総合評価点は含まれていません。

Ⅱ．調査試料測定結果（1）

調査項目の測定方法・測定機別実施施設数について

今回参加した施設が、調査項目の測定に採用している測定法と測定装置についての一覧を表Ⅱ-1-1と表Ⅱ-1-2に示した。

備考欄の「評価せず」については、データ数5以下の統計量で計算された標準偏差は統計的意義に乏しいことから、同一の測定法あるいは同一の測定装置を使用している施設が5施設以下だった場合には備考欄に「評価せず」と記載した。

なお、受託している検査施設について、受託している施設数で計上するか、同一の検査方法であるため検査施設数を1として計上するかについては、平成２６年度（第23回）より検査施設単位で計上している。実施施設数が5を超えても「評価せず」と記載されているのはこのためである。

表Ⅱ-2-1～2-3には、評価した測定方法及び測定機を採用している施設数を自施設測定施設と外部測定施設とに分けて示した。

調査項目の測定方法別試料ごとの参加施設数・標準偏差・平均値について

表Ⅱ-3-1～3-8に、測定方法と測定機別に送付した試料から算出した測定値の平均値±2SD以内の施設数・標準偏差・平均値を示す。

ここで示した標準偏差は、調査項目欄で示した測定法群に属する令和５年度（第32回）精度管理調査の測定値から求めており、全衛連調査における項目別、同一測定法群別の現行の技術水準と見なされる。

調査項目の測定方法別試料ごとの平均値および平均値評価規準について

表Ⅱ-4-1～4-3には「Ⅰ.調査結果の概要」の文末に掲載した表Ⅰ-2-1・表Ⅰ-2-2・表Ⅰ-2-3の評価規準（%）に沿って今回の平均値を実際の値に換算し、各試料についての「平均値評価規準」の値として示した。

表Ⅱ-1-1 平均濃度評価実施の測定方法・測定機種分類一覧
（総コレステロール～ヘモグロビン量）

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	実施施設数	備考
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	11	ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法	337	
中性脂肪	11	酵素UV法 ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	2	
	21	酵素比色法 ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	335	
尿酸	31	ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	337	
クレアチニン	21	酵素法	336	
	82	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘ法富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ（富士ﾌｲﾙﾑ）	1	評価せず
AST	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	337	
ALT	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	337	
γ-GT	11	JSCC標準化対応法	337	
血糖	12	ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法	30	
	21	ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法	306	
	31	ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	1	
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	沈殿操作を行わない方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄHDL-C)	156	
	01-1201	沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	177	
	01-2304	沈殿操作を行わない方法 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(Lﾀｲﾌﾟﾜｺｰ HDL-CM3)	4	評価せず
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄLDL-C)	157	
	01-1201	積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	174	
	01-2302	富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(Lﾀｲﾌﾟﾜｺｰ LDL-C M)	6	評価せず
HbA1c	01-2701	HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	27	
	01-2901	HPLC法 東ｿｰ	50	
	02-0403	免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(汎用自動分析装置)液状品	94	
	02-0404	免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)液状品	10	評価せず
	02-2401	免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	4	評価せず
	03-0401	酵素法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ	132	
	03-1201	酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ（ﾉﾙﾃﾞｨｱ N HbA1c HbA1cｵｰﾄ「TBA」）	7	評価せず
	03-1202	酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ（Lﾀｲﾌﾟ ﾉﾙﾃﾞｨｱ N HbA1c）	2	評価せず
	03-2701	酵素法 ｱｰｸﾚｲ	4	評価せず
	03-3501	酵素法 日本電子	6	評価せず
尿糖	1	試験紙法 目視判定	116	
	2	試験紙法 機器測定	222	
尿蛋白	1	試験紙法 目視判定	116	
	2	試験紙法 機器測定	222	
尿潜血	1	試験紙法 目視判定	116	
	2	試験紙法 機器測定	222	
赤血球数		JAB512	105	
		JAB514	9	
		JAB516	1	
		JAB517	178	
		JAB519	6	
		JAB521	29	
		JAJ012	3	
		JAJ803	1	
		JAR408	2	
		JAS304	1	
		JAZ999	1	
ヘモグロビン量	1	ｼｱﾝﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法	8	
	2	非ｼｱﾝ界面活性剤法	303	
	9	その他（SLS-ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法/ｵｷｼﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ変法）	25	

表Ⅱ-1-2 平均濃度評価実施の測定方法・測定機分類一覧
（ヘマトクリット値～平均赤血球容積）

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	実施施設数	備考
ヘマトクリット値		JAB512	105	
		JAB514	9	評価せず
		JAB516	1	評価せず
		JAB517	178	
		JAB519	6	評価せず
		JAB521	29	
		JAJ012	3	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	2	評価せず
		JAS304	1	評価せず
		JAZ999	1	評価せず
白血球数		JAB512	105	
		JAB514	9	評価せず
		JAB516	1	評価せず
		JAB517	178	
		JAB519	6	評価せず
		JAB521	29	
		JAJ012	3	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	2	評価せず
		JAS304	1	評価せず
		JAZ999	1	評価せず
血小板数		JAB512	105	
		JAB514	9	評価せず
		JAB516	1	評価せず
		JAB517	178	
		JAB519	6	評価せず
		JAB521	29	
		JAJ012	3	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	2	評価せず
		JAS304	1	評価せず
		JAZ999	1	評価せず
平均赤血球容積		JAB512	105	
		JAB514	9	評価せず
		JAB516	1	評価せず
		JAB517	177	
		JAB519	6	評価せず
		JAB521	29	
		JAJ012	3	評価せず
		JAJ803	1	評価せず
		JAR408	2	評価せず
		JAS304	1	評価せず
		JAZ999	1	評価せず

表Ⅱ-2-1　評価した測定方法・測定機採用施設件数（総コレステロール～ヘマトクリット値）

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	自施設	外部施設	合計
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	11	ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法	129	208	337
中性脂肪	11・21	酵素UV法・比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	129	208	337
尿酸	31	ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	129	208	337
クレアチニン	21	酵素法	128	208	336
	82	ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘ法富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ（富士ﾌｲﾙﾑ）	1	0	1
AST	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	129	208	337
ALT	11	標準化対応法JSCC標準化対応法	129	208	337
γ-GT	11	JSCC標準化対応法	129	208	337
血糖	12・21・31	ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法/ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	129	208	337
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	沈殿操作を行わない方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪ	69	87	156
	01-1201	沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄ	57	120	177
	01-2304	沈殿操作を行わない方法 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰHDL-	3	1	4
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄLDL-C)	70	87	157
	01-1201	積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	54	120	174
	01-2302	富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰLDL-C M)	5	1	6
HbA1c	01-2701	HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	25	2	27
	01-2901	HPLC法 東ｿｰ	42	8	50
	02-0403	免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(汎用自動分析装置)液状品	7	87	94
	02-0404	免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)液状品	8	2	10
	02-2401	免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	2	2	4
	03-0401	酵素法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ	30	102	132
	03-1201	酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ（ﾉﾙﾃﾞｨｱ N HbA1c HbA1cｵｰﾄ「TBA」）	6	1	7
	03-1202	酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ（Lﾀｲﾌﾟ ﾉﾙﾃﾞｨｱ N HbA1c）	2	0	2
	03-2701	酵素法 ｱｰｸﾚｲ	0	4	4
	03-3501	酵素法 日本電子	5	1	6
尿糖	1・2	試験紙法 目視判定・機器測定	273	65	338
尿蛋白	1・2	試験紙法 目視判定・機器測定	273	65	338
尿潜血	1・2	試験紙法 目視判定・機器測定	273	65	338
赤血球数		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	75	103	178
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ量	1・2・9	ｼｱﾝﾒﾄﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法・非ｼｱﾝ界面活性剤法・その他（SLS-ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ法	127	209	336
ヘマトクリット値		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	75	103	178
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1

表Ⅱ-2-2　評価した測定方法･測定機採用施設件数（白血球数～リンパ球）

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	自施設	外部施設	合計
白血球数		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	75	103	178
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
血小板数		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	75	103	178
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
平均赤血球容積		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	75	102	177
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
好中球		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	74	102	176
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
リンパ球		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	74	102	176
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1

表Ⅱ-2-3　評価した測定方法･測定機採用施設件数（単球～好塩基球）

調査項目	測定法ｺｰﾄﾞ	測定方法名	自施設	外部施設	合計
単球		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	74	102	176
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
好酸球		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	74	102	176
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1
好塩基球		JAB512	14	91	105
		JAB514	9	0	9
		JAB516	1	0	1
		JAB517	74	102	176
		JAB519	5	1	6
		JAB521	18	11	29
		JAJ012	3	0	3
		JAJ803	1	0	1
		JAR408	0	2	2
		JAS304	1	0	1
		JAZ999	0	1	1

表Ⅱ-3-1　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [11] ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	1.08	0.91	1.15	1.25	1.43	1.17	1.45	1.44
	平均値	148.88	160.57	172.50	183.91	195.83	207.13	218.87	230.62
中性脂肪 [11・21] 酵素UV法・比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.80	0.81	0.77	0.91	0.98	0.98	0.94	1.22
	平均値	77.82	86.81	95.77	104.76	114.07	122.97	132.06	141.08
尿酸 [31] ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06
	平均値	5.03	5.42	5.82	6.22	6.60	6.99	7.39	7.80
クレアチニン [21] 酵素法	施設数	136	129	130	102	99	134	133	127
	標準偏差	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05
	平均値	0.48	1.11	1.75	2.39	3.05	3.70	4.34	4.99
クレアチニン [82] ﾄﾞﾗｲｹﾐｽﾄﾘ法富士ﾄﾞﾗｲｹﾑ(富士ﾌｲﾙﾑ)	施設数	0	1	1	1	0	1	0	1
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均値	0.00	1.12	1.75	2.40	0.00	3.69	0.00	4.97
AST [11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.51	0.54	0.65	0.81	1.19	1.23	1.49	1.78
	平均値	19.01	37.02	55.17	73.19	91.37	109.43	127.62	145.77
ALT [11] 標準化対応法JSCC標準化対応法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.62	0.60	0.77	0.87	1.02	1.39	1.29	1.58
	平均値	18.29	34.04	49.52	65.24	80.98	96.52	112.29	128.13
γ-GT [11] JSCC標準化対応法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.67	0.72	1.06	1.00	1.35	1.32	1.73	2.02
	平均値	29.97	48.13	66.11	84.44	102.49	120.65	138.65	156.90
血糖 [12・21・31] ﾌﾞﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法/ﾌﾞﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	施設数	136	130	131	103	99	135	133	128
	標準偏差	0.58	0.89	0.89	0.96	1.24	1.18	1.32	1.68
	平均値	71.90	90.86	109.78	129.01	148.18	167.29	186.05	205.25
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-0403] 沈殿操作を行わない方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄHDL-C)	施設数	71	70	73	59	53			
	標準偏差	0.64	0.61	0.58	0.90	0.67			
	平均値	33.81	46.30	48.71	76.45	55.07			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1201] 沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	施設数	65	55	57	51	39			
	標準偏差	0.47	0.54	0.63	1.06	0.55			
	平均値	37.37	53.17	56.06	80.01	56.51			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2304] 沈殿操作を行わない方法 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰHDL-CM3)	施設数	2	2	4	0	4			
	標準偏差	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00			
	平均値	33.00	47.00	50.50	0.00	51.00			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-0403] ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄLDL-C)	施設数	72	70	74	59	54			
	標準偏差	1.01	1.21	1.23	0.71	2.11			
	平均値	70.92	100.29	132.58	87.55	170.09			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-1201] 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	施設数	64	53	54	49	38			
	標準偏差	0.88	1.15	1.79	1.06	2.08			
	平均値	76.65	109.31	141.47	91.38	177.32			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ [01-2302] 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(LﾀｲﾌﾟﾜｺｰLDL-C M)	施設数	2	4	6	2	4			
	標準偏差	0.00	0.50	1.12	1.00	1.09			
	平均値	87.00	123.50	156.50	95.00	186.25			
HbA1c [01-2701] HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	施設数	17	18	19	23	23			
	標準偏差	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05			
	平均値	5.48	6.36	7.29	6.54	5.25			
HbA1c [01-2901] HPLC法 東ｿｰ	施設数	34	32	33	49	49			
	標準偏差	0.06	0.06	0.10	0.07	0.06			
	平均値	5.60	6.48	7.46	6.46	5.09			
HbA1c [02-0403] 免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(汎用自動分析装置)液状品	施設数	11	15	12	16	16			
	標準偏差	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
	平均値	5.74	6.76	7.76	6.44	5.13			

表Ⅱ-3-2　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
HbA1c ［02-0404］ 免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ (DM-JACKｼﾘｰｽﾞ)液状品	施設数	9	4	7	9	9			
	標準偏差	0.00	0.04	0.06	0.07	0.04			
	平均値	5.70	6.68	7.71	6.47	5.13			
HbA1c ［02-2401］ 免疫学的方法 富士ﾚﾋﾞｵ	施設数	1	2	3	3	3			
	標準偏差	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00			
	平均値	5.60	6.65	7.53	6.50	5.20			
HbA1c ［03-0401］ 酵素法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ	施設数	53	51	40	65	65			
	標準偏差	0.06	0.05	0.08	0.11	0.10			
	平均値	5.58	6.41	7.40	6.31	5.15			
HbA1c ［03-1201］ 酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾉﾙﾃﾞｨｱ N HbA1c HbA1cｵｰﾄ「TBA」)	施設数	4	6	4	7	7			
	標準偏差	0.04	0.15	0.16	0.08	0.05			
	平均値	5.62	6.38	7.28	6.51	5.25			
HbA1c ［03-1202］ 酵素法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(Lﾀｲﾌﾟ ﾉﾙ ﾃﾞｨｱ N HbA1c)	施設数	2	1	1	2	2			
	標準偏差	0.05	0.00	0.00	0.00	0.10			
	平均値	5.65	6.50	7.60	6.40	5.10			
HbA1c ［03-2701］ 酵素法 ｱｰｸﾚｲ	施設数	1	2	2	2	2			
	標準偏差	0.00	0.00	0.08	0.05	0.08			
	平均値	5.50	6.40	7.38	6.45	5.18			
HbA1c ［03-3501］ 酵素法 日本電子	施設数	4	3	5	5	5			
	標準偏差	0.11	0.05	0.10	0.12	0.08			
	平均値	5.57	6.33	7.36	6.38	5.16			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	24	14	15	187	187			
	標準偏差	2.33	1.97	1.73	4.61	2.96			
	平均値	536.59	450.93	251.68	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	9	4	5	187	187			
	標準偏差	4.27	3.63	2.80	4.61	2.96			
	平均値	528.67	441.25	245.60	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB516	施設数	1	0	1	187	187			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	534.00	0.00	243.00	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB517	施設数	115	60	66	187	187			
	標準偏差	3.95	3.16	1.94	4.61	2.96			
	平均値	531.50	444.15	241.78	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	6	4	2	187	187			
	標準偏差	2.64	33.78	0.50	4.61	2.96			
	平均値	536.80	464.50	241.50	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB521	施設数	25	13	12	187	187			
	標準偏差	2.85	2.47	2.69	4.61	2.96			
	平均値	538.17	446.81	244.67	371.67	362.67			
赤血球数 ﾍﾞｯｸﾏﾝ･ｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	3	1	2	187	187			
	標準偏差	2.05	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	519.67	433.00	238.00	371.67	362.67			
赤血球数 ｼｰﾒﾝｽHCDJAJ803	施設数	1	1	0	187	187			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	516.00	429.00	0.00	371.67	362.67			
赤血球数 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	1	1	1	187	187			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	519.50	438.00	243.00	371.67	362.67			
赤血球数 日本光電工業JAS304	施設数	1	1	0	187	187			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	517.00	446.00	0.00	371.67	362.67			
赤血球数 その他の血球計数装置JAZ999	施設数	1	0	1	187	187			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	4.61	2.96			
	平均値	533.00	0.00	240.00	371.67	362.67			

表Ⅱ-3-3　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
ヘモグロビン [1・2・9] シアンメトヘモグロビン法・非シアン界面活性剤法・その他(SLS-ヘモグロビン法/オキシヘモグロビン変法)	施設数	187	99	105	187	187			
	標準偏差	0.15	0.10	0.07	0.08	0.08			
	平均値	16.79	12.44	5.95	10.18	12.05			
ヘマトクリット シスメックスJAB512	施設数	24	14	15	24	24			
	標準偏差	0.46	0.37	0.25	0.41	0.37			
	平均値	48.40	36.71	17.97	32.57	35.69			
ヘマトクリット シスメックスJAB514	施設数	9	4	5	9	9			
	標準偏差	0.51	0.57	0.32	0.40	0.48			
	平均値	46.70	35.28	17.54	32.01	35.14			
ヘマトクリット シスメックスJAB516	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	47.70	0.00	17.40	32.20	35.40			
ヘマトクリット シスメックスJAB517	施設数	115	60	66	115	115			
	標準偏差	0.63	0.55	0.30	0.39	0.44			
	平均値	47.59	35.67	17.07	32.49	35.45			
ヘマトクリット シスメックスJAB519	施設数	6	4	2	6	6			
	標準偏差	0.34	4.77	0.10	0.16	0.37			
	平均値	47.44	37.95	17.00	32.36	35.10			
ヘマトクリット シスメックスJAB521	施設数	25	13	12	25	25			
	標準偏差	0.50	0.40	0.34	0.36	0.30			
	平均値	48.35	36.14	17.32	32.56	35.43			
ヘマトクリット ベックマン・コールターJAJ012	施設数	3	1	2	3	3			
	標準偏差	0.12	0.00	0.00	0.33	0.25			
	平均値	49.13	36.60	17.90	32.00	35.73			
ヘマトクリット シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	45.20	33.10	0.00	34.60	36.70			
ヘマトクリット アボットジャパンJAR408	施設数	1	1	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	44.95	33.70	16.50	30.75	34.95			
ヘマトクリット 日本光電工業JAS304	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	49.20	37.90	0.00	31.70	35.50			
ヘマトクリット その他の血球計数装置JAZ999	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	47.00	0.00	16.60	32.20	35.10			
白血球数 シスメックスJAB512	施設数	24	14	15	24	24			
	標準偏差	0.29	0.83	0.82	1.68	0.68			
	平均値	31.14	73.11	80.01	89.07	37.27			
白血球数 シスメックスJAB514	施設数	9	4	5	9	9			
	標準偏差	1.05	1.58	1.50	2.11	0.50			
	平均値	33.00	72.00	79.40	88.44	37.00			
白血球数 シスメックスJAB516	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	32.00	0.00	77.00	87.00	38.00			
白血球数 シスメックスJAB517	施設数	115	60	66	115	115			
	標準偏差	0.59	1.65	1.13	1.87	0.83			
	平均値	31.47	68.42	77.85	88.09	36.88			
白血球数 シスメックスJAB519	施設数	6	4	2	6	6			
	標準偏差	0.80	17.20	1.00	1.50	1.02			
	平均値	32.60	61.75	78.00	87.60	36.60			
白血球数 シスメックスJAB521	施設数	25	13	12	25	25			
	標準偏差	0.47	1.19	1.09	1.30	0.44			
	平均値	31.35	67.51	77.75	87.52	36.71			

表Ⅱ-3-4　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
白血球数 ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	3	1	2	3	3			
	標準偏差	0.47	0.00	0.50	2.87	1.41			
	平均値	32.33	73.00	79.50	82.33	35.00			
白血球数 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	33.00	67.00	0.00	82.00	35.00			
白血球数 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	1	1	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	32.50	70.00	77.00	80.50	34.00			
白血球数 日本光電工業JAS304	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	32.00	71.00	0.00	87.00	36.00			
白血球数 その他の血球計数装置JAZ999	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	32.00	0.00	77.00	88.00	37.00			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	24	14	15	24	24			
	標準偏差	0.16	0.23	0.53	0.56	0.32			
	平均値	13.17	23.03	36.23	37.18	19.24			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	9	4	5	9	9			
	標準偏差	0.24	0.49	6.67	1.14	0.54			
	平均値	13.26	22.78	31.06	36.41	18.53			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB516	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	12.90	0.00	33.60	36.30	18.10			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB517	施設数	115	60	66	115	115			
	標準偏差	0.40	0.58	1.13	0.67	0.39			
	平均値	13.44	22.81	32.54	35.03	18.13			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB519	施設数	6	4	2	6	6			
	標準偏差	0.44	4.52	1.45	0.88	0.42			
	平均値	13.78	21.50	31.85	35.56	18.40			
血小板数 ｼｽﾒｯｸｽJAB521	施設数	25	13	12	25	25			
	標準偏差	0.24	0.64	1.62	0.55	0.28			
	平均値	13.44	23.07	33.31	34.82	18.19			
血小板数 ﾍﾞｯｸﾏﾝ・ｺｰﾙﾀｰJAJ012	施設数	3	1	2	3	3			
	標準偏差	0.08	0.00	0.35	0.54	0.28			
	平均値	12.50	21.80	32.05	33.23	17.60			
血小板数 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	11.30	19.40	0.00	36.30	18.20			
血小板数 ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝJAR408	施設数	1	1	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	11.55	21.40	34.10	32.55	17.00			
血小板数 日本光電工業JAS304	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	15.50	25.50	0.00	36.30	18.80			
血小板数 その他の血球計数装置JAZ999	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	13.40	0.00	31.90	34.80	18.30			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	施設数	24	14	15	24	24			
	標準偏差	0.94	0.62	0.85	1.42	0.96			
	平均値	90.52	81.53	71.29	86.94	97.49			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	施設数	9	4	5	9	9			
	標準偏差	0.99	0.74	0.96	1.03	0.95			
	平均値	88.64	79.92	71.38	85.97	97.17			

表Ⅱ-3-5　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
平均赤血球容積 シスメックスJAB516	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	89.30	0.00	71.60	85.90	96.70			
平均赤血球容積 シスメックスJAB517	施設数	115	60	66	115	115			
	標準偏差	0.98	0.98	1.05	1.16	1.10			
	平均値	89.42	80.25	70.64	87.74	97.76			
平均赤血球容積 シスメックスJAB519	施設数	6	4	2	6	6			
	標準偏差	0.73	4.02	0.60	0.56	0.83			
	平均値	88.36	81.40	70.40	86.80	97.50			
平均赤血球容積 シスメックスJAB521	施設数	25	13	12	25	25			
	標準偏差	0.88	0.63	0.89	1.11	0.92			
	平均値	89.97	80.84	70.81	87.62	97.65			
平均赤血球容積 ベックマン・コールターJAJ012	施設数	3	1	2	3	3			
	標準偏差	0.52	0.00	0.05	0.78	0.56			
	平均値	94.63	84.40	75.15	85.53	99.53			
平均赤血球容積 シーメンスHCDJAJ803	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	87.60	77.20	0.00	92.40	102.70			
平均赤血球容積 アボットジャパンJAR408	施設数	1	1	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	86.50	76.90	67.90	87.10	99.70			
平均赤血球容積 日本光電工業JAS304	施設数	1	1	0	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	95.20	84.90	0.00	83.40	97.50			
平均赤血球容積 その他の血球計数装置JAZ999	施設数	1	0	1	1	1			
	標準偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	平均値	88.20	0.00	69.20	87.00	97.80			
好中球 シスメックスJAB512	施設数				24	24			
	標準偏差				0.95	1.41			
	平均値				53.52	58.35			
好中球 シスメックスJAB514	施設数				9	9			
	標準偏差				0.56	1.11			
	平均値				54.74	59.86			
好中球 シスメックスJAB516	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				55.20	60.00			
好中球 シスメックスJAB517	施設数				114	114			
	標準偏差				0.93	1.89			
	平均値				54.22	59.18			
好中球 シスメックスJAB519	施設数				6	6			
	標準偏差				0.29	1.05			
	平均値				54.26	59.04			
好中球 シスメックスJAB521	施設数				25	25			
	標準偏差				0.69	0.85			
	平均値				53.31	58.31			
好中球 ベックマン・コールターJAJ012	施設数				3	3			
	標準偏差				2.78	4.81			
	平均値				54.30	55.30			
好中球 シーメンスHCDJAJ803	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				55.10	58.80			
好中球 アボットジャパンJAR408	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				54.95	60.40			

表Ⅱ-3-6　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
好中球 日本光電工業JAS304	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				69.80	72.10			
好中球 その他の血球計数装置JAZ999	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				54.00	58.40			
リンパ球 シスメックスJAB512	施設数				24	24			
	標準偏差				0.95	1.57			
	平均値				39.09	32.86			
リンパ球 シスメックスJAB514	施設数				9	9			
	標準偏差				0.48	1.22			
	平均値				37.34	30.12			
リンパ球 シスメックスJAB516	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				37.30	30.70			
リンパ球 シスメックスJAB517	施設数				114	114			
	標準偏差				0.61	1.06			
	平均値				37.83	30.79			
リンパ球 シスメックスJAB519	施設数				6	6			
	標準偏差				0.38	0.66			
	平均値				38.08	30.98			
リンパ球 シスメックスJAB521	施設数				25	25			
	標準偏差				0.72	0.80			
	平均値				37.80	30.51			
リンパ球 ベックマン・コールターJAJ012	施設数				3	3			
	標準偏差				2.18	2.45			
	平均値				35.23	28.53			
リンパ球 シーメンスHCDJAJ803	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				33.40	28.70			
リンパ球 アボットジャパンJAR408	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				36.30	26.25			
リンパ球 日本光電工業JAS304	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				19.30	15.40			
リンパ球 その他の血球計数装置JAZ999	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				37.10	30.60			
単球 シスメックスJAB512	施設数				24	24			
	標準偏差				0.27	0.60			
	平均値				4.39	6.71			
単球 シスメックスJAB514	施設数				9	9			
	標準偏差				0.41	0.45			
	平均値				4.83	7.52			
単球 シスメックスJAB516	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				4.40	7.20			
単球 シスメックスJAB517	施設数				114	114			
	標準偏差				0.27	0.63			
	平均値				4.55	7.31			
単球 シスメックスJAB519	施設数				6	6			
	標準偏差				0.18	0.40			
	平均値				4.52	7.05			

表Ⅱ-3-7　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
単球 シスメックスJAB521	施設数				25	25			
	標準偏差				0.30	0.45			
	平均値				5.72	9.02			
単球 ベックマン・コールターJAJ012	施設数				3	3			
	標準偏差				0.51	2.15			
	平均値				6.80	11.83			
単球 シーメンスHCDJAJ803	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				3.90	6.50			
単球 アボットジャパンJAR408	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				5.65	11.55			
単球 日本光電工業JAS304	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				6.50	9.50			
単球 その他の血球計数装置JAZ999	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				5.80	8.90			
好酸球 シスメックスJAB512	施設数				24	24			
	標準偏差				0.17	0.15			
	平均値				2.72	1.34			
好酸球 シスメックスJAB514	施設数				9	9			
	標準偏差				0.12	0.16			
	平均値				2.79	1.64			
好酸球 シスメックスJAB516	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				2.50	1.30			
好酸球 シスメックスJAB517	施設数				114	114			
	標準偏差				0.16	0.23			
	平均値				2.72	1.44			
好酸球 シスメックスJAB519	施設数				6	6			
	標準偏差				0.13	0.17			
	平均値				2.68	1.40			
好酸球 シスメックスJAB521	施設数				25	25			
	標準偏差				0.14	0.12			
	平均値				2.76	1.31			
好酸球 ベックマン・コールターJAJ012	施設数				3	3			
	標準偏差				0.22	2.01			
	平均値				3.20	3.17			
好酸球 シーメンスHCDJAJ803	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				3.90	1.90			
好酸球 アボットジャパンJAR408	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				2.85	1.75			
好酸球 日本光電工業JAS304	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				3.20	1.60			
好酸球 その他の血球計数装置JAZ999	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				2.80	1.40			
好塩基球 シスメックスJAB512	施設数				24	24			
	標準偏差				0.10	0.19			
	平均値				0.34	0.94			

表Ⅱ-3-8　調査項目の測定方法、測定機別参加施設数・標準偏差・平均値一覧

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
好塩基球 シスメックスJAB514	施設数				9	9			
	標準偏差				0.07	0.25			
	平均値				0.30	0.86			
好塩基球 シスメックスJAB516	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				0.60	0.80			
好塩基球 シスメックスJAB517	施設数				114	114			
	標準偏差				0.14	0.22			
	平均値				0.50	1.03			
好塩基球 シスメックスJAB519	施設数				6	6			
	標準偏差				0.16	0.43			
	平均値				0.62	1.45			
好塩基球 シスメックスJAB521	施設数				25	25			
	標準偏差				0.17	0.14			
	平均値				0.54	0.97			
好塩基球 ベックマン・コールターJAJ012	施設数				3	3			
	標準偏差				0.08	0.31			
	平均値				0.50	1.17			
好塩基球 シーメンスHCDJAJ803	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				0.30	0.60			
好塩基球 アボットジャパンJAR408	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				0.25	0.05			
好塩基球 日本光電工業JAS304	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				1.10	1.40			
好塩基球 その他の血球計数装置JAZ999	施設数				1	1			
	標準偏差				0.00	0.00			
	平均値				0.30	0.70			

(2)尿検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖 [1・2] 試験紙法 目視判定・機器測定	施設数	300	142	158	149	165	300	153	156
	標準偏差	−	−	−	−	−	−	−	−
	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
尿蛋白 [1・2] 試験紙法 目視判定・機器測定	施設数	300	142	158	149	165	300	153	156
	標準偏差	−	−	−	−	−	−	−	−
	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
尿潜血 [1・2] 試験紙法 目視判定・機器測定	施設数	300	142	158	149	165	300	153	156
	標準偏差	−	−	−	−	−	−	−	−
	平均値	1	1	4	3	1	3	3	3

表Ⅱ-4-1　調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ［11］ ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ酸化酵素法	平均値	148.88	160.57	172.50	183.91	195.83	207.13	218.87	230.62
	平均値 評価規準	5.96	6.42	6.90	7.36	7.83	8.29	8.75	9.22
中性脂肪 ［11・21］ 酵素UV法・比色法ｸﾞﾘｾﾛｰﾙを消去する方法	平均値	77.82	86.81	95.77	104.76	114.07	122.97	132.06	141.08
	平均値 評価規準	4.12	4.60	5.08	5.55	6.05	6.52	7.00	7.48
尿酸 ［31］ ｳﾘｶｰｾﾞ・ﾍﾟﾙｵｷｼﾀﾞｰｾﾞ法	平均値	5.03	5.42	5.82	6.22	6.60	6.99	7.39	7.80
	平均値 評価規準	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19
クレアチニン ［21］ 酵素法	平均値	0.48	1.11	1.75	2.39	3.05	3.70	4.34	4.99
	平均値 評価規準	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	0.13	0.15	0.17
AST ［11］ 標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	19.01	37.02	55.17	73.19	91.37	109.43	127.62	145.77
	平均値 評価規準	1.03	2.00	2.98	3.95	4.93	5.91	6.89	7.87
ALT ［11］ 標準化対応法JSCC標準化対応法	平均値	18.29	34.04	49.52	65.24	80.98	96.52	112.29	128.13
	平均値 評価規準	1.10	2.04	2.97	3.91	4.86	5.79	6.74	7.69
γ-GT ［11］ JSCC標準化対応法	平均値	29.97	48.13	66.11	84.44	102.49	120.65	138.65	156.90
	平均値 評価規準	1.62	2.60	3.57	4.56	5.53	6.51	7.49	8.47
血糖 ［12・21・31］ ﾌﾟﾄﾞｳ糖酸化酵素電極法/ﾍｷｿｷﾅｰｾﾞ・UV法/ﾌﾟﾄﾞｳ糖脱水素酵素法	平均値	71.90	90.86	109.78	129.01	148.18	167.29	186.05	205.25
	平均値 評価規準	1.58	2.00	2.42	2.84	3.26	3.68	4.09	4.52
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ［01-0403］ 沈殿操作を行わない方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞHDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄHDL-C)	平均値	33.81	46.30	48.71	76.45	55.07			
	平均値 評価規準	0.88	1.20	1.27	1.99	1.43			
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ［01-1201］ 沈殿操作を行わない方法 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄN-HDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄHDL)	平均値	37.37	53.17	56.06	80.01	56.51			
	平均値 評価規準	0.97	1.38	1.46	2.08	1.47			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ［01-0403］ ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(ﾒﾀﾎﾞﾘｰﾄﾞ LDL-C AUﾘｴｰｼﾞｪﾝﾄLDL-C)	平均値	70.92	100.29	132.58	87.55	170.09			
	平均値 評価規準	2.41	3.41	4.51	2.98	5.78			
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ ［01-1201］ 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(ｺﾚｽﾃｽﾄLDL ｸｵﾘｼﾞｪﾝﾄLDL)	平均値	76.65	109.31	141.47	91.38	177.32			
	平均値 評価規準	2.61	3.72	4.81	3.11	6.03			
HbA1c ［01-2701］ HPLC法 ｱｰｸﾚｲ	平均値	5.48	6.36	7.29	6.54	5.25			
	平均値 評価規準	0.15	0.17	0.20	0.18	0.14			
HbA1c ［01-2901］ HPLC法 東ソー	平均値	5.60	6.48	7.46	6.46	5.09			
	平均値 評価規準	0.15	0.18	0.20	0.17	0.14			
HbA1c ［02-0403］ 免疫学的方法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(汎用自動分析装置)液状品	平均値	5.74	6.76	7.76	6.44	5.13			
	平均値 評価規準	0.16	0.18	0.21	0.17	0.14			
HbA1c ［03-0401］ 酵素法 ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ	平均値	5.58	6.41	7.40	6.31	5.15			
	平均値 評価規準	0.15	0.17	0.20	0.17	0.14			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB512	平均値	536.59	450.93	251.68	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.80	9.92	5.54	8.18	7.98			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB514	平均値	528.67	441.25	245.60	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.63	9.71	5.40	8.18	7.98			
赤血球数 ｼｽﾒｯｸｽJAB516	平均値	534.00	0.00	243.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.75	0.00	5.35	8.18	7.98			

表Ⅱ-4-2　調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
赤血球数 シスメックスJAB517	平均値	531.50	444.15	241.78	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.69	9.77	5.32	8.18	7.98			
赤血球数 シスメックスJAB519	平均値	536.80	464.50	241.50	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.81	10.22	5.31	8.18	7.98			
赤血球数 シスメックスJAB521	平均値	538.17	446.81	244.67	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.84	9.83	5.38	8.18	7.98			
赤血球数 ベックマン・コールターJAJ012	平均値	519.67	433.00	238.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.43	9.53	5.24	8.18	7.98			
赤血球数 シーメンスHCDJAJ803	平均値	516.00	429.00	0.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.35	9.44	0.00	8.18	7.98			
赤血球数 アボットジャパンJAR408	平均値	519.50	438.00	243.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.43	9.64	5.35	8.18	7.98			
赤血球数 日本光電工業JAS304	平均値	517.00	446.00	0.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.37	9.81	0.00	8.18	7.98			
赤血球数 その他の血球計数装置JAZ999	平均値	533.00	0.00	240.00	371.67	362.67			
	平均値 評価規準	11.73	0.00	5.28	8.18	7.98			
ヘモグロビン　[1・2・9] シアンメトヘモグロビン法・非シアン界面活性剤法・その他(SLS-ヘモグロビン法/オキシヘモグロビン変法)	平均値	16.79	12.44	5.95	10.18	12.05			
	平均値 評価規準	0.35	0.26	0.12	0.21	0.25			
ヘマトクリット シスメックスJAB512	平均値	48.40	36.71	17.97	32.57	35.69			
	平均値 評価規準	1.98	1.50	0.74	1.34	1.46			
ヘマトクリット シスメックスJAB517	平均値	47.59	35.67	17.07	32.49	35.45			
	平均値 評価規準	1.95	1.46	0.70	1.33	1.45			
ヘマトクリット シスメックスJAB521	平均値	48.35	36.14	17.33	32.56	35.43			
	平均値 評価規準	1.98	1.48	0.71	1.33	1.45			
白血球数 シスメックスJAB512	平均値	31.14	73.11	80.01	89.07	37.27			
	平均値 評価規準	2.27	5.34	5.84	6.50	2.72			
白血球数 シスメックスJAB517	平均値	31.47	68.42	77.85	88.09	36.88			
	平均値 評価規準	2.30	4.99	5.68	6.43	2.69			
白血球数 シスメックスJAB521	平均値	31.35	67.51	77.75	87.52	36.71			
	平均値 評価規準	2.29	4.93	5.68	6.39	2.68			
血小板数 シスメックスJAB512	平均値	13.17	23.03	36.23	37.18	19.24			
	平均値 評価規準	0.88	1.54	2.43	2.49	1.29			
血小板数 シスメックスJAB517	平均値	13.44	22.81	32.54	35.03	18.13			
	平均値 評価規準	0.90	1.53	2.18	2.35	1.21			
血小板数 シスメックスJAB521	平均値	13.44	23.07	33.31	34.82	18.19			
	平均値 評価規準	0.90	1.55	2.23	2.33	1.22			
平均赤血球容積 シスメックスJAB512	平均値	90.52	81.53	71.29	86.94	97.49			
	平均値 評価規準	2.08	1.88	1.64	2.00	2.24			

表Ⅱ-4-3　調査項目別・測定方法別・平均値および平均値評価規準

(1)臨床化学・血液学検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB517	平均値	89.42	80.25	70.64	87.74	97.76			
	平均値 評価規準	2.06	1.85	1.62	2.02	2.25			
平均赤血球容積 ｼｽﾒｯｸｽJAB521	平均値	89.97	80.84	70.81	87.62	97.65			
	平均値 評価規準	2.07	1.86	1.63	2.02	2.25			

(2)尿検査

調査項目	区分	試料1	試料2	試料3	試料4	試料5	試料6	試料7	試料8
尿糖 [1･2] 試験紙法 目視判定･機器測定	平均値	1	3	3	3	4	4	1	4
	平均値 評価規準	－	－	－	－	－	－	－	－
尿蛋白 [1･2] 試験紙法 目視判定･機器測定	平均値	3	1	3	4	3	4	4	1
	平均値 評価規準	－	－	－	－	－	－	－	－
尿潜血 [1･2] 試験紙法 目視判定･機器測定	平均値	1	1	4	3	1	3	3	3
	平均値 評価規準	－	－	－	－	－	－	－	－

Ⅱ．調査試料測定結果（2）

調査項目別の評価点ランク別施設数・構成比

参加施設の各調査項目についての評価点を5ランク、評価点90点以上・80点以上90点未満・70点以上80点未満・60点以上70点未満・60点未満に分けて、全参加施設（全施設）についての構成比を表Ⅱ-5に、自施設で検査を行った施設（自施設）についての構成比を表Ⅱ-6に、直近３年間について示す。

測定法別の評価点ランク別施設数・構成比

測定方法別に、参加施設の各調査項目についての評価点を4ランク、85点以上・70点以上85点未満・60点以上70点未満・60点未満に分けて、直近３年間の施設数と構成比を表Ⅱ-7（全施設）と表Ⅱ-8（自施設）に示す。

生血清、新鮮血液 測定法別の評価点ランク別施設数・構成比

生血清・新鮮血液（生血）について、測定方法別に参加施設の各調査項目の評価点を4ランク、85点以上・70点以上85点未満・60点以上70点未満・60点未満に分けて、直近３年間の施設数と構成比を表Ⅱ-9（全施設）と表Ⅱ-10（自施設）に示す。

尿検査の測定法別の評価点ランク別施設数・構成比

参加施設の尿検査の評価点を４ランク、85点以上・70点以上85点未満・60点以上70点未満・60点未満に分けて、尿糖・尿蛋白・尿潜血について表Ⅱ-11（全施設）と表Ⅱ-12（全施設）および表Ⅱ-13（全施設）に目視と機器の測定方法別に示す。

表Ⅱ-5　調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設分）

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	32回	306	90.8%	25	7.4%	2	0.6%	2	0.6%	2	0.6%	337	100.0%
	31回	316	94.3%	8	2.4%	7	2.1%	1	0.3%	3	0.9%	335	100.0%
	30回	303	90.2%	26	7.7%	6	1.8%	0	0.0%	1	0.3%	336	100.0%
中性脂肪	32回	317	94.1%	15	4.5%	2	0.6%	2	0.6%	1	0.3%	337	100.0%
	31回	325	97.0%	8	2.4%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.3%	335	100.0%
	30回	326	97.0%	8	2.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.3%	336	100.0%
尿酸	32回	314	93.2%	19	5.6%	0	0.0%	4	1.2%	0	0.0%	337	100.0%
	31回	307	91.6%	15	4.5%	9	2.7%	2	0.6%	2	0.6%	335	100.0%
	30回	305	90.8%	26	7.7%	3	0.9%	1	0.3%	1	0.3%	336	100.0%
クレアチニン	32回	322	95.5%	4	1.2%	1	0.3%	0	0.0%	10	3.0%	337	100.0%
	31回	305	91.0%	14	4.2%	3	0.9%	3	0.9%	10	3.0%	335	100.0%
	30回	313	93.2%	10	3.0%	4	1.2%	4	1.2%	5	1.5%	336	100.0%
AST	32回	311	92.3%	11	3.3%	5	1.5%	6	1.8%	4	1.2%	337	100.0%
	31回	311	92.8%	9	2.7%	7	2.1%	4	1.2%	4	1.2%	335	100.0%
	30回	312	92.9%	13	3.9%	4	1.2%	2	0.6%	5	1.5%	336	100.0%
ALT	32回	319	94.7%	5	1.5%	4	1.2%	6	1.8%	3	0.9%	337	100.0%
	31回	313	93.4%	10	3.0%	6	1.8%	4	1.2%	2	0.6%	335	100.0%
	30回	310	92.3%	11	3.3%	7	2.1%	5	1.5%	3	0.9%	336	100.0%
γ-GT	32回	324	96.1%	10	3.0%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	337	100.0%
	31回	309	92.2%	20	6.0%	2	0.6%	3	0.9%	1	0.3%	335	100.0%
	30回	315	93.8%	12	3.6%	7	2.1%	2	0.6%	0	0.0%	336	100.0%
血糖	32回	310	92.0%	16	4.7%	3	0.9%	5	1.5%	3	0.9%	337	100.0%
	31回	303	90.4%	15	4.5%	7	2.1%	2	0.6%	8	2.4%	335	100.0%
	30回	313	93.2%	14	4.2%	4	1.2%	2	0.6%	3	0.9%	336	100.0%
HDLコレステロール	32回	307	91.1%	22	6.5%	4	1.2%	2	0.6%	2	0.6%	337	100.0%
	31回	314	93.7%	16	4.8%	4	1.2%	1	0.3%	0	0.0%	335	100.0%
	30回	301	89.6%	12	3.6%	19	5.7%	2	0.6%	2	0.6%	336	100.0%
LDLコレステロール	32回	331	98.2%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	3	0.9%	337	100.0%
	31回	332	99.1%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	335	100.0%
	30回	330	98.2%	5	1.5%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
HbA1c	32回	329	97.9%	2	0.6%	3	0.9%	1	0.3%	1	0.3%	336	100.0%
	31回	325	97.3%	3	0.9%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.9%	334	100.0%
	30回	329	98.2%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	335	100.0%
尿糖	32回	270	79.9%	61	18.0%	6	1.8%	0	0.0%	1	0.3%	338	100.0%
	31回	268	79.8%	61	18.2%	4	1.2%	1	0.3%	2	0.6%	336	100.0%
	30回	280	83.1%	52	15.4%	2	0.6%	1	0.3%	2	0.6%	337	100.0%
尿蛋白	32回	325	96.2%	10	3.0%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	338	100.0%
	31回	327	97.3%	7	2.1%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
	30回	330	97.9%	6	1.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	337	100.0%
尿潜血	32回	318	94.1%	11	3.3%	3	0.9%	4	1.2%	2	0.6%	338	100.0%
	31回	313	93.2%	20	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	336	100.0%
	30回	323	95.8%	10	3.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	337	100.0%
赤血球	32回	283	84.2%	20	6.0%	16	4.8%	5	1.5%	12	3.6%	336	100.0%
	31回	333	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	334	100.0%
	30回	330	98.5%	2	0.6%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	335	100.0%
ヘモグロビン	32回	332	98.8%	3	0.9%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	336	100.0%
	31回	330	98.8%	1	0.3%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	334	100.0%
	30回	328	97.9%	4	1.2%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	335	100.0%
ヘマトクリット	32回	331	98.5%	1	0.3%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	336	100.0%
	31回	331	99.1%	2	0.6%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	334	100.0%
	30回	330	98.5%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	335	100.0%
白血球	32回	331	98.5%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	336	100.0%
	31回	332	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	334	100.0%
	30回	334	99.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	335	100.0%
血小板	32回	318	94.6%	9	2.7%	5	1.5%	0	0.0%	4	1.2%	336	100.0%
	31回	333	99.7%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	334	100.0%
	30回	328	97.9%	0	0.0%	7	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	335	100.0%
平均赤血球容積	32回	317	94.6%	10	3.0%	4	1.2%	0	0.0%	4	1.2%	335	100.0%
	31回	324	97.0%	7	2.1%	2	0.6%	0	0.0%	1	0.3%	334	100.0%
	30回	327	97.6%	3	0.9%	4	1.2%	0	0.0%	1	0.3%	335	100.0%

表Ⅱ-6　調査項目別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設分）

調査項目	得点	90以上		80以上90未満		70以上80未満		60以上70未満		60未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	32回	193	92.8%	13	6.3%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	208	100.0%
	31回	198	95.7%	5	2.4%	3	1.4%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	30回	187	90.3%	15	7.2%	4	1.9%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
中性脂肪	32回	204	98.1%	4	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100.0%
	31回	204	98.6%	2	1.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	205	99.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
尿酸	32回	196	94.2%	11	5.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	208	100.0%
	31回	189	91.3%	12	5.8%	5	2.4%	1	0.5%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	189	91.3%	17	8.2%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
クレアチニン	32回	200	96.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	3.8%	208	100.0%
	31回	188	90.8%	9	4.3%	1	0.5%	2	1.0%	7	3.4%	207	100.0%
	30回	199	96.1%	4	1.9%	0	0.0%	1	0.5%	3	1.4%	207	100.0%
AST	32回	195	93.8%	9	4.3%	3	1.4%	1	0.5%	0	0.0%	208	100.0%
	31回	198	95.7%	4	1.9%	3	1.4%	1	0.5%	1	0.5%	207	100.0%
	30回	199	96.1%	5	2.4%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
ALT	32回	203	97.6%	2	1.0%	1	0.5%	1	0.5%	1	0.5%	208	100.0%
	31回	200	96.6%	5	2.4%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	30回	197	95.2%	4	1.9%	1	0.5%	3	1.4%	2	1.0%	207	100.0%
γ-GT	32回	203	97.6%	5	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100.0%
	31回	196	94.7%	10	4.8%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	200	96.6%	3	1.4%	4	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
血糖	32回	199	95.7%	8	3.8%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	208	100.0%
	31回	196	94.7%	5	2.4%	2	1.0%	0	0.0%	4	1.9%	207	100.0%
	30回	202	97.6%	4	1.9%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	207	100.0%
HDLコレステロール	32回	193	92.8%	10	4.8%	2	1.0%	2	1.0%	1	0.5%	208	100.0%
	31回	196	94.7%	10	4.8%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	182	87.9%	10	4.8%	14	6.8%	1	0.5%	0	0.0%	207	100.0%
LDLコレステロール	32回	205	98.6%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	208	100.0%
	31回	207	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	205	99.0%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
HbA1c	32回	207	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	209	100.0%
	31回	205	98.6%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	208	100.0%
	30回	208	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	208	100.0%
尿糖	32回	53	81.5%	12	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	100.0%
	31回	52	88.1%	7	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	100.0%
	30回	55	94.8%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	100.0%
尿蛋白	32回	64	98.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	65	100.0%
	31回	59	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	100.0%
	30回	58	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	100.0%
尿潜血	32回	64	98.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%	65	100.0%
	31回	59	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	100.0%
	30回	58	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	100.0%
赤血球	32回	167	79.9%	13	6.2%	14	6.7%	4	1.9%	11	5.3%	209	100.0%
	31回	207	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	207	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
ヘモグロビン	32回	208	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	209	100.0%
	31回	206	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	206	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
ヘマトクリット	32回	207	99.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	209	100.0%
	31回	207	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	204	98.6%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	207	100.0%
白血球	32回	207	99.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	209	100.0%
	31回	206	99.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%
	30回	207	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
血小板	32回	203	97.1%	5	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	209	100.0%
	31回	206	99.5%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	203	98.1%	0	0.0%	4	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
平均赤血球容積	32回	200	96.2%	5	2.4%	1	0.5%	0	0.0%	2	1.0%	208	100.0%
	31回	206	99.5%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	207	100.0%
	30回	204	98.6%	1	0.5%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.5%	207	100.0%

表Ⅱ-7-1　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	11	322	95.5%	11	3.3%	2	0.6%	2	0.6%	337	100.0%
	計	322	95.5%	11	3.3%	2	0.6%	2	0.6%	337	100.0%
中性脂肪	11	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	0.6%
	21	325	97.0%	8	2.4%	2	0.6%	0	0.0%	335	99.4%
	計	326	96.7%	8	2.4%	2	0.6%	1	0.3%	337	100.0%
尿酸	31	323	95.8%	10	3.0%	4	1.2%	0	0.0%	337	100.0%
	計	323	95.8%	10	3.0%	4	1.2%	0	0.0%	337	100.0%
クレアチニン	21	323	96.1%	3	0.9%	0	0.0%	10	3.0%	336	99.7%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	324	96.1%	3	0.9%	0	0.0%	10	3.0%	337	100.0%
AST	11	317	94.1%	10	3.0%	6	1.8%	4	1.2%	337	100.0%
	計	317	94.1%	10	3.0%	6	1.8%	4	1.2%	337	100.0%
ALT	11	320	95.0%	8	2.4%	6	1.8%	3	0.9%	337	100.0%
	計	320	95.0%	8	2.4%	6	1.8%	3	0.9%	337	100.0%
γ-GT	11	333	98.8%	3	0.9%	1	0.3%	0	0.0%	337	100.0%
	計	333	98.8%	3	0.9%	1	0.3%	0	0.0%	337	100.0%
血糖	12	26	86.7%	2	6.7%	2	6.7%	0	0.0%	30	8.9%
	21	287	93.8%	13	4.2%	3	1.0%	3	1.0%	306	90.8%
	31	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	314	93.2%	15	4.5%	5	1.5%	3	0.9%	337	100.0%
HDLコレステロール	01-0403	150	96.2%	4	2.6%	0	0.0%	2	1.3%	156	46.3%
	01-1201	175	98.9%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	177	52.5%
	01-2304	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	計	329	97.6%	4	1.2%	2	0.6%	2	0.6%	337	100.0%
LDLコレステロール	01-0403	156	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	157	46.6%
	01-1201	171	98.3%	1	0.6%	0	0.0%	2	1.1%	174	51.6%
	01-2302	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	計	333	98.8%	1	0.3%	0	0.0%	3	0.9%	337	100.0%
HbA1c	01-2701	27	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	8.0%
	01-2901	48	96.0%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	14.9%
	02-0403	94	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	28.0%
	02-0404	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%
	02-2401	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	03-0401	130	98.5%	0	0.0%	1	0.8%	1	0.8%	132	39.3%
	03-1201	6	85.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.1%
	03-1202	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	03-2701	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	03-3501	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	計	331	98.5%	3	0.9%	1	0.3%	1	0.3%	336	100.0%
尿糖	1	99	85.3%	16	13.8%	0	0.0%	1	0.9%	116	34.3%
	2	206	92.8%	16	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	222	65.7%
	計	305	90.2%	32	9.5%	0	0.0%	1	0.3%	338	100.0%
尿蛋白	1	112	96.6%	4	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	116	34.3%
	2	220	99.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	222	65.7%
	計	332	98.2%	4	1.2%	0	0.0%	2	0.6%	338	100.0%
尿潜血	1	110	94.8%	3	2.6%	1	0.9%	2	1.7%	116	34.3%
	2	219	98.6%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	222	65.7%
	計	329	97.3%	3	0.9%	4	1.2%	2	0.6%	338	100.0%
赤血球数	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	150	84.3%	13	7.3%	5	2.8%	10	5.6%	178	53.0%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%

表Ⅱ-7-2　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
赤血球数	JAB521	26	89.7%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	303	90.2%	16	4.8%	5	1.5%	12	3.6%	336	100.0%
ヘモグロビン	1	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%
	2	302	99.7%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	303	90.2%
	9	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.4%
	計	335	99.7%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	336	100.0%
ヘマトクリット	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	177	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	178	53.0%
	JAB519	3	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	332	98.8%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	336	100.0%
白血球数	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	177	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	178	53.0%
	JAB519	2	33.3%	3	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	331	98.5%	3	0.9%	0	0.0%	2	0.6%	336	100.0%
血小板数	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	6	66.7%	2	22.2%	0	0.0%	1	11.1%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	175	98.3%	1	0.6%	0	0.0%	2	1.1%	178	53.0%
	JAB519	3	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	1	16.7%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	327	97.3%	5	1.5%	0	0.0%	4	1.2%	336	100.0%
平均赤血球容積	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	170	96.0%	4	2.3%	0	0.0%	3	1.7%	177	52.8%
	JAB519	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.7%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	327	97.6%	4	1.2%	0	0.0%	4	1.2%	335	100.0%

表Ⅱ-8-1　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
総コレステロール	11	121	93.8%	5	3.9%	2	1.6%	1	0.8%	129	100.0%
	計	121	93.8%	5	3.9%	2	1.6%	1	0.8%	129	100.0%
中性脂肪	11	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	0.8%
	21	120	93.8%	6	4.7%	2	1.6%	0	0.0%	128	99.2%
	計	120	93.0%	6	4.7%	2	1.6%	1	0.8%	129	100.0%
尿酸	31	122	94.6%	4	3.1%	3	2.3%	0	0.0%	129	100.0%
	計	122	94.6%	4	3.1%	3	2.3%	0	0.0%	129	100.0%
クレアチニン	21	123	96.1%	3	2.3%	0	0.0%	2	1.6%	128	99.2%
	82	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	計	124	96.1%	3	2.3%	0	0.0%	2	1.6%	129	100.0%
AST	11	116	89.9%	4	3.1%	5	3.9%	4	3.1%	129	100.0%
	計	116	89.9%	4	3.1%	5	3.9%	4	3.1%	129	100.0%
ALT	11	116	89.9%	6	4.7%	5	3.9%	2	1.6%	129	100.0%
	計	116	89.9%	6	4.7%	5	3.9%	2	1.6%	129	100.0%
γ-GT	11	126	97.7%	2	1.6%	1	0.8%	0	0.0%	129	100.0%
	計	126	97.7%	2	1.6%	1	0.8%	0	0.0%	129	100.0%
血糖	12	23	85.2%	2	7.4%	2	7.4%	0	0.0%	27	20.9%
	21	89	88.1%	7	6.9%	2	2.0%	3	3.0%	101	78.3%
	31	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	計	113	87.6%	9	7.0%	4	3.1%	3	2.3%	129	100.0%
HDLコレステロール	01-0403	66	95.7%	2	2.9%	0	0.0%	1	1.4%	69	53.5%
	01-1201	57	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	57	44.2%
	01-2304	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%
	計	126	97.7%	2	1.6%	0	0.0%	1	0.8%	129	100.0%
LDLコレステロール	01-0403	70	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	70	54.3%
	01-1201	52	96.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.9%	54	41.9%
	01-2302	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	計	127	98.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.8%	129	100.0%
HbA1c	01-2701	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	19.7%
	01-2901	40	95.2%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	42	33.1%
	02-0403	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.5%
	02-0404	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.3%
	02-2401	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%
	03-0401	29	96.7%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	30	23.6%
	03-1201	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.7%
	03-1202	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%
	03-2701	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03-3501	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	計	123	96.9%	3	2.4%	1	0.8%	0	0.0%	127	100.0%
尿糖	1	98	85.2%	16	13.9%	0	0.0%	1	0.9%	115	42.1%
	2	147	93.0%	11	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	158	57.9%
	計	245	89.7%	27	9.9%	0	0.0%	1	0.4%	273	100.0%
尿蛋白	1	111	96.5%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	115	42.1%
	2	157	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	158	57.9%
	計	268	98.2%	4	1.5%	0	0.0%	1	0.4%	273	100.0%
尿潜血	1	109	94.8%	3	2.6%	1	0.9%	2	1.7%	115	42.1%
	2	156	98.7%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	158	57.9%
	計	265	97.1%	3	1.1%	3	1.1%	2	0.7%	273	100.0%
赤血球数	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	71	94.7%	2	2.7%	1	1.3%	1	1.3%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%

表Ⅱ-8-2　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
赤血球数	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	123	96.9%	2	1.6%	1	0.8%	1	0.8%	127	100.0%
ヘモグロビン	1	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.5%
	2	111	99.1%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	112	88.2%
	9	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.3%
	計	126	99.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	127	100.0%
ヘマトクリット	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	2	40.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	124	97.6%	2	1.6%	0	0.0%	1	0.8%	127	100.0%
白血球数	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	2	40.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	124	97.6%	2	1.6%	0	0.0%	1	0.8%	127	100.0%
血小板数	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	6	66.7%	2	22.2%	0	0.0%	1	11.1%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	73	97.3%	1	1.3%	0	0.0%	1	1.3%	75	59.1%
	JAB519	2	40.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	119	93.7%	5	3.9%	0	0.0%	3	2.4%	127	100.0%
平均赤血球容積	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	71	94.7%	3	4.0%	0	0.0%	1	1.3%	75	59.1%
	JAB519	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	122	96.1%	3	2.4%	0	0.0%	2	1.6%	127	100.0%

表Ⅱ-9-1　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	152	97.4%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	156	46.4%
	01-1201	174	98.9%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	176	52.4%
	01-2304	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	計	330	98.2%	6	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	156	99.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	157	46.7%
	01-1201	170	98.3%	2	1.2%	0	0.0%	1	0.6%	173	51.5%
	01-2302	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	計	332	98.8%	3	0.9%	0	0.0%	1	0.3%	336	100.0%
HbA1c	01-2701	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	7.0%
	01-2901	50	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	15.2%
	02-0403	94	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	94	28.5%
	02-0404	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	02-2401	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	03-0401	121	91.7%	6	4.5%	0	0.0%	5	3.8%	132	40.0%
	03-1201	6	85.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.1%
	03-1202	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	03-2701	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%
	03-3501	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%
	計	318	96.4%	7	2.1%	0	0.0%	5	1.5%	330	100.0%
赤血球数	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	150	84.3%	13	7.3%	5	2.8%	10	5.6%	178	53.0%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	26	89.7%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	303	90.2%	16	4.8%	5	1.5%	12	3.6%	336	100.0%
ヘモグロビン	1	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%
	2	302	99.7%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	303	90.2%
	9	25	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.4%
	計	335	99.7%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	336	100.0%
ヘマトクリット	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	178	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	178	53.0%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	336	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
白血球数	JAB512	102	97.1%	1	1.0%	2	1.9%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	172	96.6%	1	0.6%	2	1.1%	3	1.7%	178	53.0%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	327	97.3%	2	0.6%	4	1.2%	3	0.9%	336	100.0%

表Ⅱ-9-2　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
血小板数	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	178	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	178	53.0%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.6%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	336	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
平均赤血球容積	JAB512	100	95.2%	5	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.3%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	136	76.8%	23	13.0%	9	5.1%	9	5.1%	177	52.8%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	26	89.7%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.7%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	286	85.4%	31	9.3%	9	2.7%	9	2.7%	335	100.0%
好中球	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.4%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	173	98.3%	1	0.6%	0	0.0%	2	1.1%	176	52.7%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.7%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	331	99.1%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	334	100.0%
リンパ球	JAB512	105	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.4%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	168	95.5%	4	2.3%	0	0.0%	4	2.3%	176	52.7%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	29	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	8.7%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	326	97.6%	4	1.2%	0	0.0%	4	1.2%	334	100.0%

表Ⅱ-9-3　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
単球	JAB512	103	98.1%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.4%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	147	83.5%	8	4.5%	2	1.1%	19	10.8%	176	52.7%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	28	96.6%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	29	8.7%
	JAJ012	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	301	90.1%	11	3.3%	3	0.9%	19	5.7%	334	100.0%
好酸球	JAB512	102	97.1%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.4%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	154	87.5%	15	8.5%	3	1.7%	4	2.3%	176	52.7%
	JAB519	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.8%
	JAB521	27	93.1%	1	3.4%	0	0.0%	1	3.4%	29	8.7%
	JAJ012	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	304	91.0%	20	6.0%	4	1.2%	6	1.8%	334	100.0%
好塩基球	JAB512	63	60.0%	26	24.8%	2	1.9%	14	13.3%	105	31.4%
	JAB514	2	22.2%	3	33.3%	2	22.2%	2	22.2%	9	2.7%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAB517	102	58.0%	21	11.9%	19	10.8%	34	19.3%	176	52.7%
	JAB519	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	6	1.8%
	JAB521	20	69.0%	5	17.2%	0	0.0%	4	13.8%	29	8.7%
	JAJ012	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	0.6%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	JAZ999	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%
	計	197	59.0%	56	16.8%	23	6.9%	58	17.4%	334	100.0%

表Ⅱ-10-1　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	65	94.2%	4	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	69	53.9%
	01-1201	54	96.4%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	56	43.8%
	01-2304	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%
	計	122	95.3%	6	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	128	100.0%
LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ	01-0403	69	98.6%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	70	54.7%
	01-1201	50	94.3%	2	3.8%	0	0.0%	1	1.9%	53	41.4%
	01-2302	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	計	124	96.9%	3	2.3%	0	0.0%	1	0.8%	128	100.0%
HbA1c	01-2701	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	17.4%
	01-2901	42	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	34.7%
	02-0403	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.8%
	02-0404	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.8%
	02-2401	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%
	03-0401	28	93.3%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	30	24.8%
	03-1201	5	83.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.0%
	03-1202	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%
	03-2701	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	03-3501	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.3%
	計	118	97.5%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	121	100.0%
赤血球数	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	71	94.7%	2	2.7%	1	1.3%	1	1.3%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	123	96.9%	2	1.6%	1	0.8%	1	0.8%	127	100.0%
ヘモグロビン	1	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.5%
	2	111	99.1%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	112	88.2%
	9	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	6.3%
	計	126	99.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	127	100.0%
ヘマトクリット	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	127	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	127	100.0%
白血球数	JAB512	13	92.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

表Ⅱ-10-2　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
白血球数	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	126	99.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	127	100.0%
血小板数	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	75	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	127	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	127	100.0%
平均赤血球容積	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.0%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	72	96.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	59.1%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	3.9%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.2%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	124	97.6%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	127	100.0%
好中球	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.1%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	72	97.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	74	58.7%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.0%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.3%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	124	98.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	126	100.0%
リンパ球	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.1%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	72	97.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	74	58.7%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.0%
	JAB521	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	14.3%
	JAJ012	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	124	98.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	126	100.0%

表Ⅱ-10-3　測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（自施設）　生血清・新鮮血液

調査項目	得点	85点以上		70点以上85点未満		60点以上70点未満		60点未満		合　計	
	測定方法	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
単球	JAB512	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.1%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	64	86.5%	1	1.4%	0	0.0%	9	12.2%	74	58.7%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.0%
	JAB521	17	94.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	18	14.3%
	JAJ012	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	114	90.5%	2	1.6%	1	0.8%	9	7.1%	126	100.0%
好酸球	JAB512	13	92.9%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	14	11.1%
	JAB514	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	69	93.2%	2	2.7%	1	1.4%	2	2.7%	74	58.7%
	JAB519	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.0%
	JAB521	16	88.9%	1	5.6%	0	0.0%	1	5.6%	18	14.3%
	JAJ012	0	0.0%	1	33.3%	1	33.3%	1	33.3%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	115	91.3%	5	4.0%	2	1.6%	4	3.2%	126	100.0%
好塩基球	JAB512	8	57.1%	3	21.4%	0	0.0%	3	21.4%	14	11.1%
	JAB514	2	22.2%	3	33.3%	2	22.2%	2	22.2%	9	7.1%
	JAB516	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAB517	42	56.8%	10	13.5%	8	10.8%	14	18.9%	74	58.7%
	JAB519	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	5	4.0%
	JAB521	14	77.8%	1	5.6%	0	0.0%	3	16.7%	18	14.3%
	JAJ012	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%
	JAJ803	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAR408	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	JAS304	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%
	JAZ999	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	計	74	58.7%	18	14.3%	10	7.9%	24	19.0%	126	100.0%

表Ⅱ-11　尿糖検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法（目視）	02	52	85.2%	9	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	61	52.6%
	22	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	29	12	75.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	13.8%
	32	10	90.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.5%
	60	2	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%
	61	22	91.7%	1	4.2%	0	0.0%	1	4.2%	24	20.7%
	合計	99	85.3%	16	13.8%	0	0.0%	1	0.9%	116	100.0%
試験紙法（機器）	02	161	92.5%	13	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	174	78.4%
	29	16	88.9%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	18	8.1%
	32	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	38	28	96.6%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	29	13.1%
	合計	206	92.8%	16	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	222	100.0%

表Ⅱ-12　尿蛋白検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法（目視）	02	59	96.7%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	61	52.6%
	22	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	29	15	93.8%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	13.8%
	32	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.5%
	60	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.6%
	61	23	95.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	24	20.7%
	合計	112	96.6%	4	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	116	100.0%
試験紙法（機器）	02	173	99.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	174	78.4%
	29	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	8.1%
	32	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	38	28	96.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	29	13.1%
	合計	220	99.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.9%	222	100.0%

表Ⅱ-13　尿潜血検査の測定法別の評価点ランク別施設数、構成比（全施設）

区分	試験紙製造元	８５点以上		７０点以上８５点未満		６０点以上７０点未満		６０点未満		合　計	
測定方法		施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
試験紙法（目視）	02	61	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	61	52.6%
	22	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%
	29	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	15.5%
	32	10	90.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.5%
	60	2	66.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	3	2.6%
	61	18	81.8%	2	9.1%	0	0.0%	2	9.1%	22	19.0%
	合計	110	94.8%	3	2.6%	1	0.9%	2	1.7%	116	100.0%
試験紙法（機器）	02	172	98.9%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	174	78.4%
	29	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	8.1%
	32	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%
	38	28	96.6%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	29	13.1%
	合計	219	98.6%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	222	100.0%

Ⅱ．調査試料測定結果（３）

◆ 臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

調査参加全施設調査項目評価点一覧表

今回の調査に参加した全施設の各調査項目についての評価点を掲載する。

項目の※表示は、測定を外部機関に委託している事を示す。

同測定法、同測定機器5施設以下も評価した。

空欄となっている項目については、測定値が報告されず評価ができなかったことを示す。

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
01001	93.3	100	100	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	78.6	71.4	71.4	85.7	95.2
01002	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
01007	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
01013	73.3	100	100	83.3	100	100	100	100	100	78.6	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	96.4
01018	100	100	93.3	100	100	96.7	86.7	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.4
01019	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
01023	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
01025	93.3	100	100	100	100	100	100	83.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.8
01027	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.3
01030	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
01034	※ 90	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	88	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
01035	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
01040	96.7	100	100	100	100	100	100	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
02001	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
02003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	100
02004	66.7	63.3	83.3	93.3	80	60	100	50	78.6	100	100	96	100	100	100	100	100	100	78.6	100	86.8
03001	100	100	100	100	100	100	100	90	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	98.7
03004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
03006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78.6	100
04001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.2
04004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
04006	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 73.3	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 92.9	97.3
04008	100	100	100	100	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
04009	93.3	100	100	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5
04012	86.7	80	100	100	100	100	100	53.3	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	94.9
04015	100	100	66.7	86.7	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.2
06001	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
06004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
07004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	100
08001	80	73.3	100	93.3	100	100	100	96.7	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.6
08002	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	88	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
08003	86.7	100	90	100	100	100	100	100	92.9	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	98.0

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	ＡＳＴ(GOT)	ＡＬＴ(GPT)	γ－ＧＴ	血糖	ＨＤＬコレステロール	ＬＤＬコレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
08006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.8
08009	100	86.7	93.3	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.4
08010	100	96.7	100	100	100	100	86.7	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	85.7	98.9
08019	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
09001	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
09004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
09005	80	86.7	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	88	96	100	100	100	100	100	78.6	100	95.9
09007	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.5
09008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 40	※ 60	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.1
09009	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
09010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
09011	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
09012	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
09013	100	100	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	99.1
09014	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
09016	100	100	100	100	100	93.3	100	86.7	100	100		88	100	100							97.5
10001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
10002	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
10005	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10007	93.3	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
11002	※ 90	※ 100	※ 100	※ 90	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
11004	※ 80	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 84	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 50	96.7
11005	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
11006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11007	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
11010	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100
11020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	99.6
11021	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	99.8
11023	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	78.6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.3
11025	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
11033	53.3	76.7	86.7	93.3	100	73.3	93.3	70	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	91.7
12001	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	96	100	92	100	100	100	100	100	100	99.0

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
12002	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12003	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 64.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.6
12008	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
12010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
12011	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
12012	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 90	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	36	92	56	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	91.6
12013	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
12014	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 80	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
12015	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	96	100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.0
12016	86.7	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	85.7	100	98.0
12018	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.8
12019	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	99.1
13001	※ 86.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
13002	96.7	100	100	100	100	100	100	100	85.7	92.9	100	100	100	92	100	100	100	100	71.4	100	96.8
13003	93.3	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.3
13004	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	97.1
13005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	84	88	88	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.8
13006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	88	88	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.6
13007	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.7
13008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 71.4	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
13010	※ 93.3	※ 93.3	※ 93.3	※ 93.3	※ 90	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.5
13013	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
13014	※ 80	※ 100	※ 83.3	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	84	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.1
13015	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
13016	100	100	100	100	90	76.7	86.7	90	100	100	100	88	100	100	85.7	100	100	100	100	100	95.6
13017	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	100	98.9
13021	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
13022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
13024	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
13026	100	100	93.3	100	53.3	100	86.7	100	100	100	100	88	100	100	92.9	100	100	100	100	100	95.5
13035	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
13036	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	ＡＳＴ(GOT)	ＡＬＴ(GPT)	γ－ＧＴ	血糖	ＨＤＬコレステロール	ＬＤＬコレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
13038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13039	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	96	40	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.2
13045	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
13049	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
13051	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
13052	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
13053	96.7	100	93.3	100	90	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	97.8
13055	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	92	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
13056	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
13061	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
13063	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13064	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13067	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 93.3	※ 90	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
13071	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 80	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
13074	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	84	100	96	64.3	100	100	100	100	100	96.7
13077	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 80	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.4
13078	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	88	80	100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
13079	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 64.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.0
13080	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	96	60	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.6
13083	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
13084	100	100	100	100	76.7	100	100	66.7	100	92.9	100	96	100	88	100	100	100	100	0	100	90.5
13088	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
13089	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
13101	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	96	100	92	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.6
13103	100	100	100	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
13107	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
13108	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
13109	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
13115	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 84	※ 100	※ 100	※ 64.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.2
13125	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 64.3	※ 50	※ 100	※ 84	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	91.7
13135	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.9
13136	※ 100	※ 80	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
13135	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.9
13136	※ 100	※ 80	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
13145	93.3	100	100	100	100	100	66.7	83.3	100	57.1	71.4	100	100	88	92.9	100	100	100	100	100	92.2
13156	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.8
13181	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.1
14001	100	86.7	100	100	100	96.7	93.3	100	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.0
14002	※ 100	※ 90	※ 86.7	※ 100	※ 96.7	※ 93.3	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.1
14003	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.8
14004	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
14005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
14006	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 70	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	94.2
14007	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.6
14010	80	100	93.3	36.7	90	100	100	96.7	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94.2
14018	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	92	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
14022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
14023	※ 80	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 76.7	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	100	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92.5
14025	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	100	99.2
14026	※ 93.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 84	※ 100	※ 100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.2
14029	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 64.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.6
14030	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	99.6
14042	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 84	※ 100	※ 96	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.5
14046	100	100	93.3	80	100	90	100	73.3	100	100	64.3	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	94.4
15001	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.3
15004	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.7
15006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.8
15007	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
15008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
15010	※ 100	※ 93.3	※ 86.7	※ 93.3	※ 86.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.7
15011	100	86.7	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	100	98.2
15012	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
16002	96.7	100	83.3	96.7	100	63.3	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	96.5
16004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	ＡＳＴ(GOT)	ＡＬＴ(GPT)	γ－ＧＴ	血糖	ＨＤＬコレステロール	ＬＤＬコレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
16005	※ 80	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 86.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	93.7
16006	93.3	93.3	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	98.9
16008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	76	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.9
17001	86.7	100	100	100	96.7	83.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.2
17003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
18001	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.3
18003	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.2
20001	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	96	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.0
20003	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	97.1
20004	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	92	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	97.3
20005	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	96.9
21001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
21002	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
21005	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
21006	93.3	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	98.5
21015	※ 90	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
22001	※ 90	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
22002	100	100	83.3	100	100	100	100	83.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.2
22003	86.7	63.3	100	93.3	93.3	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.5
22004	93.3	100	100	100	100	100	100	100	92.9	92.9	71.4	100	100	72	100	100	100	100	100	100	95.9
22006	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22007	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 90	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.2
22011	※ 93.3	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 63.3	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.9
22012	100	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
22015	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.3
22017	100	100	83.3	100	93.3	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	97.7
22019	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
22023	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
22028	100	100	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	99.3
23001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
23002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	96	100	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	98.2

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
23003	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.8
23005	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	84	92	92	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
23006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.7
23007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.9
23008	100	93.3	93.3	100	66.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.5
23009	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	84	72	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.2
23011	100	100	93.3	93.3	100	100	93.3	100	85.7	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	97.8
23012	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
23015	100	100	100	53.3	43.3	66.7	100	83.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	91.9
23016	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23017	100	93.3	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	92.9	100	100	100	100	98.9
23018	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
23019	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	99.6
23022	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
23024	100	93.3	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5
23026	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.4
23029	100	93.3	100	100	100	93.3	100	93.3	100	100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
23030	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
23032	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 85.7	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
23037	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
23038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.1
23040	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	88	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
23042	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	84	96	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.3
23055	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
23056	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100		99.6
23060	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
23067	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	92.9	100	98.9
24001	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
24008	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
24012	100	100	100	100	93.3	96.7	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	92.9	100	85.7	92.9	98.1
25002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
25003	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	ＡＳＴ(GOT)	ＡＬＴ(GPT)	γ－ＧＴ	血糖	ＨＤＬコレステロール	ＬＤＬコレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
25006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
25011												100	100	100							100
26001	100	100	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.6
26002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.7
26003	100	100	100	100	90	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	71.4	100	100	100	100	100	97.6
26005	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 92.9	※ 100	※ 92.9	100	100	100	※ 57.1	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.9
26006	100	100	100	100	100	100	100	90	100	100	100	84	100	100	100	100	100	100	92.9	100	98.3
26009	※ 100	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 66.7	※ 56.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.1
26012	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
26020	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 85.7	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
27002	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 76.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	92	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.5
27003	※ 50	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 92.9	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	96.2
27007	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 64.3	※ 100	※ 92.9	88	88	72	※ 50	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	91.7
27010	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
27014	100	100	100	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.2
27018	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
27020	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27023	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 92.9	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
27037	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 71.4	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
27038	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
27041	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
27042	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
27044	100	100	93.3	100	60	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.4
27045	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 50	※ 50	※ 100	88	100	100	※ 78.6	※ 100	※ 0	※ 0	※ 0	※ 0	76.8
27046	93.3	93.3	93.3	100	90	100	73.3	100	100	100	100	84	100	100	100	100	100	100	100	85.7	96.2
27048	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	98.5
27051	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	96	92	※ 71.4	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.5
27062	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
28001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 90	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	96	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
28002	100	100	93.3	100	100	96.7	100	100	92.9	100	100	100	100	100	57.1	100	100	100	100	78.6	96.8
28003	100	100	100	100	66.7	70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96.7
28004	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 50	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	96.3

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖 判定量	尿蛋白 判定量	尿潜血 判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
28007	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	100	96	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
28011	100	100	100	100	93.3	100	100	90	78.6	100	100	100	100	96	100	64.3	100	100	100	100	95.9
28014	※ 90	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
28015	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.5
28016	100	86.7	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	98.2
28017	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28018	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.7
28019	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	100	88	92	※ 78.6	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.4
28022	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 63.3	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.7
28024	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 40	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	95.8
28029	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 71.4	※ 85.7	※ 100	96.5
28031	86.7	86.7	93.3	100	63.3	80	100	63.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.3
28034	100	100	100	100	100	60	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.5
28038	※ 93.3	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
30004	80	100	100	100	76.7	80	100	100	100	100	100	100	100	96	92.9	100	100	100	100	92.9	96.1
30005	93.3	80	100	100	100	100	90	100	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.3
30006	100	100	100	100	96.7	100	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
31002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.5
31003	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.7
31005	100	100	86.7	100	66.7	93.3	93.3	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	92.9	96.1
32001	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92.9	99.6
32002	100	100	100	100	100	100	100	83.3	100	100	100	100	100	96	100	100	78.6	71.4	78.6	85.7	95.2
33001	93.3	100	100	100	100	100	100	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.3
33002	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.2
33004	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
33005	66.7	50	93.3	100	100	93.3	100	100	92.9	92.9	100	100	100	96	100	85.7	100	100	100	100	93.2
33008	100	100	93.3	100	100	100	96.7	100	92.9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
33009	100	100	63.3	73.3	100	60	100	46.7	92.9	85.7	100	88	100	100	100	100	100	100	100	100	90.0
34001	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
34002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.7
34003	※ 100	※ 93.3	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
34004	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	78.6	100	100	100	92.9	100	98.3

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	ＡＳＴ(GOT)	ＡＬＴ(GPT)	γ－ＧＴ	血糖	ＨＤＬコレステロール	ＬＤＬコレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
34005	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.6
34009	100	100	93.3	100	100	100	100	76.7	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.7
34010	100	80	63.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	81.2
34011	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.8
34012	100	93.3	96.7	100	40	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.2
34013	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.8
34015	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.6
35001	100	100	96.7	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.1
35006	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 71.4	※ 100	※ 100	84	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.3
36002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
37001	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	96	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.1
37004	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	40	60	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	93.4
37006	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	100	92	※ 71.4	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	95.7
38006	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
38009	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 40	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	68	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.3
39001	100	100	100	100	100	100	100	100	50	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	92.9	96.9
39002	93.3	100	93.3	100	100	100	76.7	100	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.3
39003	86.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.1
39004	100	100	93.3	100	100	100	93.3	93.3	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	98.7
40001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
40002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
40004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.6
40005	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.4
40006	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
40007	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	99.6
40009	100	100	93.3	100	100	100	100	96.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.5
40013	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.9
40015	※ 86.7	※ 93.3	※ 100	※ 96.7	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	92	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
40025	※ 100	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 85.7	※ 100	※ 100	88	100	96	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.2
40026	※ 100	※ 93.3	※ 100	※ 96.7	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.3
40027	100	100	86.7	100	100	100	100	100	85.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.5
40028	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 36.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	92	92	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	94.1

臨床検査精度管理調査評価結果一覧表

施設コード	総コレステロール	中性脂肪	尿酸	クレアチニン	AST (GOT)	ALT (GPT)	γ－GT	血糖	HDL コレステロール	LDL コレステロール	HbA1C	尿糖判定量	尿蛋白判定量	尿潜血判定量	赤血球数	ヘモグロビン量	ヘマトクリット値	白血球数	血小板数	平均赤血球容積	全試料平均
40029	※ 96.7	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 80	※ 93.3	※ 93.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	72	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.4
40031	※ 90	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 93.3	※ 92.9	※ 100	※ 100	92	92	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	97.7
40034	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
40035	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.0
41001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 71.4	※ 100	※ 100	84	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	97.7
42001	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 88	※ 100	※ 100	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.6
42002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 96.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	99.8
43001	100	80	93.3	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	92	85.7	100	100	100	100	100	96.4
43003	93.3	100	100	90	53.3	43.3	90	100	85.7	100	100	84	100	100	85.7	100	100	100	100	100	90.8
43004	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	99.2
43007	※ 90	※ 100	※ 63.3	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 80	※ 100	※ 100	※ 85.7	88	100	96	※ 100	※ 85.7	※ 92.9	※ 100	※ 100	※ 71.4	93.1
44002	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	100
45002	100	100	100	100	100	100	100	96.7	85.7	100	100	100	100	100	85.7	100	92.9	100	100	57.1	97.9
46001	※ 86.7	※ 100	※ 86.7	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	88	100	100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	98.0
46004	100	100	100	93.3	100	100	93.3	66.7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97.5
47001	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	94.7
47002	※ 93.3	※ 100	※ 83.3	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 85.7	※ 100	※ 100	84	100	88	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	※ 100	96.5
47004	100	86.7	100	100	100	93.3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98.9
47005	93.3	100	93.3	100	100	100	100	66.7	85.7	100	100	100	92	100	100	100	92.9	100	85.7	78.6	95.2
47006	100	96.7	93.3	100	100	93.3	100	96.7	100	100	100	100	100	96	100	100	100	100	100	100	98.7

Ⅱ．調査試料測定結果（４）
（自施設測定施設 濃度値一覧）

［１］　総コレステロール
［２］　中性脂肪
［３］　尿酸
［４］　クレアチニン
［５］　ＡＳＴ（ＧＯＴ）
［６］　ＡＬＴ（ＧＰＴ）
［７］　γ－ＧＴ
［８］　血糖
［９］　ＨＤＬコレステロール
［１０］　ＨＤＬコレステロール
［１１］　ＨｂＡ１ｃ

［１２］　尿糖
［１３］　尿蛋白
［１４］　尿潜血

［１５］　赤血球数
［１６］　ヘモグロビン量
［１７］　ヘマトクリット値
［１８］　白血球数
［１９］　血小板数
［２０］　平均赤血球容積

白血球百分率
［２１］　好中球
［２２］　リンパ球
［２３］　単球
［２１］　好酸球
［２２］　好塩基球

自施設測定施設の調査項目ごと測定法及び報告値一覧

５試料を送付した項目について

総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖項目については、8濃度の試料を作製し、作製した8濃度の試料のうちランダムに5試料を選んで参加施設に送付している。

5試料の測定値を評価点に換算した場合の評価基準での評価を「試料No別判定値」（A～D四段階評価）、測定値の評価を100点満点に換算した評価点合計、解析値評価点合計、及びそれら評価点を平均した総合評価点の一覧を、表の［１］総コレステロールから表の［８］血糖に示す。

３試料を送付したHDL・LDLコレステロール項目について

HDL・LDLコレステロール項目については、作製した3濃度の試料のうちランダムに選んだ2試料を送付し、報告された測定値、その測定値についての判定値及び総合評価点の一覧を表の［９］から表の［１０］に示す。生血清2試料の測定値は参考調査です。評価はしません

３試料を送付し、新鮮血液２試料の残余で検査したHbA1c項目について

HbA1c試料は、作製した3濃度の試料のうちランダムに送付した2試料の報告された測定値、その測定値の判定値及び総合評価点の一覧を表の［１１］に示す。

血液検査終了後の新鮮血液2試料の残余で検査されたHbA1cの測定値を示した。新鮮血液2試料の測定値は参考調査です。評価はしません。

５試料を送付した尿半定性検査について

尿糖、尿蛋白、尿潜血は、作製した8濃度試料のうち、ランダムに送付した5試料の測定値、その測定値の判定値及び総合評価点の一覧を表の［１２］から表の［１４］に示す。

加工血３試料と新鮮血液2試料を送付した血液検査について

赤血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積は、作製した加工血3試料のうちランダムに2試料を選択し、新鮮血液試料2試料と合計4試料を送付した。

赤血球数・ヘモグロビン量については新鮮血液2試料の測定値の判定値及び総合評価点の一覧を表の［１５］から表の［１６］に示す。ただし、強溶血で測定不能の場合は、従来通り加工血試料の測定値を以て総合評価点を算出した。（今年度については、Ⅲ章各論的考察の「血液学検査」を参照）

白血球百分率は新鮮血液2試料について掲載した。また、好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球については、測定値の一覧を表の［２１］好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球に示す。

[1] 総コレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	-----	160	173	184	-----	205	-----	229	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
01013	11	144	-----	166	177	-----	-----	211	224	A	--	A	A	--	--	A	A	100	46.7	73.3
01018	11	149	-----	172	184	-----	-----	218	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01025	11	-----	163	174	-----	198	-----	221	233	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
01040	11	152	-----	174	-----	198	208	221	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
02004	11	-----	162	176	-----	197	-----	223	236	--	A	A	--	A	--	A	A	100	33.3	66.7
03001	11	149	161	-----	184	-----	206	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	11	-----	160	173	184	-----	207	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	11	150	161	-----	186	-----	208	220	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	149	161	-----	183	-----	207	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	11	149	-----	172	183	-----	-----	217	228	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
04012	11	151	163	-----	186	-----	209	223	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
04015	11	148	-----	172	-----	195	207	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08001	11	143	-----	167	177	-----	-----	212	223	A	--	A	A	--	--	A	A	100	60.0	80.0
08003	11	-----	162	174	186	-----	210	-----	234	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
08006	11	148	161	-----	-----	195	207	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	11	149	-----	172	-----	195	207	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08010	11	-----	160	172	184	-----	208	-----	231	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	11	150	162	-----	-----	196	208	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	11	-----	164	175	-----	199	-----	222	234	--	A	A	--	A	--	A	A	100	60.0	80.0
09012	11	-----	162	173	185	-----	207	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
09013	11	148	-----	172	-----	194	205	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	11	-----	161	173	185	-----	208	-----	233	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	11	149	161	-----	183	-----	208	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	11	-----	159	170	-----	193	-----	217	229	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
11006	11	150	-----	173	-----	197	208	219	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	11	-----	161	173	-----	196	-----	220	231	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	11	148	-----	171	-----	195	207	219	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	11	-----	161	172	184	-----	207	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	11	-----	159	171	-----	187	-----	217	225	--	A	A	--	B	--	A	A	93.3	13.3	53.3
12001	11	149	161	-----	-----	196	208	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	11	149	161	-----	184	-----	208	220	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	11	149	161	-----	-----	195	206	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	11	151	-----	175	-----	198	211	221	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
12019	11	149	161	-----	-----	192	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	80.0	90.0
13002	11	-----	161	172	-----	197	-----	221	230	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
13003	11	-----	160	172	-----	196	-----	220	232	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
13016	11	149	162	-----	183	-----	207	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13017	11	-----	160	172	183	-----	207	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	11	147	-----	171	182	-----	-----	217	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13053	11	152	-----	174	-----	198	207	221	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
13061	11	-----	161	173	184	-----	208	-----	231	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	11	149	-----	173	-----	196	208	220	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	11	-----	162	174	185	-----	209	-----	233	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	11	-----	161	172	184	-----	208	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	11	149	160	-----	-----	195	208	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	11	-----	159	170	-----	194	-----	217	228	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14001	11	147	159	-----	183	-----	206	217	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14003	11	149	161	-----	-----	195	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	11	-----	162	175	-----	198	-----	222	235	--	A	A	--	A	--	A	A	100	60.0	80.0
14025	11	149	160	-----	-----	195	206	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[1] 総コレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	11	148	-----	171	183	-----	-----	218	230	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	11	150	162	-----	-----	197	209	-----	232	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15001	11	147	-----	169	181	-----	-----	216	227	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
15006	11	148	160	-----	183	-----	206	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	11	148	161	-----	-----	196	206	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	11	147	-----	172	-----	196	205	215	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
16002	11	147	159	-----	-----	195	205	-----	227	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
16006	11	147	159	-----	-----	195	207	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
17001	11	152	-----	174	187	-----	-----	222	233	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
18001	11	-----	160	171	183	-----	207	-----	231	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	11	148	-----	171	-----	193	207	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	-----	159	173	184	-----	208	-----	232	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
21006	11	151	162	-----	186	-----	209	221	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
22002	11	150	-----	172	184	-----	-----	220	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	146	-----	169	-----	193	205	216	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
22004	11	148	160	-----	182	-----	205	216	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
22006	11	148	160	-----	182	-----	206	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	148	159	-----	182	-----	205	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	11	149	-----	172	183	-----	-----	219	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22028	11	149	161	-----	184	-----	208	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	11	-----	162	172	184	-----	205	-----	231	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
23008	11	148	160	-----	-----	195	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23011	11	-----	162	173	-----	197	-----	219	232	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	11	-----	160	173	-----	197	-----	218	230	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23016	11	-----	161	172	-----	196	-----	219	231	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	11	150	162	-----	185	-----	208	220	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	11	149	161	-----	-----	196	208	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	11	-----	159	172	-----	195	-----	218	230	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	11	-----	161	172	-----	196	-----	220	231	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23067	11	149	159	-----	184	-----	207	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	11	149	161	-----	-----	196	208	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	11	-----	161	172	-----	195	-----	219	231	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	161	172	183	-----	207	-----	229	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	11	-----	160	171	-----	194	-----	217	229	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	11	150	-----	173	184	-----	-----	220	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	11	148	-----	173	-----	195	206	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	11	149	161	-----	184	-----	207	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	150	161	-----	-----	197	207	-----	232	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27046	11	147	-----	170	181	-----	-----	217	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
28002	11	-----	158	171	183	-----	205	-----	228	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	148	160	-----	-----	194	208	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	11	-----	160	172	-----	196	-----	219	232	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	11	150	-----	174	-----	197	209	221	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	148	-----	172	-----	195	206	219	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	11	150	161	-----	183	-----	205	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
28034	11	149	-----	173	184	-----	-----	219	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	11	151	164	-----	187	-----	211	223	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	60.0	80.0
30005	11	150	-----	175	-----	198	210	222	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
30006	11	150	-----	173	184	-----	-----	220	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	11	151	160	-----	-----	196	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
32001	11	-----	158	170	182	-----	206	-----	228	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3

[1] 総コレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No 別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	11	149	-----	172	183	-----	-----	218	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	11	149	-----	171	-----	194	206	216	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
33005	11	-----	157	167	177	-----	200	-----	224	--	A	A	A	--	A	--	A	100	33.3	66.7
33008	11	148	-----	172	185	-----	-----	218	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	11	150	162	-----	-----	197	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34004	11	149	-----	173	185	-----	-----	221	232	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	11	149	160	-----	184	-----	208	219	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	11	147	-----	171	-----	195	206	218	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	11	149	160	-----	-----	195	207	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	11	147	160	-----	-----	195	207	-----	231	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34015	11	149	-----	174	185	-----	-----	220	232	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	11	149	-----	173	-----	195	207	219	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	11	-----	161	172	183	-----	207	-----	230	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	11	147	161	-----	-----	193	204	-----	229	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
39003	11	151	-----	175	-----	199	211	222	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
39004	11	-----	161	173	185	-----	209	-----	232	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40007	11	149	159	-----	184	-----	206	218	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	11	147	160	-----	-----	196	206	-----	229	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	11	149	-----	173	185	-----	-----	219	232	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	11	147	159	-----	181	-----	206	217	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
43003	11	150	-----	172	182	-----	-----	217	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
45002	11	150	-----	172	184	-----	-----	220	231	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	11	148	-----	171	182	-----	-----	217	229	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47001	11	-----	161	172	-----	197	-----	220	231	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	11	147	159	-----	-----	194	206	-----	230	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	11	-----	162	175	-----	198	-----	221	233	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
47006	11	151	-----	172	-----	197	208	220	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	21	78	-----	96	105	-----	-----	133	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	21	78	-----	96	105	-----	-----	132	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01025	21	-----	87	96	-----	114	-----	131	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	21	78	-----	96	-----	114	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	21	-----	88	98	-----	116	-----	136	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100	26.7	63.3
03001	21	78	87	-----	105	-----	123	132	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	21	-----	86	96	105	-----	123	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	21	78	87	-----	105	-----	123	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	21	78	86	-----	104	-----	122	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	21	77	-----	95	104	-----	-----	131	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	21	81	90	-----	107	-----	126	136	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	60.0	80.0
04015	21	79	-----	96	-----	114	122	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08001	21	74	-----	92	101	-----	-----	126	136	A	--	A	A	--	--	A	A	100	46.7	73.3
08003	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	21	78	87	-----	-----	114	123	-----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	21	78	-----	97	-----	115	125	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
08010	21	-----	86	96	103	-----	123	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
09001	21	78	88	-----	-----	114	124	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	21	-----	89	98	-----	116	-----	135	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
09012	21	-----	86	95	104	-----	122	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	21	77	-----	95	-----	113	122	131	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	21	-----	87	97	106	-----	124	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	21	79	88	-----	106	-----	124	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	21	-----	85	94	-----	112	-----	130	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
11006	21	78	-----	96	-----	115	123	131	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	21	-----	87	96	-----	114	-----	132	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	21	78	-----	96	-----	115	123	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	21	-----	84	93	-----	109	-----	129	137	--	A	A	--	A	--	A	A	100	53.3	76.7
12001	21	78	87	-----	-----	115	124	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	21	78	87	-----	105	-----	123	132	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	21	79	88	-----	-----	115	123	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	21	78	-----	96	-----	114	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	21	77	87	-----	-----	113	123	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	21	-----	87	95	-----	115	-----	133	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	21	-----	86	95	-----	113	-----	132	140	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	21	78	87	-----	104	-----	121	132	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13017	21	-----	88	98	106	-----	124	-----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	21	77	-----	95	104	-----	-----	131	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13053	21	78	-----	96	-----	114	124	133	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13061	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	21	77	-----	96	-----	113	122	131	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	21	-----	87	97	106	-----	124	-----	143	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	21	77	87	-----	-----	113	122	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	21	-----	86	95	-----	114	-----	131	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14001	21	76	85	-----	102	-----	121	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
14003	21	78	87	-----	-----	114	123	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	21	-----	87	97	-----	116	-----	133	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14025	21	78	86	-----	-----	114	122	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	21	77	-----	95	103	-----	-----	131	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	21	77	86	-----	-----	114	122	-----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15001	21	77	-----	96	105	-----	-----	132	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	21	77	87	-----	105	-----	123	132	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	21	76	85	-----	-----	112	121	-----	138	A	A	--	--	A	A	--	A	100	73.3	86.7
15012	21	76	-----	95	-----	112	122	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	21	77	86	-----	-----	113	121	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16006	21	76	85	-----	-----	112	121	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
17001	21	78	-----	96	105	-----	-----	132	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
18001	21	-----	87	95	104	-----	123	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	21	77	-----	95	-----	114	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	-----	88	97	106	-----	124	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	21	79	88	-----	106	-----	124	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	21	78	-----	96	105	-----	-----	132	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	21	77	-----	94	-----	111	120	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	26.7	63.3
22004	21	79	87	-----	105	-----	123	132	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	21	77	86	-----	104	-----	122	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	21	78	87	-----	105	-----	122	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	21	78	-----	96	104	-----	-----	132	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22028	21	79	87	-----	105	-----	124	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	21	-----	88	96	106	-----	124	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	21	77	87	-----	-----	114	124	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23011	21	-----	88	96	-----	114	-----	132	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	21	-----	87	96	-----	115	-----	133	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23016	21	-----	88	96	-----	115	-----	133	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	21	79	89	-----	107	-----	125	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
23019	21	78	87	-----	-----	115	124	-----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	21	-----	86	94	-----	112	-----	130	139	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23029	21	-----	87	95	-----	115	-----	134	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23067	21	78	87	-----	104	-----	123	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	21	77	86	-----	-----	113	122	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	21	-----	87	96	-----	114	-----	132	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	86	95	103	-----	122	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	21	-----	86	96	-----	114	-----	132	141	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	21	77	-----	95	104	-----	-----	131	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	21	78	-----	95	-----	114	123	131	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	21	77	86	-----	104	-----	122	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	21	79	87	-----	-----	115	124	-----	142	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27046	21	76	-----	95	103	-----	-----	130	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
28002	21	-----	87	96	105	-----	124	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	21	78	86	-----	-----	113	122	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	21	-----	87	96	-----	114	-----	133	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	21	78	-----	96	-----	115	125	134	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
28017	21	78	-----	96	-----	114	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	21	76	85	-----	103	-----	120	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
28034	21	79	-----	96	104	-----	-----	132	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	21	79	87	-----	106	-----	125	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
30005	21	79	-----	98	-----	116	126	135	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
30006	21	79	-----	97	106	-----	-----	132	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	21	78	86	-----	-----	113	123	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
32001	21	-----	86	95	105	-----	122	-----	140	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	21	77	-----	96	104	-----	-----	131	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	21	79	-----	96	-----	114	124	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	11	-----	83	94	103	-----	121	-----	134	--	A	A	A	--	A	--	A	100	0.0	50.0
33008	21	77	-----	95	104	-----	-----	131	141	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	21	78	87	-----	-----	114	123	-----	141	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34004	21	79	-----	97	106	-----	-----	134	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	21	77	86	-----	104	-----	123	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	21	74	-----	92	-----	109	118	127	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	60.0	80.0
34011	21	77	87	-----	-----	113	122	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	21	76	85	-----	-----	112	121	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
34015	21	78	-----	96	105	-----	-----	133	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	21	78	-----	96	-----	114	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	21	-----	87	97	105	-----	123	-----	142	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	21	78	86	-----	-----	113	122	-----	139	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
39003	21	79	-----	97	-----	115	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	21	-----	87	96	105	-----	123	-----	141	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40007	21	79	88	-----	106	-----	123	133	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	21	77	87	-----	-----	114	123	-----	140	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	21	77	-----	95	104	-----	-----	132	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	21	75	85	-----	102	-----	120	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	60.0	80.0
43003	21	78	-----	95	104	-----	-----	131	139	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
45002	21	78	-----	95	105	-----	-----	132	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	21	78	-----	95	105	-----	-----	131	140	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47001	21	-----	88	96	-----	115	-----	133	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	21	79	88	-----	-----	116	125	-----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100	73.3	86.7
47005	21	-----	88	96	-----	115	-----	133	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47006	21	77	-----	95	-----	112	123	132	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7

[3] 尿酸　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	6.9	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.3	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	31	5.1	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.5	7.9	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
01025	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.3	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	31	-----	5.4	5.7	-----	6.5	-----	7.3	7.6	--	A	A	--	A	--	A	B	93.3	73.3	83.3
03001	31	5	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	31	5.1	5.5	-----	6.2	-----	7	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	31	5.1	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	31	5.1	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04015	31	5	-----	5.7	-----	6.4	6.9	7.2	-----	A	--	A	--	B	A	B	--	86.7	46.7	66.7
08001	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.7	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	31	-----	5.3	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.7	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
08006	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.7	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	31	5	-----	5.8	-----	6.5	6.9	7.3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
08010	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.5	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	31	5	5.4	-----	6.1	-----	7	7.3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.5	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	31	5.1	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	31	5	-----	5.7	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	31	-----	5.4	5.9	6.3	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	31	-----	5.5	5.7	-----	6.6	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	73.3	86.7
12001	31	5.1	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	31	5	5.4	-----	-----	6.6	6.9	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13017	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	31	5.1	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.5	7.9	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
13053	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
13061	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13064	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	31	-----	5.5	5.9	6.3	-----	7.1	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
13084	31	-----	5.4	5.8	6.1	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	31	5.1	5.4	-----	-----	6.7	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.3	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14001	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14003	31	5.1	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.3	7.7	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
14025	31	5.1	5.5	-----	-----	6.6	7.1	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[3] 尿酸　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	31	5.1	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.5	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	31	4.9	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
15001	31	5.1	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	31	5	5.4	-----	-----	6.5	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	31	5	-----	5.8	-----	6.5	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	31	5.1	5.5	-----	-----	6.8	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	B	A	--	A	93.3	73.3	83.3
16006	31	5.1	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
17001	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
18001	31	-----	5.3	5.7	6.1	-----	6.9	-----	7.7	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
21002	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	31	5	5.3	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	31	4.9	-----	5.7	6.1	-----	-----	7.3	7.7	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	73.3	83.3
22003	31	5	-----	5.9	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22004	31	5	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	31	4.9	-----	5.7	6.1	-----	-----	7.3	7.7	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	73.3	83.3
22028	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	6.9	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
23011	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.3	7.7	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23015	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23016	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23067	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	31	5	5.4	-----	-----	6.6	6.9	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	31	5	-----	5.9	-----	6.6	7	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	31	5.1	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
27046	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.3	7.7	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
28002	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	6.9	-----	7.7	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
28003	31	5	5.5	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	31	-----	5.4	5.8	-----	6.6	-----	7.4	7.8	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	31	4.9	-----	5.7	-----	6.5	6.9	7.3	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	80.0	86.7
28017	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	31	5.1	5.5	-----	6.3	-----	7.1	7.5	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
28034	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	31	5.1	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
30005	31	5	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30006	31	5	-----	5.8	6.1	-----	-----	7.3	7.7	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	31	4.9	5.3	-----	-----	6.5	6.9	-----	7.7	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	80.0	86.7
32001	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[3] 尿酸　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値評価点	解析値評価点	総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8			
32002	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	31	5	-----	5.8	-----	6.6	6.9	7.3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	31	-----	5.5	5.9	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
33008	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.3	7.7	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
33009	31	5.2	5.6	-----	-----	6.9	7.1	-----	8	B	B	--	--	B	A	--	B	73.3	53.3	63.3
34004	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.5	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	31	5.1	5.5	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
34010	31	4.8	-----	5.6	-----	6.4	6.8	7.2	-----	B	--	B	--	B	B	B	--	66.7	60.0	63.3
34011	31	5.1	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	31	5	5.5	-----	-----	6.7	7.1	-----	7.9	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
34015	31	5.1	-----	5.9	6.3	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
35001	31	5	-----	5.7	-----	6.5	6.9	7.3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
39001	31	-----	5.4	5.8	6.2	-----	7	-----	7.8	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	31	5.1	5.5	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
39003	31	5.1	-----	5.8	-----	6.6	7	7.4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	31	-----	5.5	5.9	6.3	-----	7.1	-----	7.9	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
40007	31	5	5.4	-----	6.2	-----	7	7.4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	31	5	5.4	-----	-----	6.5	6.9	-----	7.7	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
40027	31	5.1	-----	5.8	6.3	-----	-----	7.3	7.7	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
43001	31	5	5.4	-----	6.2	-----	6.9	7.3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
43003	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.3	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
45002	31	5.1	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.5	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	31	5	-----	5.8	6.2	-----	-----	7.4	7.8	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47001	31	-----	5.5	5.9	-----	6.7	-----	7.4	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	31	5	5.4	-----	-----	6.6	7	-----	7.8	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	31	-----	5.4	5.9	-----	6.7	-----	7.5	7.9	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
47006	31	5.1	-----	5.9	-----	6.7	7.1	7.5	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3

[4] クレアチニン　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	-----	1.12	1.74	2.39	-----	3.68	-----	4.97	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	21	0.53	-----	1.83	2.45	-----	-----	4.37	5.01	B	--	B	A	--	--	A	A	86.7	80.0	83.3
01018	21	0.46	-----	1.73	2.38	-----	-----	4.35	5.04	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01025	21	-----	1.14	1.79	-----	3.1	-----	4.35	5	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	21	0.49	-----	1.78	-----	3.09	3.72	4.36	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	21	-----	1.15	1.8	-----	3.1	-----	4.46	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
03001	21	0.48	1.12	-----	2.4	-----	3.65	4.31	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	21	-----	1.09	1.73	2.39	-----	3.71	-----	5.03	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	21	0.48	1.11	-----	2.39	-----	3.69	4.34	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	21	0.46	1.1	-----	2.38	-----	3.73	4.39	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	21	0.46	-----	1.73	2.38	-----	-----	4.35	5	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	21	0.45	1.08	-----	2.4	-----	3.72	4.38	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04015	21	0.5	-----	1.81	-----	3.12	3.78	4.45	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	93.3	80.0	86.7
08001	21	0.49	-----	1.74	2.37	-----	-----	4.26	4.87	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
08003	21	-----	1.14	1.77	2.42	-----	3.7	-----	4.99	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	21	0.47	1.11	-----	-----	3.07	3.72	-----	5.04	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	21	0.48	-----	1.73	-----	2.97	3.61	4.23	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
08010	21	-----	1.09	1.74	2.37	-----	3.71	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	21	0.48	1.1	-----	-----	3.01	3.65	-----	4.96	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	21	-----	1.08	1.71	-----	3.06	-----	4.4	5.05	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	21	-----	1.12	1.76	2.42	-----	3.74	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	21	0.49	-----	1.77	-----	3.07	3.73	4.36	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	21	-----	1.14	1.79	2.44	-----	3.74	-----	5.03	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	21	0.48	1.12	-----	2.41	-----	3.72	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	21	-----	1.08	1.7	-----	3.01	-----	4.32	4.92	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	21	0.46	-----	1.72	-----	3.03	3.73	4.41	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	21	-----	1.12	1.75	-----	3.05	-----	4.35	5	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	21	0.49	-----	1.75	-----	3.07	3.7	4.34	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	21	-----	1.09	1.74	2.37	-----	3.72	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	21	-----	1.15	1.79	-----	3.02	-----	4.39	5.05	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12001	21	0.48	1.11	-----	-----	3.02	3.69	-----	4.95	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	21	0.49	1.12	-----	2.39	-----	3.69	4.33	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	21	0.49	1.13	-----	-----	3.06	3.68	-----	4.96	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	21	0.47	-----	1.74	-----	3.04	3.7	4.36	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	21	0.47	1.1	-----	-----	3.03	3.65	-----	4.97	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	21	-----	1.15	1.78	-----	3.07	-----	4.37	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	21	-----	1.09	1.72	-----	3.04	-----	4.36	5.01	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	21	0.48	1.12	-----	2.37	-----	3.68	4.31	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
13017	21	-----	1.12	1.75	2.41	-----	3.73	-----	5.01	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	21	0.5	-----	1.76	2.4	-----	-----	4.36	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13053	21	0.48	-----	1.75	-----	3.03	3.67	4.35	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13061	21	-----	1.12	1.74	2.39	-----	3.66	-----	4.93	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	21	0.49	-----	1.75	-----	3.06	3.71	4.37	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	21	-----	1.12	1.76	2.4	-----	3.71	-----	5	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	21	-----	1.15	1.78	2.42	-----	3.71	-----	5	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	21	0.47	1.08	-----	-----	3.04	3.69	-----	5.06	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	21	-----	1.11	1.72	-----	3	-----	4.27	4.88	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14001	21	0.49	1.11	-----	2.39	-----	3.68	4.31	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14003	21	0.47	1.09	-----	-----	3.03	3.69	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	21	-----	1.17	1.85	-----	3.25	-----	4.66	5.36	--	B	B	--	B	--	C	C	53.3	20.0	36.7
14025	21	0.47	1.09	-----	-----	3.08	3.71	-----	5.09	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[4] クレアチニン　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	21	0.49	-----	1.76	2.4	-----	-----	4.34	4.99	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	21	0.44	1.06	-----	-----	2.97	3.6	-----	4.89	A	B	--	--	A	A	--	A	93.3	66.7	80.0
15001	21	0.47	-----	1.73	2.38	-----	-----	4.3	4.99	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	21	0.46	1.13	-----	2.37	-----	3.66	4.31	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	21	0.49	1.13	-----	-----	3.06	3.72	-----	4.98	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	21	0.47	-----	1.72	-----	3.04	3.7	4.31	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	21	0.51	1.16	-----	-----	3.1	3.71	-----	4.99	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
16006	21	0.49	1.13	-----	-----	3.08	3.74	-----	5.01	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
17001	21	0.49	-----	1.77	2.41	-----	-----	4.34	4.98	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
18001	21	-----	1.14	1.78	2.41	-----	3.71	-----	4.98	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	21	0.49	-----	1.74	-----	3.02	3.69	4.31	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	-----	1.12	1.74	2.38	-----	3.7	-----	4.96	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	21	0.5	1.14	-----	2.42	-----	3.7	4.34	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	21	0.49	-----	1.74	2.42	-----	-----	4.4	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	21	0.46	-----	1.71	-----	2.98	3.63	4.24	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
22004	21	0.47	1.11	-----	2.39	-----	3.71	4.37	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	21	0.48	1.13	-----	2.41	-----	3.74	4.38	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	21	0.49	1.13	-----	2.4	-----	3.7	4.34	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	21	0.48	-----	1.73	2.37	-----	-----	4.33	4.97	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22028	21	0.49	1.13	-----	2.4	-----	3.7	4.32	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	82	-----	1.12	1.75	2.4	-----	3.69	-----	4.97	--	--	--	--	--	--	--	--	=======	=======	=======
23008	21	0.47	1.13	-----	-----	3.08	3.71	-----	4.97	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23011	21	-----	1.12	1.76	-----	3.02	-----	4.27	4.91	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23015	21	-----	1.2	1.89	-----	3.25	-----	4.58	5.23	--	B	C	--	B	--	B	B	60.0	46.7	53.3
23016	21	-----	1.12	1.73	-----	3.05	-----	4.35	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	21	0.48	1.13	-----	2.41	-----	3.74	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	21	0.48	1.13	-----	-----	3.11	3.75	-----	5.09	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	21	-----	1.1	1.72	-----	2.97	-----	4.25	4.89	--	A	A	--	A	--	A	A	100	93.3	96.7
23029	21	-----	1.13	1.76	-----	3.07	-----	4.35	4.97	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23067	21	0.46	1.08	-----	2.34	-----	3.61	4.28	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
24012	21	0.48	1.09	-----	-----	2.99	3.63	-----	4.93	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	21	-----	1.12	1.75	-----	3.05	-----	4.35	4.99	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	1.13	1.75	2.37	-----	3.66	-----	4.92	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	21	-----	1.11	1.75	-----	3.05	-----	4.37	5.04	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	21	0.46	-----	1.72	2.35	-----	-----	4.31	4.95	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	21	0.49	-----	1.77	-----	3.11	3.77	4.42	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	21	0.5	1.14	-----	2.42	-----	3.7	4.35	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	21	0.45	1.08	-----	-----	3.04	3.7	-----	5.03	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27046	21	0.47	-----	1.73	2.34	-----	-----	4.27	4.9	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28002	21	-----	1.14	1.78	2.43	-----	3.69	-----	4.95	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	21	0.46	1.09	-----	-----	3.06	3.73	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	21	-----	1.16	1.8	-----	3.08	-----	4.36	5.02	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	21	0.49	-----	1.75	-----	3.05	3.7	4.34	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	21	0.48	-----	1.77	-----	3.08	3.72	4.38	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	21	0.49	1.11	-----	2.38	-----	3.65	4.32	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
28034	21	0.47	-----	1.71	2.35	-----	-----	4.27	4.93	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	21	0.49	1.13	-----	2.43	-----	3.71	4.34	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
30005	21	0.5	-----	1.8	-----	3.08	3.72	4.35	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30006	21	0.48	-----	1.75	2.41	-----	-----	4.46	5.09	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	21	0.5	1.13	-----	-----	3.07	3.77	-----	5	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
32001	21	-----	1.07	1.71	2.36	-----	3.71	-----	5.04	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[4] クレアチニン　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	21	0.48	-----	1.75	2.41	-----	-----	4.39	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	21	0.46	-----	1.72	-----	3.03	3.71	4.33	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	21	-----	1.12	1.78	2.43	-----	3.72	-----	4.95	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33008	21	0.48	-----	1.74	2.38	-----	-----	4.27	4.93	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	21	0.56	1.2	-----	-----	3.15	3.76	-----	5.08	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	60.0	73.3
34004	21	0.47	-----	1.77	2.43	-----	-----	4.37	5.02	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	21	0.49	1.13	-----	2.44	-----	3.77	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	21	0.47	-----	1.72	-----	3	3.63	4.26	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	21	0.48	1.11	-----	-----	3.11	3.75	-----	5.1	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	21	0.45	1.1	-----	-----	3.07	3.74	-----	5.05	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34015	21	0.49	-----	1.76	2.39	-----	-----	4.29	4.94	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	21	0.48	-----	1.7	-----	2.97	3.6	4.24	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
39001	21	-----	1.09	1.73	2.37	-----	3.7	-----	5	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	21	0.49	1.13	-----	-----	3.04	3.71	-----	4.97	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
39003	21	0.47	-----	1.76	-----	3.04	3.7	4.32	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	21	-----	1.14	1.74	2.38	-----	3.68	-----	4.92	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40007	21	0.51	1.15	-----	2.45	-----	3.72	4.38	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
40009	21	0.47	1.1	-----	-----	3.05	3.69	-----	4.95	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	21	0.5	-----	1.78	2.41	-----	-----	4.37	5.01	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	21	0.45	1.1	-----	2.4	-----	3.74	4.41	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
43003	21	0.47	-----	1.73	2.36	-----	-----	4.24	4.87	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
45002	21	0.46	-----	1.73	2.37	-----	-----	4.35	5	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	21	0.49	-----	1.72	2.36	-----	-----	4.24	4.89	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
47001	21	-----	1.12	1.74	-----	3.03	-----	4.31	4.98	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	21	0.48	1.14	-----	-----	3.06	3.7	-----	4.97	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	21	-----	1.13	1.76	-----	3.08	-----	4.38	5.03	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47006	21	0.49	-----	1.76	-----	3.03	3.67	4.33	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	-----	37	55	73	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	11	19	-----	55	73	-----	-----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	11	19	-----	56	74	-----	-----	128	147	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01025	11	-----	37	55	-----	91	-----	128	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	11	19	-----	55	-----	92	111	130	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	-----	34	54	-----	89	-----	123	142	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	66.7	80.0
03001	11	19	37	-----	75	-----	111	130	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	11	-----	37	56	74	-----	110	-----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	11	19	37	-----	74	-----	111	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	19	37	-----	73	-----	108	127	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	11	19	-----	55	73	-----	-----	127	144	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	11	19	37	-----	74	-----	110	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04015	11	19	-----	54	-----	90	108	125	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08001	11	20	-----	55	73	-----	-----	128	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	11	-----	37	55	72	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	11	19	37	-----	-----	90	108	-----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	11	19	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08010	11	-----	37	55	73	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	11	19	38	-----	-----	93	111	-----	149	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	11	-----	38	56	-----	94	-----	129	149	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	11	-----	37	54	73	-----	109	-----	144	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	11	18	-----	53	-----	89	107	125	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
09016	11	-----	37	55	74	-----	111	-----	148	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	11	19	38	-----	73	-----	111	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	11	-----	37	55	-----	92	-----	127	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	11	19	-----	56	-----	91	109	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	11	-----	37	55	-----	92	-----	128	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	11	19	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	11	-----	37	56	74	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	11	-----	38	56	-----	92	-----	129	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
12001	11	18	36	-----	-----	91	109	-----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	11	19	37	-----	73	-----	109	127	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	11	20	38	-----	-----	92	110	-----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	11	19	-----	55	-----	91	111	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	11	19	37	-----	-----	91	110	-----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	11	-----	37	56	-----	93	-----	129	149	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	11	-----	38	56	-----	94	-----	130	148	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	11	19	36	-----	71	-----	106	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	80.0	90.0
13017	11	-----	37	55	73	-----	110	-----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	11	18	-----	52	68	-----	-----	120	139	A	--	B	B	--	--	B	A	80.0	26.7	53.3
13053	11	19	-----	54	-----	89	107	124	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	80.0	90.0
13061	11	-----	37	56	73	-----	110	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	11	19	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	11	-----	38	56	74	-----	111	-----	148	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	11	-----	38	56	74	-----	114	-----	150	--	A	A	A	--	A	--	A	100	53.3	76.7
13103	11	19	37	-----	-----	91	109	-----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	11	-----	38	56	-----	93	-----	129	148	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14001	11	19	38	-----	72	-----	108	126	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14003	11	19	37	-----	-----	91	109	-----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	11	-----	37	54	-----	89	-----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
14025	11	19	37	-----	-----	90	109	-----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	11	19	-----	55	72	-----	-----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	11	19	37	-----	-----	91	109	-----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15001	11	20	-----	56	74	-----	-----	130	148	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	11	19	37	-----	73	-----	110	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	11	19	37	-----	-----	92	111	-----	147	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	11	19	-----	56	-----	93	111	130	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	11	19	37	-----	-----	93	110	-----	148	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16006	11	19	37	-----	-----	93	111	-----	149	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
17001	11	20	-----	56	72	-----	-----	128	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
18001	11	-----	37	54	72	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	11	19	-----	55	-----	91	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	-----	37	55	74	-----	110	-----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	11	19	37	-----	74	-----	110	127	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	11	19	-----	55	73	-----	-----	128	147	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	21	-----	57	-----	92	110	128	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	93.3	93.3
22004	11	19	37	-----	73	-----	110	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	11	19	37	-----	73	-----	108	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	19	37	-----	73	-----	110	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	11	19	-----	56	74	-----	-----	131	149	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
22028	11	19	37	-----	74	-----	110	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	11	-----	37	55	73	-----	109	-----	145	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	11	20	38	-----	-----	95	113	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	33.3	66.7
23011	11	-----	36	55	-----	92	-----	127	147	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	11	-----	35	52	-----	86	-----	119	137	--	B	B	--	B	--	B	B	66.7	20.0	43.3
23016	11	-----	37	55	-----	91	-----	127	145	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	11	18	36	-----	72	-----	108	125	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
23019	11	19	36	-----	-----	90	109	-----	145	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	11	-----	37	54	-----	91	-----	126	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	11	-----	36	54	-----	90	-----	126	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23067	11	19	37	-----	73	-----	108	126	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	11	20	38	-----	-----	93	112	-----	149	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
25003	11	-----	37	55	-----	92	-----	127	146	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	38	56	74	-----	110	-----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	11	-----	36	53	-----	89	-----	124	142	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
26006	11	19	-----	56	72	-----	-----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	11	19	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	11	19	37	-----	73	-----	109	127	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	18	35	-----	-----	86	104	-----	140	A	B	--	--	B	A	--	A	86.7	33.3	60.0
27046	11	19	-----	54	72	-----	-----	124	142	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
28002	11	-----	37	55	74	-----	110	-----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	17	34	-----	-----	87	105	-----	139	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	46.7	66.7
28011	11	-----	36	53	-----	89	-----	124	143	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
28016	11	20	-----	56	-----	93	111	129	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	19	-----	55	-----	92	109	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	11	18	36	-----	69	-----	104	122	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	93.3	33.3	63.3
28034	11	18	-----	55	73	-----	-----	126	143	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	11	18	35	-----	70	-----	106	124	-----	A	B	--	A	--	A	A	--	93.3	60.0	76.7
30005	11	18	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30006	11	20	-----	57	74	-----	-----	130	148	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
31005	11	17	35	-----	-----	87	105	-----	140	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	46.7	66.7
32001	11	-----	37	56	74	-----	111	-----	147	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値評価点	解析値評価点	総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8			
32002	11	19	-----	54	73	-----	-----	129	148	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	11	19	-----	56	-----	92	112	129	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	11	-----	36	55	73	-----	109	-----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33008	11	20	-----	56	74	-----	-----	128	146	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	11	19	37	-----	-----	92	111	-----	148	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34004	11	20	-----	56	75	-----	-----	129	147	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	11	19	37	-----	74	-----	109	128	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	11	20	-----	56	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	11	19	37	-----	-----	92	110	-----	147	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	11	17	33	-----	-----	83	99	-----	134	B	C	--	--	B	B	--	B	60.0	20.0	40.0
34015	11	19	-----	55	73	-----	-----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	11	19	-----	55	-----	92	110	128	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	11	-----	38	56	74	-----	111	-----	149	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	11	19	37	-----	-----	92	111	-----	148	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
39003	11	18	-----	55	-----	90	110	127	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	11	-----	37	55	73	-----	109	-----	146	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40007	11	19	37	-----	73	-----	110	129	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	11	18	37	-----	-----	91	109	-----	144	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	11	20	-----	56	74	-----	-----	129	147	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	11	20	39	-----	76	-----	113	131	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	60.0	80.0
43003	11	19	-----	53	69	-----	-----	120	141	A	--	A	B	--	--	B	A	86.7	20.0	53.3
45002	11	19	-----	56	74	-----	-----	129	147	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	11	19	-----	55	73	-----	-----	127	145	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47001	11	-----	36	54	-----	90	-----	126	144	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	11	19	37	-----	-----	91	109	-----	146	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	11	-----	38	56	-----	93	-----	129	149	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47006	11	19	-----	56	-----	93	112	129	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	-----	34	49	65	-----	96	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	11	19	-----	51	66	-----	-----	115	130	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	11	18	-----	49	64	-----	-----	112	125	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
01025	11	-----	34	50	-----	82	-----	113	129	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	11	19	-----	50	-----	81	97	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	-----	29	48	-----	80	-----	113	130	--	C	A	--	A	--	A	A	86.7	33.3	60.0
03001	11	18	34	-----	65	-----	96	112	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	11	-----	34	50	66	-----	97	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	11	18	33	-----	65	-----	96	113	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	18	34	-----	65	-----	96	112	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	11	19	-----	50	65	-----	-----	113	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	11	19	34	-----	66	-----	99	114	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04015	11	19	-----	49	-----	80	95	110	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08001	11	19	-----	50	66	-----	-----	113	130	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	11	-----	34	49	65	-----	98	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	11	18	33	-----	-----	80	96	-----	127	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	11	18	-----	49	-----	81	97	112	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08010	11	-----	35	50	66	-----	97	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	11	18	34	-----	-----	82	97	-----	130	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	11	-----	34	49	-----	81	-----	112	129	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	11	-----	35	50	66	-----	97	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	11	18	-----	49	-----	81	97	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	11	-----	34	50	66	-----	99	-----	131	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
10005	11	18	33	-----	65	-----	97	113	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	11	-----	34	50	-----	82	-----	113	129	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	11	19	-----	49	-----	80	95	111	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	11	-----	35	50	-----	82	-----	113	129	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	11	19	-----	51	-----	82	97	114	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	11	-----	34	50	65	-----	97	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	11	-----	36	52	-----	84	-----	117	133	--	A	A	--	A	--	A	A	100	46.7	73.3
12001	11	18	33	-----	-----	81	96	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	11	18	34	-----	66	-----	97	113	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	11	19	35	-----	-----	82	98	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	11	18	-----	51	-----	83	99	114	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
12019	11	19	34	-----	-----	81	96	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	11	-----	34	49	-----	80	-----	111	126	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	11	-----	34	49	-----	81	-----	112	128	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	11	17	32	-----	62	-----	93	108	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	60.0	76.7
13017	11	-----	33	48	64	-----	95	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	11	18	-----	49	65	-----	-----	112	129	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13053	11	18	-----	48	-----	79	95	110	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13061	11	-----	34	49	65	-----	96	-----	127	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	11	19	-----	50	-----	82	97	112	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	11	-----	34	50	65	-----	97	-----	127	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	11	-----	34	49	65	-----	97	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	11	19	34	-----	-----	80	95	-----	126	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	11	-----	35	50	-----	82	-----	114	130	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14001	11	19	35	-----	65	-----	97	115	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
14003	11	19	34	-----	-----	80	95	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	11	-----	34	49	-----	80	-----	110	126	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14025	11	19	34	-----	-----	79	95	-----	126	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	11	19	-----	50	66	-----	-----	113	129	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	11	19	34	-----	-----	81	99	-----	131	A	A	--	--	A	A	--	A	100	80.0	90.0
15001	11	18	-----	49	65	-----	-----	112	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	11	18	34	-----	65	-----	96	112	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	11	19	34	-----	-----	81	98	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	11	19	-----	50	-----	82	98	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	11	18	35	-----	-----	85	101	-----	134	A	A	--	--	A	A	--	A	100	26.7	63.3
16006	11	18	33	-----	-----	79	96	-----	126	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
17001	11	19	-----	51	68	-----	-----	115	132	A	--	A	A	--	--	A	A	100	66.7	83.3
18001	11	-----	34	50	65	-----	97	-----	126	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	11	18	-----	49	-----	82	97	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	-----	34	49	65	-----	97	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	11	18	34	-----	66	-----	98	115	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
22002	11	18	-----	49	66	-----	-----	112	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	18	-----	49	-----	81	94	111	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7
22004	11	18	34	-----	65	-----	96	112	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	11	18	33	-----	64	-----	95	110	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	18	34	-----	67	-----	99	114	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
22017	11	18	-----	50	66	-----	-----	114	131	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
22028	11	18	34	-----	67	-----	99	115	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
23003	11	-----	34	49	65	-----	97	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	11	19	35	-----	-----	82	98	-----	130	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23011	11	-----	33	48	-----	80	-----	111	126	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	11	-----	32	45	-----	75	-----	108	122	--	A	B	--	B	--	A	A	86.7	46.7	66.7
23016	11	-----	34	49	-----	81	-----	112	128	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	11	19	34	-----	66	-----	95	112	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	11	18	34	-----	-----	81	97	-----	129	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	11	-----	35	50	-----	82	-----	113	128	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	11	-----	33	48	-----	81	-----	112	125	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23067	11	19	35	-----	66	-----	98	113	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	11	17	33	-----	-----	80	97	-----	128	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100	96.7
25003	11	-----	34	49	-----	81	-----	113	128	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	35	51	67	-----	99	-----	131	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
26003	11	-----	33	48	-----	79	-----	109	124	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
26006	11	19	-----	50	65	-----	-----	112	129	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	11	19	-----	51	-----	82	97	114	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	11	18	34	-----	66	-----	98	114	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	17	33	-----	-----	80	96	-----	127	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100	96.7
27046	11	18	-----	49	64	-----	-----	110	127	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28002	11	-----	35	51	67	-----	99	-----	131	--	A	A	A	--	A	--	A	100	93.3	96.7
28003	11	17	32	-----	-----	77	93	-----	122	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	46.7	70.0
28011	11	-----	34	49	-----	81	-----	111	126	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	11	19	-----	49	-----	80	95	110	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	18	-----	49	-----	81	96	112	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	11	17	32	-----	63	-----	93	110	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	66.7	80.0
28034	11	17	-----	46	62	-----	-----	106	122	B	--	B	A	--	--	A	A	86.7	33.3	60.0
30004	11	17	32	-----	62	-----	94	110	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	66.7	80.0
30005	11	18	-----	51	-----	81	98	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30006	11	19	-----	50	66	-----	-----	112	129	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	11	17	33	-----	-----	79	95	-----	126	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	93.3	93.3
32001	11	-----	34	50	66	-----	96	-----	129	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	11	18	-----	49	64	-----	-----	111	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	11	18	-----	49	-----	81	96	112	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	11	-----	33	49	64	-----	95	-----	124	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
33008	11	19	-----	51	66	-----	-----	113	131	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	11	17	32	-----	-----	75	91	-----	122	B	A	--	--	B	A	--	A	86.7	33.3	60.0
34004	11	19	-----	50	66	-----	-----	112	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	11	18	33	-----	64	-----	94	110	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	11	19	-----	51	-----	82	97	111	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	11	19	35	-----	-----	82	98	-----	130	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	11	16	30	-----	-----	73	87	-----	117	C	B	--	--	B	B	--	B	60.0	20.0	40.0
34015	11	19	-----	51	66	-----	-----	115	130	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	11	19	-----	50	-----	82	98	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	11	-----	33	50	65	-----	96	-----	128	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	11	19	35	-----	-----	82	96	-----	128	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
39003	11	18	-----	50	-----	81	98	113	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	11	-----	34	50	65	-----	97	-----	130	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
40007	11	18	34	-----	65	-----	97	113	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	11	18	34	-----	-----	82	96	-----	129	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	11	18	-----	50	65	-----	-----	112	127	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	11	19	34	-----	66	-----	97	114	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
43003	11	17	-----	45	59	-----	-----	103	117	B	--	B	B	--	--	B	B	66.7	20.0	43.3
45002	11	18	-----	49	65	-----	-----	111	128	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	11	19	-----	50	66	-----	-----	113	129	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
47001	11	-----	35	50	-----	82	-----	112	130	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	11	18	34	-----	-----	82	98	-----	131	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
47005	11	-----	34	50	-----	82	-----	114	130	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47006	11	19	-----	52	-----	83	99	114	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	11	-----	48	66	84	-----	120	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
01013	11	29	-----	66	84	-----	-----	138	157	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	11	31	-----	68	87	-----	-----	143	161	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
01025	11	-----	48	66	-----	102	-----	137	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
01040	11	30	-----	66	-----	102	120	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
02004	11	-----	49	67	-----	104	-----	141	160	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
03001	11	30	49	-----	85	-----	120	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
03006	11	-----	49	67	86	-----	123	-----	160	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	11	30	49	-----	84	-----	121	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	11	31	49	-----	86	-----	124	141	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04009	11	31	-----	68	86	-----	-----	142	161	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
04012	11	29	48	-----	85	-----	120	138	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04015	11	30	-----	65	-----	101	119	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08001	11	30	-----	68	86	-----	-----	142	160	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
08003	11	-----	49	67	85	-----	122	-----	159	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	11	30	48	-----	-----	102	121	-----	157	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	11	30	-----	67	-----	103	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08010	11	-----	47	65	83	-----	118	-----	152	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
09001	11	30	49	-----	-----	103	122	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	11	-----	47	65	-----	101	-----	137	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	11	-----	47	65	83	-----	119	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	11	29	-----	65	-----	100	118	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	11	-----	49	68	86	-----	122	-----	160	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
10005	11	30	48	-----	84	-----	120	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	11	-----	47	65	-----	101	-----	138	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	11	30	-----	68	-----	104	123	141	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	11	-----	48	66	-----	103	-----	138	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	11	29	-----	65	-----	102	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	11	-----	50	68	86	-----	123	-----	161	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
11033	11	-----	49	67	-----	102	-----	141	160	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
12001	11	31	49	-----	-----	103	121	-----	156	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	11	29	47	-----	84	-----	120	138	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	11	29	48	-----	-----	102	120	-----	156	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12016	11	31	-----	67	-----	103	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	11	29	47	-----	-----	102	118	-----	155	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	11	-----	48	66	-----	105	-----	141	159	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	11	-----	48	66	-----	103	-----	138	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	11	29	47	-----	82	-----	117	134	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	73.3	86.7
13017	11	-----	49	66	84	-----	121	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	11	28	-----	64	81	-----	-----	136	155	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	80.0	86.7
13053	11	29	-----	65	-----	101	118	136	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13061	11	-----	48	65	83	-----	120	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	11	29	-----	65	-----	102	120	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	11	-----	48	66	84	-----	119	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	11	-----	49	67	85	-----	122	-----	158	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13103	11	30	49	-----	-----	105	123	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	93.3	96.7
13145	11	-----	50	69	-----	107	-----	145	164	--	A	A	--	A	--	A	A	100	33.3	66.7
14001	11	31	50	-----	87	-----	124	142	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	86.7	93.3
14003	11	31	49	-----	-----	106	123	-----	160	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	11	-----	46	65	-----	100	-----	135	154	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
14025	11	31	49	-----	-----	105	124	-----	160	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	11	31	-----	68	86	-----	-----	142	160	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	11	29	48	-----	-----	103	120	-----	157	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15001	11	31	-----	68	86	-----	-----	142	160	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	11	30	49	-----	84	-----	121	138	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	11	31	50	-----	-----	105	125	-----	161	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
15012	11	31	-----	68	-----	104	124	141	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	11	31	49	-----	-----	104	121	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16006	11	30	49	-----	-----	104	122	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
17001	11	30	-----	67	85	-----	-----	140	158	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
18001	11	-----	49	67	85	-----	121	-----	158	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	11	30	-----	66	-----	102	121	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	11	-----	48	66	84	-----	121	-----	158	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	11	30	47	-----	84	-----	120	137	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	11	29	-----	65	83	-----	-----	138	158	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22003	11	30	-----	67	-----	103	122	140	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22004	11	31	48	-----	85	-----	121	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	11	30	48	-----	84	-----	121	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	11	30	48	-----	84	-----	120	137	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	11	30	-----	67	84	-----	-----	139	157	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22028	11	31	49	-----	86	-----	123	141	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	11	-----	48	66	83	-----	120	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	11	30	49	-----	-----	105	123	-----	159	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23011	11	-----	47	65	-----	100	-----	135	153	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23015	11	-----	48	66	-----	103	-----	139	157	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23016	11	-----	48	65	-----	102	-----	138	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	11	29	48	-----	84	-----	120	137	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	11	30	48	-----	-----	103	120	-----	156	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	11	-----	47	65	-----	100	-----	135	154	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	11	-----	47	65	-----	101	-----	137	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23067	11	30	49	-----	85	-----	121	139	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	11	31	49	-----	-----	104	122	-----	159	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	11	-----	48	66	-----	102	-----	138	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	11	-----	47	65	83	-----	119	-----	155	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	11	-----	47	66	-----	103	-----	139	157	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	11	29	-----	65	84	-----	-----	137	155	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
27014	11	29	-----	65	-----	103	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	11	30	48	-----	84	-----	120	138	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	11	30	48	-----	-----	103	120	-----	157	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27046	11	28	-----	64	81	-----	-----	134	152	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	53.3	73.3
28002	11	-----	48	66	84	-----	120	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	11	30	48	-----	-----	102	120	-----	157	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	11	-----	48	66	-----	103	-----	139	156	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
28016	11	30	-----	66	-----	103	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	11	30	-----	66	-----	102	121	138	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	11	29	48	-----	84	-----	120	138	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
28034	11	30	-----	66	85	-----	-----	139	156	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
30004	11	30	48	-----	84	-----	122	140	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
30005	11	28	-----	64	-----	100	118	136	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	93.3	86.7	90.0
30006	11	31	-----	68	87	-----	-----	143	162	A	--	A	A	--	--	A	A	100	73.3	86.7
31005	11	29	46	-----	-----	100	118	-----	153	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
32001	11	-----	49	67	85	-----	122	-----	158	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	11	30	-----	66	84	-----	-----	139	157	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33001	11	30	-----	66	-----	103	122	140	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	11	-----	48	66	85	-----	121	-----	156	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33008	11	28	-----	66	83	-----	-----	137	155	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	100	96.7
33009	11	31	50	-----	-----	105	123	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34004	11	31	-----	66	85	-----	-----	139	156	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	11	30	49	-----	85	-----	123	141	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
34010	11	29	-----	65	-----	102	120	140	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	11	30	48	-----	-----	104	121	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	11	30	49	-----	-----	103	121	-----	158	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34015	11	30	-----	66	84	-----	-----	137	155	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	11	30	-----	66	-----	102	119	137	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	11	-----	49	67	86	-----	124	-----	159	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	11	32	51	-----	-----	106	124	-----	161	B	B	--	--	A	A	--	A	86.7	66.7	76.7
39003	11	30	-----	65	-----	102	120	137	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	11	-----	47	64	81	-----	118	-----	153	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
40007	11	30	49	-----	86	-----	122	140	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	11	30	48	-----	-----	103	121	-----	156	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
40027	11	30	-----	66	85	-----	-----	139	157	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	11	31	48	-----	85	-----	122	140	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
43003	11	29	-----	64	83	-----	-----	135	153	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
45002	11	30	-----	66	85	-----	-----	138	156	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
46004	11	32	-----	67	86	-----	-----	141	160	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	93.3	93.3
47001	11	-----	47	65	-----	101	-----	137	155	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	11	30	48	-----	-----	102	121	-----	157	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	11	-----	49	67	-----	104	-----	139	159	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47006	11	31	-----	67	-----	103	121	139	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100

[8] 血糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
01001	21	-----	90	110	128	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
01013	12	71	-----	109	128	-----	-----	185	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01018	21	72	-----	110	129	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
01025	21	-----	90	109	-----	146	-----	183	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	66.7	83.3
01040	21	71	-----	108	-----	146	165	183	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	73.3	86.7
02004	21	-----	89	107	-----	145	-----	181	200	--	A	B	--	A	--	B	B	80.0	20.0	50.0
03001	21	72	91	-----	129	-----	165	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	80.0	90.0
03006	21	-----	91	110	129	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
04004	21	72	91	-----	130	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
04008	12	71	91	-----	129	-----	166	184	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	93.3	96.7
04009	12	72	-----	110	129	-----	-----	186	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
04012	21	73	92	-----	132	-----	171	191	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	80.0	26.7	53.3
04015	12	72	-----	110	-----	149	169	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	86.7	93.3
08001	21	73	-----	112	131	-----	-----	188	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
08003	21	-----	90	108	127	-----	165	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
08006	21	72	91	-----	-----	148	167	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
08009	21	72	-----	110	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
08010	21	-----	91	110	129	-----	167	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09001	21	72	91	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
09005	12	-----	90	109	-----	147	-----	185	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
09012	21	-----	90	109	129	-----	166	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
09013	21	72	-----	110	-----	149	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
09016	21	-----	91	111	130	-----	168	-----	209	--	A	A	A	--	A	--	A	100	73.3	86.7
10005	12	72	92	-----	130	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
10007	12	-----	90	110	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11006	21	72	-----	110	-----	149	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11010	21	-----	91	110	-----	148	-----	186	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
11020	21	71	-----	109	-----	146	166	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
11023	12	-----	90	109	128	-----	169	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	80.0	90.0
11033	21	-----	94	112	-----	152	-----	190	210	--	B	A	--	B	--	A	B	80.0	60.0	70.0
12001	21	72	91	-----	-----	149	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
12002	12	72	91	-----	129	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
12008	21	71	91	-----	-----	146	163	-----	204	A	A	--	--	A	B	--	A	93.3	66.7	80.0
12016	21	72	-----	110	-----	149	169	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
12019	21	71	90	-----	-----	147	167	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13002	12	-----	91	110	-----	149	-----	188	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13003	21	-----	91	109	-----	147	-----	185	205	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
13016	21	73	93	-----	129	-----	169	187	-----	A	B	--	A	--	A	A	--	93.3	86.7	90.0
13017	21	-----	91	110	129	-----	167	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13026	12	71	-----	109	128	-----	-----	184	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
13053	12	71	-----	109	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13061	21	-----	92	111	129	-----	168	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13064	21	72	-----	110	-----	147	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
13074	21	-----	92	111	130	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
13084	12	-----	92	112	132	-----	170	-----	210	--	A	A	B	--	A	--	B	86.7	46.7	66.7
13103	21	72	90	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
13145	21	-----	93	112	-----	151	-----	189	208	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	73.3	83.3
14001	21	72	92	-----	130	-----	169	188	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
14003	12	71	90	-----	-----	148	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
14010	21	-----	93	111	-----	150	-----	188	206	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	100	96.7
14025	21	72	91	-----	-----	149	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100

[8] 血糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
14030	21	72	-----	111	129	-----	-----	187	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
14046	21	73	92	-----	-----	151	170	-----	210	A	A	--	--	A	A	--	B	93.3	53.3	73.3
15001	21	73	-----	111	130	-----	-----	188	206	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
15006	21	72	91	-----	129	-----	168	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
15011	21	72	91	-----	-----	148	167	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
15012	21	73	-----	110	-----	149	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
16002	21	71	91	-----	-----	147	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
16006	21	71	89	-----	-----	146	166	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
17001	12	72	-----	110	130	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
18001	21	-----	91	110	128	-----	167	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21002	12	72	-----	110	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
21005	21	-----	91	110	129	-----	167	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
21006	21	72	91	-----	129	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22002	21	71	-----	108	127	-----	-----	182	202	A	--	A	A	--	--	A	A	100	66.7	83.3
22003	21	72	-----	110	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
22004	21	72	91	-----	130	-----	169	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22006	21	72	91	-----	129	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22012	21	72	91	-----	129	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
22017	21	72	-----	110	129	-----	-----	187	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
22028	21	72	90	-----	129	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23003	21	-----	91	109	128	-----	165	-----	204	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
23008	21	72	91	-----	-----	150	169	-----	207	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23011	21	-----	90	109	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23015	12	-----	88	108	-----	145	-----	182	202	--	B	A	--	A	--	A	A	93.3	73.3	83.3
23016	21	-----	90	109	-----	148	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23017	21	72	91	-----	129	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
23019	21	72	91	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
23024	21	-----	92	111	-----	150	-----	188	208	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
23029	21	-----	89	108	-----	146	-----	183	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	86.7	93.3
23067	21	72	90	-----	128	-----	166	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
24012	21	72	91	-----	-----	149	168	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
25003	21	-----	90	109	-----	147	-----	185	204	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26001	21	-----	92	111	130	-----	168	-----	207	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
26003	21	-----	91	110	-----	149	-----	186	207	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
26006	21	72	-----	111	130	-----	-----	186	209	A	--	A	A	--	--	A	A	100	80.0	90.0
27014	21	72	-----	110	-----	148	167	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
27020	21	72	91	-----	129	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
27044	31	71	90	-----	-----	147	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
27046	12	73	-----	111	130	-----	-----	188	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
28002	12	-----	91	109	129	-----	168	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
28003	12	72	91	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
28011	21	-----	90	108	-----	146	-----	184	202	--	A	A	--	A	--	A	A	100	80.0	90.0
28016	21	72	-----	110	-----	149	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28017	21	72	-----	109	-----	147	166	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
28031	12	74	94	-----	132	-----	172	189	-----	B	B	--	B	--	B	A	--	73.3	53.3	63.3
28034	21	73	-----	112	131	-----	-----	189	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	86.7	93.3
30004	21	71	91	-----	129	-----	168	187	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
30005	21	71	-----	109	-----	148	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
30006	12	72	-----	110	129	-----	-----	186	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
31005	21	71	89	-----	-----	146	164	-----	203	A	A	--	--	A	A	--	A	100	86.7	93.3
32001	21	-----	91	110	129	-----	168	-----	206	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100

[8] 血糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								測定値	解析値	総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点	評価点	評価点
32002	21	74	-----	111	131	-----	-----	186	208	B	--	A	A	--	--	A	A	93.3	73.3	83.3
33001	12	72	-----	110	-----	149	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
33005	12	-----	89	108	128	-----	166	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
33008	21	72	-----	110	130	-----	-----	187	207	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
33009	21	75	95	-----	-----	154	173	-----	212	B	C	--	--	B	B	--	B	60.0	33.3	46.7
34004	21	72	-----	110	129	-----	-----	185	205	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
34009	12	70	90	-----	130	-----	169	188	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	93.3	60.0	76.7
34010	21	72	-----	110	-----	148	168	187	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
34011	21	72	91	-----	-----	149	167	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34012	21	71	90	-----	-----	148	167	-----	205	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
34015	21	72	-----	109	128	-----	-----	185	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
35001	21	71	-----	109	-----	148	167	185	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39001	21	-----	91	110	129	-----	167	-----	205	--	A	A	A	--	A	--	A	100	100	100
39002	21	73	92	-----	-----	150	168	-----	206	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
39003	21	72	-----	110	-----	149	168	186	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	100	100
39004	21	-----	91	109	128	-----	167	-----	203	--	A	A	A	--	A	--	A	100	86.7	93.3
40007	21	72	91	-----	130	-----	167	185	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
40009	12	70	89	-----	-----	148	166	-----	204	B	A	--	--	A	A	--	A	93.3	100	96.7
40027	21	72	-----	110	129	-----	-----	185	204	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
43001	21	72	90	-----	129	-----	167	186	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100	100	100
43003	21	71	-----	109	128	-----	-----	185	203	A	--	A	A	--	--	A	A	100	100	100
45002	21	73	-----	112	130	-----	-----	187	208	A	--	A	A	--	--	A	A	100	93.3	96.7
46004	21	70	-----	108	128	-----	-----	184	200	B	--	A	A	--	--	A	B	86.7	46.7	66.7
47001	21	-----	92	111	-----	150	-----	187	206	--	A	A	--	A	--	A	A	100	100	100
47004	12	71	89	-----	-----	147	166	-----	204	A	A	--	--	A	A	--	A	100	100	100
47005	21	-----	90	108	-----	145	-----	182	201	--	A	A	--	A	--	A	A	100	33.3	66.7
47006	21	72	-----	111	-----	148	168	188	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100	93.3	96.7

[9] ＨＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
01001	01-0403	33	-----	49	77	-----	A	--	A	--	--	100
01013	01-1201	-----	53	55	-----	55	--	A	A	--	--	100
01018	01-1201	38	-----	58	81	-----	A	--	B	--	--	92.9
01025	01-0403	34	46	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
01040	01-0403	-----	47	49	-----	55	--	A	A	--	--	100
02004	01-0403	-----	45	47	75	-----	--	B	B	--	--	78.6
03001	01-0403	35	-----	49	-----	55	B	--	A	--	--	85.7
03006	01-1201	37	-----	56	80	-----	A	--	A	--	--	100
04004	01-0403	33	47	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
04008	01-1201	38	53	-----	81	-----	A	A	--	--	--	100
04009	01-1201	38	-----	56	-----	57	A	--	A	--	--	100
04012	01-0403	34	-----	49	77	-----	A	--	A	--	--	100
04015	01-0403	34	-----	49	-----	55	A	--	A	--	--	100
08001	01-1201	37	-----	55	78	-----	A	--	A	--	--	100
08003	01-1201	38	-----	58	80	-----	A	--	B	--	--	92.9
08006	01-1201	37	53	-----	80	-----	A	A	--	--	--	100
08009	01-0403	-----	46	48	-----	55	--	A	A	--	--	100
08010	01-1201	37	53	-----	79	-----	A	A	--	--	--	100
09001	01-0403	34	47	-----	77	-----	A	A	--	--	--	100
09005	01-0403	-----	47	50	79	-----	--	A	B	--	--	92.9
09012	01-1201	37	-----	55	-----	56	A	--	A	--	--	100
09013	01-0403	33	-----	48	75	-----	A	--	A	--	--	100
09016	01-1201	38	54	-----	82	-----	A	A	--	--	--	100
10005	01-0403	-----	46	49	77	-----	--	A	A	--	--	100
10007	01-0403	33	46	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
11006	01-1201	37	-----	56	79	-----	A	--	A	--	--	100
11010	01-0403	33	-----	49	76	-----	A	--	A	--	--	100
11020	01-1201	38	-----	56	-----	57	A	--	A	--	--	100
11023	01-1201	37	-----	56	-----	56	A	--	A	--	--	100
11033	01-1201	37	53	-----	78	-----	A	A	--	--	--	100
12001	01-1201	37	-----	57	-----	57	A	--	A	--	--	100
12002	01-1201	37	54	-----	80	-----	A	A	--	--	--	100
12008	01-0403	33	46	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
12016	01-0403	34	-----	49	-----	56	A	--	A	--	--	100
12019	01-0403	-----	46	48	-----	53	--	A	A	--	--	100
13002	01-0403	34	48	-----	-----	55	A	B	--	--	--	85.7
13003	01-1201	-----	55	57	-----	56	--	B	A	--	--	92.9
13016	01-1201	38	54	-----	-----	56	A	A	--	--	--	100
13017	01-0403	34	-----	50	-----	56	A	--	B	--	--	92.9
13026	01-1201	-----	53	57	79	-----	--	A	A	--	--	100
13053	01-0403	34	46	-----	75	-----	A	A	--	--	--	100
13061	01-1201	37	53	-----	80	-----	A	A	--	--	--	100
13064	01-1201	37	53	-----	-----	57	A	A	--	--	--	100
13074	01-1201	37	-----	56	81	-----	A	--	A	--	--	100
13084	01-0403	34	47	-----	77	-----	A	A	--	--	--	100
13103	01-1201	-----	53	56	80	-----	--	A	A	--	--	100
13145	01-1201	37	-----	57	-----	56	A	--	A	--	--	100
14001	01-1201	-----	55	58	80	-----	--	B	B	--	--	85.7
14003	01-1201	38	-----	56	81	-----	A	--	A	--	--	100
14010	01-0403	-----	47	49	77	-----	--	A	A	--	--	100
14025	01-1201	37	53	-----	-----	56	A	A	--	--	--	100

[9] ＨＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
14030	01-1201	37	53	-----	81	-----	A	A	--	--	--	100
14046	01-0403	-----	47	48	77	-----	--	A	A	--	--	100
15001	01-1201	37	-----	57	-----	56	A	--	A	--	--	100
15006	01-1201	37	53	-----	80	-----	A	A	--	--	--	100
15011	01-1201	-----	53	56	79	-----	--	A	A	--	--	100
15012	01-1201	-----	53	55	77	-----	--	A	A	--	--	100
16002	01-1201	-----	53	56	78	-----	--	A	A	--	--	100
16006	01-1201	37	54	-----	80	-----	A	A	--	--	--	100
17001	01-0403	34	-----	48	76	-----	A	--	A	--	--	100
18001	01-0403	33	-----	48	75	-----	A	--	A	--	--	100
21002	01-0403	-----	46	49	76	-----	--	A	A	--	--	100
21005	01-0403	-----	46	49	-----	55	--	A	A	--	--	100
21006	01-0403	33	46	-----	-----	54	A	A	--	--	--	100
22002	01-0403	34	-----	49	-----	54	A	--	A	--	--	100
22003	01-1201	-----	53	57	79	-----	--	A	A	--	--	100
22004	01-2304	32	-----	50	-----	51	--	--	--	--	--	=======
22006	01-1201	37	-----	56	77	-----	A	--	A	--	--	100
22012	01-0403	33	46	-----	77	-----	A	A	--	--	--	100
22017	01-0403	-----	46	48	-----	54	--	A	A	--	--	100
22028	01-0403	34	-----	49	77	-----	A	--	A	--	--	100
23003	01-2304	-----	47	51	-----	51	--	--	--	--	--	=======
23008	01-0403	34	47	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
23011	01-1201	36	53	-----	81	-----	B	A	--	--	--	85.7
23015	01-0403	33	46	-----	-----	53	A	A	--	--	--	100
23016	01-0403	-----	46	49	76	-----	--	A	A	--	--	100
23017	01-0403	-----	46	48	75	-----	--	A	A	--	--	100
23019	01-0403	34	-----	48	76	-----	A	--	A	--	--	100
23024	01-1201	-----	52	55	79	-----	--	A	A	--	--	100
23029	01-0403	33	46	-----	-----	54	A	A	--	--	--	100
23067	01-0403	34	-----	49	78	-----	A	--	A	--	--	100
24012	01-0403	34	-----	49	-----	54	A	--	A	--	--	100
25003	01-0403	33	46	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
26001	01-1201	-----	53	56	80	-----	--	A	A	--	--	100
26003	01-1201	-----	54	56	-----	57	--	A	A	--	--	100
26006	01-0403	34	46	-----	78	-----	A	A	--	--	--	100
27014	01-1201	36	-----	55	79	-----	B	--	A	--	--	85.7
27020	01-0403	-----	46	48	77	-----	--	A	A	--	--	100
27044	01-0403	-----	46	48	75	-----	--	A	A	--	--	100
27046	01-1201	37	53	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100
28002	01-1201	38	-----	58	81	-----	A	--	B	--	--	92.9
28003	01-0403	34	47	-----	75	-----	A	A	--	--	--	100
28011	01-0403	-----	45	47	76	-----	--	B	B	--	--	78.6
28016	01-0403	34	46	-----	-----	56	A	A	--	--	--	100
28017	01-0403	-----	46	49	-----	55	--	A	A	--	--	100
28031	01-1201	37	53	-----	81	-----	A	A	--	--	--	100
28034	01-0403	-----	47	49	77	-----	--	A	A	--	--	100
30004	01-0403	34	47	-----	-----	55	A	A	--	--	--	100
30005	01-0403	35	-----	49	79	-----	B	--	A	--	--	85.7
30006	01-1201	38	53	-----	81	-----	A	A	--	--	--	100
31005	01-0403	34	47	-----	76	-----	A	A	--	--	--	100
32001	01-0403	33	46	-----	-----	54	A	A	--	--	--	100

[9] ＨＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
32002	01-0403	34	-----	48	77	-----	A	--	A	--	--	100
33001	01-0403	34	-----	50	-----	57	A	--	B	--	--	92.9
33005	01-0403	-----	45	48	76	-----	--	B	A	--	--	92.9
33008	01-1201	38	55	-----	-----	58	A	B	--	--	--	92.9
33009	01-0403	34	45	-----	-----	53	A	B	--	--	--	92.9
34004	01-0403	34	-----	49	77	-----	A	--	A	--	--	100
34009	01-1201	39	54	-----	79	-----	B	A	--	--	--	85.7
34010	01-1201	37	54	-----	79	-----	A	A	--	--	--	100
34011	01-1201	-----	53	56	81	-----	--	A	A	--	--	100
34012	01-1201	38	-----	57	-----	57	A	--	A	--	--	100
34015	01-0403	-----	46	48	-----	55	--	A	A	--	--	100
35001	01-0403	33	46	-----	76	-----	A	A	--	--	--	100
39001	01-0403	-----	44	46	-----	53	--	B	C	--	--	50.0
39002	01-0403	35	-----	49	76	-----	B	--	A	--	--	85.7
39003	01-0403	-----	46	48	76	-----	--	A	A	--	--	100
39004	01-1201	38	-----	56	-----	57	A	--	A	--	--	100
40007	01-2304	-----	47	50	-----	51	--	--	--	--	--	======
40009	01-1201	37	53	-----	-----	57	A	A	--	--	--	100
40027	01-0403	35	47	-----	76	-----	B	A	--	--	--	85.7
43001	01-1201	37	-----	57	79	-----	A	--	A	--	--	100
43003	01-0403	35	-----	49	-----	54	B	--	A	--	--	85.7
45002	01-0403	33	-----	47	75	-----	A	--	B	--	--	85.7
46004	01-0403	34	-----	48	75	-----	A	--	A	--	--	100
47001	01-1201	37	54	-----	79	-----	A	A	--	--	--	100
47004	01-1201	37	-----	56	-----	57	A	--	A	--	--	100
47005	01-0403	35	-----	49	-----	55	B	--	A	--	--	85.7
47006	01-1201	37	-----	56	-----	56	A	--	A	--	--	100

[10] ＬＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
01001	01-0403	71	-----	133	87	-----	A	--	A	--	--	100
01013	01-1201	-----	103	137	-----	168	--	B	A	--	--	78.6
01018	01-1201	77	-----	142	93	-----	A	--	A	--	--	100
01025	01-0403	72	100	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
01040	01-0403	-----	100	133	-----	171	--	A	A	--	--	100
02004	01-0403	-----	99	130	87	-----	--	A	A	--	--	100
03001	01-0403	71	-----	133	-----	170	A	--	A	--	--	100
03006	01-1201	76	-----	142	92	-----	A	--	A	--	--	100
04004	01-0403	71	102	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
04008	01-1201	77	109	-----	92	-----	A	A	--	--	--	100
04009	01-1201	77	-----	142	-----	179	A	--	A	--	--	100
04012	01-0403	71	-----	132	88	-----	A	--	A	--	--	100
04015	01-0403	71	-----	133	-----	171	A	--	A	--	--	100
08001	01-1201	74	-----	137	87	-----	B	--	A	--	--	92.9
08003	01-1201	77	-----	143	91	-----	A	--	A	--	--	100
08006	01-1201	76	108	-----	91	-----	A	A	--	--	--	100
08009	01-0403	-----	100	133	-----	170	--	A	A	--	--	100
08010	01-1201	76	108	-----	91	-----	A	A	--	--	--	100
09001	01-0403	70	100	-----	87	-----	A	A	--	--	--	100
09005	01-0403	-----	100	132	87	-----	--	A	A	--	--	100
09012	01-1201	76	-----	139	-----	177	A	--	A	--	--	100
09013	01-0403	69	-----	132	86	-----	A	--	A	--	--	100
09016	01-1201	76	109	-----	90	-----	A	A	--	--	--	100
10005	01-0403	-----	100	133	87	-----	--	A	A	--	--	100
10007	01-0403	72	103	-----	-----	176	A	A	--	--	--	100
11006	01-1201	77	-----	143	92	-----	A	--	A	--	--	100
11010	01-0403	72	-----	133	88	-----	A	--	A	--	--	100
11020	01-1201	76	-----	142	-----	177	A	--	A	--	--	100
11023	01-1201	77	-----	142	-----	179	A	--	A	--	--	100
11033	01-1201	77	110	-----	91	-----	A	A	--	--	--	100
12001	01-1201	76	-----	141	-----	177	A	--	A	--	--	100
12002	01-1201	76	111	-----	90	-----	A	A	--	--	--	100
12008	01-0403	72	102	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
12016	01-0403	71	-----	132	-----	172	A	--	A	--	--	100
12019	01-0403	-----	101	134	-----	167	--	A	A	--	--	100
13002	01-0403	73	104	-----	-----	173	A	B	--	--	--	92.9
13003	01-1201	-----	113	143	-----	179	--	A	A	--	--	100
13016	01-1201	77	110	-----	-----	174	A	A	--	--	--	100
13017	01-0403	72	-----	135	-----	170	A	--	A	--	--	100
13026	01-1201	-----	110	143	88	-----	--	A	A	--	--	100
13053	01-0403	71	100	-----	87	-----	A	A	--	--	--	100
13061	01-1201	78	110	-----	92	-----	A	A	--	--	--	100
13064	01-1201	76	108	-----	-----	176	A	A	--	--	--	100
13074	01-1201	78	-----	144	92	-----	A	--	A	--	--	100
13084	01-0403	72	104	-----	90	-----	A	B	--	--	--	92.9
13103	01-1201	-----	109	142	92	-----	--	A	A	--	--	100
13145	01-1201	72	-----	132	-----	165	B	--	B	--	--	57.1
14001	01-1201	-----	110	141	90	-----	--	A	A	--	--	100
14003	01-1201	77	-----	142	92	-----	A	--	A	--	--	100
14010	01-0403	-----	100	134	88	-----	--	A	A	--	--	100
14025	01-1201	77	110	-----	-----	177	A	A	--	--	--	100

[10] ＬＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
14030	01-1201	74	107	-----	90	-----	B	A	--	--	--	92.9
14046	01-0403	-----	99	129	87	-----	--	A	A	--	--	100
15001	01-2302	87	-----	157	-----	186	--	--	--	--	--	=======
15006	01-1201	78	112	-----	91	-----	A	A	--	--	--	100
15011	01-2302	-----	123	157	94	-----	--	--	--	--	--	=======
15012	01-2302	-----	124	158	96	-----	--	--	--	--	--	=======
16002	01-1201	-----	109	141	90	-----	--	A	A	--	--	100
16006	01-1201	76	109	-----	90	-----	A	A	--	--	--	100
17001	01-0403	71	-----	132	87	-----	A	--	A	--	--	100
18001	01-0403	71	-----	135	87	-----	A	--	A	--	--	100
21002	01-0403	-----	100	132	88	-----	--	A	A	--	--	100
21005	01-0403	-----	101	132	-----	171	--	A	A	--	--	100
21006	01-0403	70	101	-----	-----	169	A	A	--	--	--	100
22002	01-0403	69	-----	131	-----	165	A	--	A	--	--	100
22003	01-1201	-----	107	140	90	-----	--	A	A	--	--	100
22004	01-0403	70	-----	128	-----	166	A	--	B	--	--	92.9
22006	01-1201	76	-----	142	91	-----	A	--	A	--	--	100
22012	01-0403	72	101	-----	88	-----	A	A	--	--	--	100
22017	01-0403	-----	98	129	-----	165	--	A	A	--	--	100
22028	01-0403	71	-----	132	87	-----	A	--	A	--	--	100
23003	01-2302	-----	124	157	-----	188	--	--	--	--	--	=======
23008	01-0403	71	101	-----	-----	169	A	A	--	--	--	100
23011	01-1201	77	111	-----	90	-----	A	A	--	--	--	100
23015	01-0403	69	99	-----	-----	164	A	A	--	--	--	100
23016	01-0403	-----	101	133	88	-----	--	A	A	--	--	100
23017	01-0403	-----	100	131	87	-----	--	A	A	--	--	100
23019	01-0403	71	-----	134	87	-----	A	--	A	--	--	100
23024	01-1201	-----	110	141	92	-----	--	A	A	--	--	100
23029	01-0403	71	101	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
23067	01-0403	70	-----	131	87	-----	A	--	A	--	--	100
24012	01-0403	70	-----	133	-----	168	A	--	A	--	--	100
25003	01-0403	72	101	-----	-----	172	A	A	--	--	--	100
26001	01-1201	-----	110	143	92	-----	--	A	A	--	--	100
26003	01-1201	-----	107	138	-----	172	--	A	A	--	--	100
26006	01-0403	69	99	-----	88	-----	A	A	--	--	--	100
27014	01-1201	75	-----	139	90	-----	A	--	A	--	--	100
27020	01-0403	-----	101	133	88	-----	--	A	A	--	--	100
27044	01-0403	-----	99	131	86	-----	--	A	A	--	--	100
27046	01-1201	76	109	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100
28002	01-1201	78	-----	143	91	-----	A	--	A	--	--	100
28003	01-0403	71	102	-----	88	-----	A	A	--	--	--	100
28011	01-0403	-----	98	130	86	-----	--	A	A	--	--	100
28016	01-0403	71	99	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
28017	01-0403	-----	101	134	-----	170	--	A	A	--	--	100
28031	01-1201	77	110	-----	92	-----	A	A	--	--	--	100
28034	01-0403	-----	103	135	88	-----	--	A	A	--	--	100
30004	01-0403	71	102	-----	-----	171	A	A	--	--	--	100
30005	01-0403	71	-----	133	89	-----	A	--	A	--	--	100
30006	01-1201	78	109	-----	93	-----	A	A	--	--	--	100
31005	01-0403	72	101	-----	89	-----	A	A	--	--	--	100
32001	01-0403	69	98	-----	-----	167	A	A	--	--	--	100

[10] ＬＤＬコレステロール　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
32002	01-0403	70	-----	133	87	-----	A	--	A	--	--	100
33001	01-0403	72	-----	134	-----	173	A	--	A	--	--	100
33005	01-0403	-----	97	128	84	-----	--	A	B	--	--	92.9
33008	01-1201	77	110	-----	-----	178	A	A	--	--	--	100
33009	01-0403	68	96	-----	-----	161	B	B	--	--	--	85.7
34004	01-0403	73	-----	136	89	-----	A	--	A	--	--	100
34009	01-1201	76	110	-----	91	-----	A	A	--	--	--	100
34010	01-1201	77	110	-----	92	-----	A	A	--	--	--	100
34011	01-1201	-----	110	140	92	-----	--	A	A	--	--	100
34012	01-1201	78	-----	144	-----	179	A	--	A	--	--	100
34015	01-0403	-----	100	132	-----	172	--	A	A	--	--	100
35001	01-0403	72	102	-----	88	-----	A	A	--	--	--	100
39001	01-0403	-----	98	132	-----	167	--	A	A	--	--	100
39002	01-0403	70	-----	133	88	-----	A	--	A	--	--	100
39003	01-0403	-----	100	132	87	-----	--	A	A	--	--	100
39004	01-1201	76	-----	140	-----	177	A	--	A	--	--	100
40007	01-2302	-----	123	155	-----	186	--	--	--	--	--	======
40009	01-1201	77	109	-----	-----	179	A	A	--	--	--	100
40027	01-0403	70	99	-----	88	-----	A	A	--	--	--	100
43001	01-1201	75	-----	140	89	-----	A	--	A	--	--	100
43003	01-0403	71	-----	132	-----	163	A	--	A	--	--	100
45002	01-0403	70	-----	131	87	-----	A	--	A	--	--	100
46004	01-0403	70	-----	132	87	-----	A	--	A	--	--	100
47001	01-1201	77	111	-----	92	-----	A	A	--	--	--	100
47004	01-1201	76	-----	142	-----	179	A	--	A	--	--	100
47005	01-0403	71	-----	133	-----	169	A	--	A	--	--	100
47006	01-1201	75	-----	140	-----	172	A	--	A	--	--	100

[11] ＨｂＡ１ｃ　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
01001	02-0404	5.7	-----	7.7	6.6	5.1	--	--	--	--	--	======
01013	01-2901	5.5	6.4	-----	6.4	5.0	A	A	--	--	--	100
01018	02-0403	5.7	6.8	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
01025	02-0403	5.7	-----	7.7	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
01040	02-0403	-----	6.7	7.7	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
02004	01-2701	5.6	6.4	-----	6.6	5.3	A	A	--	--	--	100
03001	03-3501	-----	6.3	7.2	6.4	5.1	--	--	--	--	--	======
03006	02-0403	-----	6.8	7.9	6.5	5.2	--	A	A	--	--	100
04004	01-2901	5.6	6.5	-----	6.5	5.1	A	A	--	--	--	100
04008	01-2901	-----	6.5	7.4	6.5	5.1	--	A	A	--	--	100
04009	01-2901	-----	6.5	7.4	6.5	5.1	--	A	A	--	--	100
04012	03-1201	-----	6.4	7.4	6.5	5.3	--	--	--	--	--	======
04015	01-2701	5.5	-----	7.3	6.5	5.2	A	--	A	--	--	100
08001	01-2701	5.4	-----	7.2	6.5	5.2	A	--	A	--	--	100
08003	01-2701	5.4	6.3	-----	6.5	5.3	A	A	--	--	--	100
08006	03-3501	5.6	-----	7.4	6.5	5.2	--	--	--	--	--	======
08009	03-0401	5.5	6.4	-----	6.2	5.1	A	A	--	--	--	100
08010	01-2901	5.6	6.5	-----	6.5	5.1	A	A	--	--	--	100
09001	02-0403	5.8	6.8	-----	6.5	5.1	A	A	--	--	--	100
09005	01-2701	5.4	6.3	-----	-----	-----	A	A	--	--	--	100
09012	02-2401	5.6	-----	7.5	6.5	5.2	--	--	--	--	--	======
09013	02-0404	5.7	6.7	-----	6.5	5.2	--	--	--	--	--	======
10005	01-2901	-----	6.5	7.5	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
10007	01-2901	5.6	6.5	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
11006	02-0403	5.7	6.7	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
11010	03-0401	-----	6.4	7.4	6.3	5.1	--	A	A	--	--	100
11020	01-2901	-----	6.5	7.5	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
11023	01-2901	5.8	-----	7.7	6.5	5.2	B	--	B	--	--	78.6
11033	03-1201	-----	6.3	7.3	6.4	5.3	--	--	--	--	--	======
12001	03-3501	5.4	6.3	-----	6.5	5.3	--	--	--	--	--	======
12002	01-2701	5.5	6.4	-----	6.6	5.3	A	A	--	--	--	100
12008	03-0401	5.5	-----	7.3	6.2	5.0	A	--	A	--	--	100
12016	01-2901	5.6	-----	7.6	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
12019	01-2901	-----	6.6	7.6	6.5	5.1	--	A	A	--	--	100
13002	01-2701	-----	6.3	7.3	6.5	5.2	--	A	A	--	--	100
13003	01-2701	5.6	-----	7.4	6.7	5.3	A	--	A	--	--	100
13016	03-0401	5.5	6.4	-----	6.3	5.2	A	A	--	--	--	100
13017	03-0401	5.6	-----	7.4	6.4	5.1	A	--	A	--	--	100
13026	01-2701	5.4	6.3	-----	6.5	5.2	A	A	--	--	--	100
13053	01-2901	5.8	-----	7.6	6.5	5.2	B	--	A	--	--	85.7
13061	03-0401	5.6	-----	7.4	6.4	5.2	A	--	A	--	--	100
13064	02-2401	-----	6.7	7.6	6.5	5.2	--	--	--	--	--	======
13074	03-0401	5.5	-----	7.4	6.2	5.2	A	--	A	--	--	100
13084	01-2701	5.5	-----	7.3	6.4	5.2	A	--	A	--	--	100
13103	02-0404	5.8	-----	7.8	6.5	5.1	--	--	--	--	--	======
13145	03-1201	-----	6.1	7.0	6.6	5.2	--	--	--	--	--	======
14001	02-0404	-----	6.6	7.7	6.4	5.2	--	--	--	--	--	======
14003	01-2701	-----	6.3	7.2	6.4	5.2	--	A	A	--	--	100
14010	03-0401	5.4	6.3	-----	6.1	4.9	B	A	--	--	--	92.9
14025	02-0404	5.7	6.7	-----	6.5	5.1	--	--	--	--	--	======
14030	03-1201	5.6	6.5	-----	6.6	5.5	--	--	--	--	--	======

[11] ＨｂＡ１ｃ　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
14046	03-0401	5.4	6.0	-----	6.2	5.1	B	C	--	--	--	64.3
15001	03-1201	5.6	-----	7.4	6.4	5.2	--	--	--	--	--	=======
15006	01-2901	-----	6.5	7.4	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
15011	01-2901	-----	6.5	7.4	6.5	5.2	--	A	A	--	--	100
15012	01-2901	5.6	6.5	-----	6.4	5.0	A	A	--	--	--	100
16002	01-2901	5.5	-----	7.4	6.4	5.0	A	--	A	--	--	100
16006	01-2901	5.5	6.4	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
17001	01-2901	5.6	-----	7.5	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
18001	03-0401	-----	6.5	7.5	6.1	5.1	--	A	A	--	--	100
21002	01-2901	5.6	6.4	-----	6.4	5.2	A	A	--	--	--	100
21005	03-0401	5.6	6.4	-----	6.3	5.1	A	A	--	--	--	100
21006	03-0401	5.6	6.4	-----	6.4	5.2	A	A	--	--	--	100
22002	01-2901	5.7	-----	7.6	6.6	5.3	A	--	A	--	--	100
22003	01-2901	-----	6.4	7.4	6.5	5.1	--	A	A	--	--	100
22004	01-2901	5.3	6.3	-----	6.4	5.1	B	B	--	--	--	71.4
22006	01-2901	5.6	-----	7.5	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
22012	03-0401	5.6	6.4	-----	6.4	5.2	A	A	--	--	--	100
22017	01-2901	5.7	-----	7.6	6.4	5.1	A	--	A	--	--	100
22028	01-2901	5.6	6.5	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
23003	02-0404	5.7	-----	7.8	6.4	5.1	--	--	--	--	--	=======
23008	03-0401	-----	6.4	7.4	6.1	5.0	--	A	A	--	--	100
23011	01-2701	5.5	6.3	-----	6.6	5.2	A	A	--	--	--	100
23015	01-2901	-----	6.5	7.6	6.5	5.1	--	A	A	--	--	100
23016	02-0403	-----	6.7	7.8	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
23017	01-2901	-----	6.5	7.5	6.4	5.1	--	A	A	--	--	100
23019	01-2901	5.6	-----	7.4	6.4	5.1	A	--	A	--	--	100
23024	03-0401	5.5	6.4	-----	6.2	5.0	A	A	--	--	--	100
23067	03-0401	5.5	6.4	-----	6.4	5.3	A	A	--	--	--	100
24012	03-3501	5.7	-----	7.5	-----	-----	--	--	--	--	--	=======
25003	03-0401	-----	6.4	7.5	6.3	5.2	--	A	A	--	--	100
26001	03-0401	-----	6.5	7.5	6.4	5.3	--	A	A	--	--	100
26003	01-2701	-----	6.5	7.3	6.6	5.3	--	A	A	--	--	100
26006	03-0401	5.6	6.4	-----	6.4	5.3	A	A	--	--	--	100
27014	03-0401	5.6	-----	7.4	6.5	5.2	A	--	A	--	--	100
27020	03-0401	5.6	6.4	-----	6.4	5.2	A	A	--	--	--	100
27044	01-2701	5.5	-----	7.2	-----	-----	A	--	A	--	--	100
27046	01-2701	5.4	-----	7.2	-----	-----	A	--	A	--	--	100
28002	01-2901	-----	6.4	7.4	6.3	5.0	--	A	A	--	--	100
28003	01-2901	5.6	6.5	-----	6.4	5.0	A	A	--	--	--	100
28011	03-0401	5.6	6.5	-----	6.2	5.1	A	A	--	--	--	100
28016	03-0401	-----	6.5	7.5	6.2	5.1	--	A	A	--	--	100
28017	01-2701	-----	6.4	7.3	6.6	5.3	--	A	A	--	--	100
28031	01-2701	5.4	6.2	-----	6.4	5.2	A	A	--	--	--	100
28034	03-3501	5.6	-----	7.3	6.3	5.1	--	--	--	--	--	=======
30004	02-0404	5.7	-----	7.6	6.4	5.3	--	--	--	--	--	=======
30005	01-2901	5.6	6.4	-----	6.3	5.0	A	A	--	--	--	100
30006	01-2901	-----	6.5	7.4	6.4	5.0	--	A	A	--	--	100
31005	03-0401	5.5	6.4	-----	6.2	5.1	A	A	--	--	--	100
32001	01-2901	5.5	-----	7.3	6.4	5.0	A	--	A	--	--	100
32002	01-2901	5.6	6.4	-----	6.4	5.0	A	A	--	--	--	100
33001	01-2701	5.4	-----	7.3	6.5	5.2	A	--	A	--	--	100

[11] ＨｂＡ１ｃ　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値					試料No別判定値					総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	
33005	01-2701	5.6	6.5	-----	6.6	5.3	A	A	--	--	--	100
33008	03-1201	5.7	6.5	-----	6.6	5.3	--	--	--	--	--	======
33009	02-0404	5.7	-----	7.7	-----	-----	--	--	--	--	--	======
34004	03-0401	5.6	-----	7.5	6.6	5.3	A	--	A	--	--	100
34009	01-2901	5.6	6.5	-----	6.6	5.2	A	A	--	--	--	100
34010	01-2901	5.7	-----	7.6	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
34011	01-2901	5.5	-----	7.3	6.6	5.2	A	--	A	--	--	100
34012	01-2901	5.7	6.6	-----	6.6	5.2	A	A	--	--	--	100
34015	03-0401	5.6	6.4	-----	6.4	5.1	A	A	--	--	--	100
35001	03-0401	5.5	6.4	-----	6.1	5.0	A	A	--	--	--	100
39001	01-2901	-----	6.5	7.4	6.4	5.0	--	A	A	--	--	100
39002	03-1202	5.6	6.5	-----	6.4	5.2	--	--	--	--	--	======
39003	01-2901	5.7	-----	7.6	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
39004	01-2701	-----	6.5	7.4	-----	-----	--	A	A	--	--	100
40007	03-0401	5.6	6.5	-----	6.4	5.3	A	A	--	--	--	100
40009	01-2901	5.5	-----	7.3	6.5	5.1	A	--	A	--	--	100
40027	03-0401	-----	6.4	7.3	6.3	5.3	--	A	A	--	--	100
43001	01-2901	5.6	-----	7.4	6.4	5.1	A	--	A	--	--	100
43003	01-2701	-----	6.3	7.2	6.5	5.2	--	A	A	--	--	100
45002	03-1202	5.7	-----	7.6	6.4	5.0	--	--	--	--	--	======
46004	03-0401	5.6	6.5	-----	6.2	5.0	A	A	--	--	--	100
47001	01-2701	5.5	-----	7.2	6.4	5.1	A	--	A	--	--	100
47004	01-2701	-----	6.4	7.3	6.6	5.3	--	A	A	--	--	100
47005	01-2701	-----	6.4	7.4	6.6	5.3	--	A	A	--	--	100
47006	01-2701	-----	6.4	7.4	6.6	5.3	--	A	A	--	--	100

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01002	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
01013	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01018	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01023	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01025	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01027	1	1	-----	-----	4	4	4	-----	5	A	--	--	B	A	A	--	B	92.0
01030	1	1	3	-----	3	-----	5	-----	3	A	A	--	A	--	B	--	B	92.0
01034	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
01035	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01040	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
02003	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
02004	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	5	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
03001	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
03004	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
03006	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04001	2	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
04004	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
04006	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04008	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
04012	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04015	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
07004	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
08001	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
08002	1	1	-----	3	-----	5	5	-----	5	A	--	A	--	B	B	--	B	88.0
08003	2	1	-----	3	-----	4	5	-----	5	A	--	A	--	A	B	--	B	92.0
08006	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
08009	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
08010	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09001	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09005	1	1	-----	4	-----	4	5	-----	5	A	--	B	--	A	B	--	B	88.0
09007	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09009	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	4	A	B	--	B	--	B	--	A	88.0
09010	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
09011	1	1	4	4	-----	-----	4	1	-----	A	B	B	--	--	A	A	--	92.0
09012	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
09013	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
09016	2	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
10002	1	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
10005	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10007	2	1	-----	4	-----	4	4	1	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
11002	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11005	2	1	-----	-----	4	5	4	-----	4	A	--	--	B	B	A	--	A	92.0
11006	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11007	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11010	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11020	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11021	1	1	3	-----	3	-----	5	-----	4	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
11023	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11025	1	1	-----	-----	3	5	4	-----	4	A	--	--	A	B	A	--	A	96.0
11033	2	1	3	-----	3	-----	5	-----	4	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
12001	2	1	-----	3	-----	5	4	-----	4	A	--	A	--	B	A	--	A	96.0
12002	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
12003	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12008	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12011	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12012	1	1	-----	-----	5	6	6	-----	5	A	--	--	Z	Z	Z	--	B	36.0
12013	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12014	2	1	-----	-----	3	5	4	-----	5	A	--	--	A	B	A	--	B	92.0
12015	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
12016	2	1	-----	-----	3	4	5	-----	4	A	--	--	A	A	B	--	A	96.0
12019	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13001	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	5	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
13002	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13004	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
13005	1	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
13006	1	1	-----	-----	2	3	4	-----	3	A	--	--	B	B	A	--	B	88.0
13014	1	1	4	-----	4	-----	5	1	-----	A	B	--	B	--	B	A	--	88.0
13015	1	1	-----	4	-----	4	5	-----	4	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
13016	2	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
13017	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13021	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13024	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13026	2	1	-----	3	-----	5	5	-----	5	A	--	A	--	B	B	--	B	88.0
13035	1	1	3	-----	4	-----	4	-----	5	A	A	--	B	--	A	--	B	92.0
13038	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13039	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	3	A	--	A	--	B	B	--	B	88.0
13045	2	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
13051	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13053	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13055	1	1	-----	4	-----	5	4	-----	4	A	--	B	--	B	A	--	A	92.0
13056	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
13061	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13063	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13064	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13067	1	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
13074	2	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
13077	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
13078	1	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
13080	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	Z	--	A	--	B	--	B	72.0
13083	1	1	-----	-----	4	4	4	-----	4	A	--	--	B	A	A	--	A	96.0
13084	2	1	3	3	-----	-----	5	1	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
13088	1	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
13101	1	1	-----	4	-----	4	4	-----	4	A	--	B	--	A	A	--	A	96.0
13103	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13107	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13109	1	1	-----	-----	4	5	4	-----	4	A	--	--	B	B	A	--	A	92.0
13145	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
13156	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
14001	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14002	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
14003	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14004	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14007	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14010	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14018	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14022	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
14023	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14025	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14030	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14046	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
15001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15006	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
15007	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15011	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
15012	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
16002	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
16004	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	4	A	--	B	--	B	B	--	A	88.0
16005	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
16006	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
16008	1	1	-----	4	-----	6	5	1	-----	A	--	B	--	Z	B	A	--	72.0
17001	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
17003	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
18001	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
18003	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
20001	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
20003	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
20004	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
20005	2	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
21001	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
21002	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21005	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
21006	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21015	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22001	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22002	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22003	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
22004	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22006	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
22012	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
22015	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
22017	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22019	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22023	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22028	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23001	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23002	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
23003	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
23005	1	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
23006	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23007	1	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
23008	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23009	1	1	4	-----	5	-----	5	1	-----	A	B	--	Z	--	B	A	--	72.0
23011	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23012	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23015	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23017	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23018	2	1	3	3	-----	-----	5	1	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
23019	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23024	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23029	1	1	-----	3	-----	5	5	-----	5	A	--	A	--	B	B	--	B	88.0
23032	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23038	2	1	-----	3	-----	5	5	-----	5	A	--	A	--	B	B	--	B	88.0
23040	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23042	1	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
23067	2	1	-----	3	-----	5	5	1	-----	A	--	A	--	B	B	A	--	92.0
24012	2	1	-----	-----	3	4	5	-----	4	A	--	--	A	A	B	--	A	96.0
25003	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
25011	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26001	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26003	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
26005	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
26006	2	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
26012	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26020	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27002	1	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
27003	1	1	-----	4	-----	4	4	1	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
27007	1	1	-----	-----	4	4	5	-----	5	A	--	--	B	A	B	--	B	88.0
27010	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27014	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27018	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
27020	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
27023	1	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27038	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27041	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27044	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27045	2	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
27046	2	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
27051	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
28001	1	1	-----	-----	4	4	4	-----	4	A	--	--	B	A	A	--	A	96.0
28002	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28003	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
28007	1	1	5	4	-----	-----	5	1	-----	A	Z	B	--	--	B	A	--	72.0
28011	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
28014	1	1	4	4	-----	-----	4	1	-----	A	B	B	--	--	A	A	--	92.0
28015	1	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
28016	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
28017	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
28019	1	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28024	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28029	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28031	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
28034	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28038	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
30004	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
30005	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
30006	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31002	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31003	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31005	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
32001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
32002	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
33001	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
33002	1	1	3	-----	4	-----	5	1	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
33004	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
33005	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
33008	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
33009	2	1	4	4	-----	-----	5	1	-----	A	B	B	--	--	B	A	--	88.0
34001	1	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34002	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34003	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34004	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34005	2	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
34009	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
34010	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34011	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34012	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34013	2	1	3	-----	4	-----	5	-----	5	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
34015	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
35001	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
35006	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
37001	1	2	3	-----	3	-----	4	1	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
37004	2	1	-----	-----	4	3	3	-----	3	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
37006	2	1	4	4	-----	-----	6	1	-----	A	B	B	--	--	Z	A	--	72.0
38006	1	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
38009	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
39001	2	1	4	-----	3	-----	5	1	-----	A	B	--	A	--	B	A	--	92.0
39002	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
39003	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
39004	2	1	3	-----	3	-----	5	1	-----	A	A	--	A	--	B	A	--	96.0
40001	2	1	3	-----	4	-----	5	1	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
40002	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40004	2	1	-----	3	-----	4	4	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	A	100
40006	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
40007	1	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
40009	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40015	1	1	4	-----	4	-----	4	1	-----	A	B	--	B	--	A	A	--	92.0
40025	1	1	-----	-----	4	5	4	-----	5	A	--	--	B	B	A	--	B	88.0
40027	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[12] 尿糖　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
40028	1	1	-----	4	-----	4	5	1	-----	A	--	B	--	A	B	A	--	92.0
40029	1	1	4	-----	5	-----	5	1	-----	A	B	--	Z	--	B	A	--	72.0
40031	1	1	-----	4	-----	4	5	1	-----	A	--	B	--	A	B	A	--	92.0
40034	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40035	1	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
41001	2	1	-----	4	-----	5	5	-----	5	A	--	B	--	B	B	--	B	84.0
43001	2	1	-----	-----	3	4	4	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	A	100
43003	2	1	-----	-----	4	5	5	-----	5	A	--	--	B	B	B	--	B	84.0
43007	2	1	-----	4	-----	5	4	-----	5	A	--	B	--	B	A	--	B	88.0
44002	2	1	3	-----	3	-----	4	1	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
45002	1	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
46001	2	1	-----	4	-----	5	5	1	-----	A	--	B	--	B	B	A	--	88.0
46004	2	1	-----	3	-----	4	4	1	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
47001	2	1	3	3	-----	-----	4	1	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
47002	2	1	4	-----	4	-----	5	-----	5	A	B	--	B	--	B	--	B	84.0
47004	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47005	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47006	2	1	3	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01002	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
01013	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01018	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01023	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01025	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01027	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01030	1	2	1	-----	4	-----	4	-----	1	B	A	--	A	--	A	--	A	96.0
01034	2	3	1	-----	5	-----	5	5	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
01035	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01040	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	3	-----	3	-----	3	5	4	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	96.0
02003	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
02004	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
03001	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
03004	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
03006	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04001	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
04004	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
04006	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04008	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
04012	2	3	1	-----	5	-----	5	-----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
04015	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
07004	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
08001	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
08002	1	2	-----	2	-----	2	4	-----	1	B	--	B	--	B	A	--	A	88.0
08003	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
08006	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
08009	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
08010	2	3	-----	3	-----	3	4	5	-----	A	--	A	--	A	A	B	--	96.0
09001	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09005	1	4	-----	3	-----	3	4	-----	1	B	--	A	--	A	A	--	A	96.0
09007	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09009	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
09010	1	3	-----	-----	4	2	4	-----	1	A	--	--	A	B	A	--	A	96.0
09011	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
09012	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
09013	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
09016	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
10002	1	3	1	-----	5	-----	5	4	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
10005	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10007	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11002	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11005	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11006	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11007	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11010	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11020	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11021	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
11023	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11025	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11033	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12001	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
12002	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
12003	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12008	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12011	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12012	1	3	-----	-----	5	3	5	-----	1	A	--	--	B	A	B	--	A	92.0
12013	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12014	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12015	1	2	-----	3	-----	3	4	-----	1	B	--	A	--	A	A	--	A	96.0
12016	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12019	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13001	1	3	1	-----	5	-----	5	-----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
13002	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13004	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13005	1	3	-----	-----	5	4	5	-----	1	A	--	--	B	B	B	--	A	88.0
13006	1	2	-----	-----	3	2	4	-----	1	B	--	--	B	B	A	--	A	88.0
13014	1	4	1	-----	5	-----	5	5	-----	B	A	--	B	--	B	B	--	84.0
13015	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13016	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13017	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13021	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13024	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13026	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13035	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13038	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13039	1	3	-----	3	-----	3	5	-----	1	A	--	A	--	A	B	--	A	96.0
13045	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13051	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13053	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13055	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13056	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13061	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13063	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13064	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13067	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13074	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13077	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13078	1	4	-----	4	-----	4	5	5	-----	B	--	B	--	B	B	B	--	80.0
13080	1	2	1	-----	4	-----	4	-----	1	B	A	--	A	--	A	--	A	96.0
13083	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13084	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13088	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13101	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13103	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13107	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13109	1	3	-----	-----	5	3	4	-----	1	A	--	--	B	A	A	--	A	96.0
13145	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
13156	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14001	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14002	1	3	-----	-----	5	3	5	-----	1	A	--	--	B	A	B	--	A	92.0
14003	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
14004	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14007	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14010	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14018	2	2	1	2	-----	-----	4	4	-----	B	A	B	--	--	A	A	--	92.0
14022	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14023	1	3	-----	3	-----	2	4	-----	1	A	--	A	--	B	A	--	A	96.0
14025	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14030	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14046	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
15001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15006	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
15007	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15011	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
15012	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
16002	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
16004	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
16005	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
16006	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
16008	1	3	-----	1	-----	2	4	4	-----	A	--	Z	--	B	A	A	--	76.0
17001	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
17003	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
18001	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
18003	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
20001	1	3	-----	3	-----	3	5	4	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	96.0
20003	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
20004	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
20005	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21001	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
21002	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21005	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
21006	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21015	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22001	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22002	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22003	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
22004	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22006	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
22012	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
22015	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22017	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22019	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22023	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22028	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23001	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23002	1	3	1	-----	5	-----	4	4	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
23003	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
23005	1	3	-----	-----	5	3	5	-----	1	A	--	--	B	A	B	--	A	92.0

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
23006	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23007	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23008	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23009	1	4	1	-----	5	-----	5	5	-----	B	A	--	B	--	B	B	--	84.0
23011	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23012	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23015	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23017	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23018	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23019	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23024	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23029	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23032	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23038	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23040	1	2	-----	2	-----	2	4	4	-----	B	--	B	--	B	A	A	--	88.0
23042	1	3	1	-----	4	-----	5	-----	1	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
23067	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
24012	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
25003	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
25011	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26001	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26003	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
26005	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
26006	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
26012	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26020	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27002	1	3	1	4	-----	-----	5	4	-----	A	A	B	--	--	B	A	--	92.0
27003	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
27007	1	4	-----	-----	5	3	5	-----	1	B	--	--	B	A	B	--	A	88.0
27010	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27014	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27018	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
27020	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
27023	1	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27038	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27041	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27044	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27045	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
27046	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27051	1	2	-----	3	-----	3	4	4	-----	B	--	A	--	A	A	A	--	96.0
28001	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28002	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28003	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
28007	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28011	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
28014	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28015	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28016	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
28017	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
28019	1	3	1	-----	5	-----	5	5	-----	A	A	--	B	--	B	B	--	88.0
28024	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28029	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28031	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
28034	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28038	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
30004	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
30005	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
30006	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31002	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31003	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31005	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
32001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
32002	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
33001	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
33002	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
33004	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
33005	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
33008	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
33009	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34001	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34002	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34003	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34004	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34005	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
34009	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
34010	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34011	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34012	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34013	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
34015	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
35001	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
35006	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
37001	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37004	2	3	-----	-----	4	1	1	-----	4	A	--	--	A	Z	Z	--	Z	40.0
37006	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
38006	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
38009	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
39001	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
39002	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
39003	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
39004	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40001	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40002	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40004	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
40006	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
40007	1	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
40009	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40015	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40025	1	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
40027	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[13] 尿蛋白　　自施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
40028	1	3	-----	3	-----	2	4	5	-----	A	--	A	--	B	A	B	--	92.0
40029	1	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40031	1	2	-----	3	-----	2	4	4	-----	B	--	A	--	B	A	A	--	92.0
40034	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40035	1	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
41001	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
43001	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
43003	2	3	-----	-----	4	3	4	-----	1	A	--	--	A	A	A	--	A	100
43007	2	3	-----	3	-----	3	4	-----	1	A	--	A	--	A	A	--	A	100
44002	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
45002	1	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
46001	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
46004	2	3	-----	3	-----	3	4	4	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
47001	2	3	1	3	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
47002	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47004	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47005	2	3	1	-----	5	-----	5	-----	1	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
47006	2	3	1	-----	4	-----	4	-----	1	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
01001	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01002	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
01013	2	1	-----	3	-----	1	3	3	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
01018	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01023	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01025	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
01027	1	1	-----	-----	3	1	2	-----	3	A	--	--	A	A	B	--	A	96.0
01030	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
01034	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
01035	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
01040	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
02001	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
02003	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
02004	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
03001	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
03004	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
03006	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04001	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
04004	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
04006	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
04008	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
04009	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
04012	2	1	1	-----	3	-----	4	-----	4	A	A	--	A	--	B	--	B	92.0
04015	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
06001	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
07004	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
08001	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
08002	1	1	-----	5	-----	1	3	-----	4	A	--	B	--	A	A	--	B	92.0
08003	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
08006	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
08009	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
08010	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09001	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09005	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
09007	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
09009	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
09010	1	1	-----	-----	2	1	3	-----	3	A	--	--	B	A	A	--	A	96.0
09011	1	1	1	3	-----	-----	3	2	-----	A	A	B	--	--	A	B	--	92.0
09012	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
09013	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
09016	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
10002	1	1	1	-----	4	-----	3	4	-----	A	A	--	B	--	A	B	--	92.0
10005	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
10007	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11002	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11005	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11006	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
11007	1	1	-----	3	-----	1	2	3	-----	A	--	B	--	A	B	A	--	92.0
11010	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
11020	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
11021	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
11023	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
11025	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
11033	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
12001	2	1	-----	3	-----	1	2	-----	3	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
12002	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
12003	2	1	1	-----	3	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
12008	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
12011	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12012	1	1	-----	-----	4	1	5	-----	5	A	--	--	B	A	Z	--	Z	56.0
12013	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	2	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
12014	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12015	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
12016	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
12019	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
13001	1	1	1	-----	4	-----	3	-----	4	A	A	--	B	--	A	--	B	92.0
13002	2	1	1	-----	2	-----	3	-----	2	A	A	--	B	--	A	--	B	92.0
13003	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13004	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13005	1	1	-----	-----	4	1	4	-----	4	A	--	--	B	A	B	--	B	88.0
13006	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13014	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13015	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13016	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13017	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13021	2	1	1	4	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
13024	2	1	1	-----	3	-----	4	-----	3	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
13026	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
13035	1	1	1	-----	3	-----	2	-----	3	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
13038	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13039	1	1	-----	1	-----	1	1	-----	1	A	--	Z	--	A	Z	--	Z	40.0
13045	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
13051	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13053	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13055	1	1	-----	3	-----	1	3	-----	3	A	--	B	--	A	A	--	A	96.0
13056	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13061	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13063	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13064	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
13067	1	1	-----	5	-----	1	4	4	-----	A	--	B	--	A	B	B	--	88.0
13074	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
13077	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
13078	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13080	1	1	1	-----	1	-----	1	-----	3	A	A	--	Z	--	Z	--	A	60.0
13083	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13084	2	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
13088	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
13101	1	1	-----	3	-----	1	2	-----	3	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
13103	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13107	1	1	1	3	-----	-----	2	2	-----	A	A	B	--	--	B	B	--	88.0
13109	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
13145	2	1	1	-----	4	-----	4	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
13156	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
14001	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14002	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
14003	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
14004	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
14007	1	1	-----	3	-----	1	2	-----	3	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
14010	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14018	2	1	1	4	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
14022	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
14023	1	1	-----	5	-----	1	4	-----	4	A	--	B	--	A	B	--	B	88.0
14025	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
14030	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
14046	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
15001	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15006	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
15007	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
15011	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
15012	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
16002	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
16004	1	1	-----	3	-----	1	3	-----	3	A	--	B	--	A	A	--	A	96.0
16005	1	1	1	-----	3	-----	4	-----	3	A	A	--	A	--	B	--	A	96.0
16006	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
16008	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
17001	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
17003	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
18001	1	2	1	-----	3	-----	3	3	-----	B	A	--	A	--	A	A	--	96.0
18003	1	1	-----	3	-----	1	2	-----	3	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
20001	1	1	-----	4	-----	1	2	3	-----	A	--	A	--	A	B	A	--	96.0
20003	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
20004	1	1	-----	3	-----	1	2	-----	3	A	--	B	--	A	B	--	A	92.0
20005	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21001	1	1	-----	3	-----	1	3	3	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
21002	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21005	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
21006	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
21015	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
22001	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
22002	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22003	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
22004	1	1	-----	5	-----	1	4	-----	5	A	--	B	--	A	B	--	Z	72.0
22006	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
22012	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
22015	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22017	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
22019	1	1	1	4	-----	-----	3	4	-----	A	A	A	--	--	A	B	--	96.0
22023	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
22028	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23001	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23002	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
23003	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
23005	1	1	-----	-----	4	1	3	-----	4	A	--	--	B	A	A	--	B	92.0

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
23006	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23007	1	1	-----	3	-----	1	2	2	-----	A	--	B	--	A	B	B	--	88.0
23008	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23009	1	1	1	-----	5	-----	4	4	-----	A	A	--	Z	--	B	B	--	72.0
23011	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23012	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
23015	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23016	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23017	1	1	1	-----	2	-----	3	3	-----	A	A	--	B	--	A	A	--	96.0
23018	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23019	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
23022	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23024	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23029	1	1	-----	4	-----	1	2	-----	3	A	--	A	--	A	B	--	A	96.0
23032	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
23038	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
23040	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
23042	1	1	1	-----	2	-----	2	-----	2	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
23067	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
24012	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
25003	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
25011	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
26001	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
26003	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
26005	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
26006	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
26012	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
26020	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
27002	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27003	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
27007	1	1	-----	-----	4	1	4	-----	5	A	--	--	B	A	B	--	Z	72.0
27010	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27014	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27018	1	1	1	-----	2	-----	2	3	-----	A	A	--	B	--	B	A	--	92.0
27020	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
27023	1	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
27038	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27041	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27044	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
27045	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
27046	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
27051	1	1	-----	3	-----	1	2	3	-----	A	--	B	--	A	B	A	--	92.0
28001	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
28002	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28003	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
28007	1	1	1	4	-----	-----	2	3	-----	A	A	A	--	--	B	A	--	96.0
28011	2	1	-----	3	-----	1	3	-----	3	A	--	B	--	A	A	--	A	96.0
28014	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28015	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28016	2	1	1	-----	2	-----	2	-----	3	A	A	--	B	--	B	--	A	92.0
28017	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値								試料No別判定値								総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	評価点
28019	1	1	1	-----	2	-----	3	2	-----	A	A	--	B	--	A	B	--	92.0
28024	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
28029	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
28031	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
28034	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
28038	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
30004	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
30005	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
30006	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
31002	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31003	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
31005	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
32001	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
32002	2	1	-----	3	-----	1	3	3	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
33001	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
33002	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
33004	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
33005	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
33008	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
33009	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34001	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
34002	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
34003	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34004	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	2	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
34005	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	2	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
34009	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
34010	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
34011	2	1	-----	-----	3	1	2	-----	3	A	--	--	A	A	B	--	A	96.0
34012	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
34013	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0
34015	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
35001	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
35006	1	1	-----	4	-----	1	2	-----	3	A	--	A	--	A	B	--	A	96.0
37001	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
37004	2	1	-----	-----	3	4	1	-----	3	A	--	--	A	Z	Z	--	A	60.0
37006	2	1	1	4	-----	-----	4	4	-----	A	A	A	--	--	B	B	--	92.0
38006	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
38009	2	3	1	-----	4	-----	4	4	-----	Z	A	--	B	--	B	B	--	68.0
39001	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
39002	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
39003	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
39004	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40001	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40002	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40004	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
40006	1	1	-----	3	-----	1	3	3	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
40007	1	1	-----	3	-----	1	3	3	-----	A	--	B	--	A	A	A	--	96.0
40009	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
40015	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40025	1	1	-----	-----	3	1	3	-----	4	A	--	--	A	A	A	--	B	96.0
40027	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100

[14] 尿潜血　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定法	測定値								試料No別判定値								総合評価点
		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	試料６	試料７	試料８	1	2	3	4	5	6	7	8	
40028	1	1	-----	5	-----	1	4	4	-----	A	--	B	--	A	B	B	--	88.0
40029	1	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40031	1	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
40034	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
40035	1	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
41001	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	3	A	--	A	--	A	A	--	A	100
43001	2	1	-----	-----	4	1	4	-----	3	A	--	--	B	A	B	--	A	92.0
43003	2	1	-----	-----	3	1	3	-----	3	A	--	--	A	A	A	--	A	100
43007	2	1	-----	4	-----	1	3	-----	4	A	--	A	--	A	A	--	B	96.0
44002	2	1	1	-----	3	-----	3	3	-----	A	A	--	A	--	A	A	--	100
45002	1	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
46001	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
46004	2	1	-----	4	-----	1	3	3	-----	A	--	A	--	A	A	A	--	100
47001	2	1	1	4	-----	-----	3	3	-----	A	A	A	--	--	A	A	--	100
47002	2	1	1	-----	4	-----	4	-----	4	A	A	--	B	--	B	--	B	88.0
47004	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47005	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	3	A	A	--	A	--	A	--	A	100
47006	2	1	1	-----	3	-----	3	-----	4	A	A	--	A	--	A	--	B	96.0

[15] 赤血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB519	540	444	-----	374	361	A	C	--	A	A	100
01013	JAB517	528	448	-----	371	365	A	A	--	A	A	100
01018	JAB512	535	453	-----	372	363	A	A	--	A	A	100
01025	JAB517	525	442	-----	375	362	A	A	--	A	A	100
01040	JAB517	526	-----	242	373	365	A	--	A	A	A	100
02004	JAB514	524	-----	243	368	360	A	--	A	A	A	100
03001	JAB517	530	442	-----	375	364	A	A	--	A	A	100
03006	JAB517	531	444	-----	365	363	A	A	--	A	A	100
04004	JAB517	525	-----	243	374	362	A	--	A	A	A	100
04008	JAB517	534	-----	247	367	362	A	--	A	A	A	100
04009	JAB521	539	446	-----	374	363	A	A	--	A	A	100
04012	JAB517	535	-----	238	372	367	A	--	A	A	A	100
04015	JAB517	540	-----	241	375	367	A	--	A	A	A	100
08001	JAB517	526	-----	240	368	355	A	--	A	A	A	100
08003	JAB517	526	-----	241	371	359	A	--	A	A	A	100
08006	JAB517	527	445	-----	372	362	A	A	--	A	A	100
08009	JAB517	535	-----	244	377	366	A	--	A	A	A	100
08010	JAB517	537	-----	242	369	361	A	--	A	A	A	100
09001	JAB521	539	447	-----	369	362	A	A	--	A	A	100
09005	JAB517	534	446	-----	376	365	A	A	--	A	A	100
09012	JAB512	535	453	-----	379	368	A	A	--	A	A	100
09013	JAB521	535	-----	243	375	359	A	--	A	A	A	100
10005	JAB517	535	448	-----	370	362	A	A	--	A	A	100
10007	JAB517	534	-----	244	365	364	A	--	A	A	A	100
11006	JAB512	535	-----	250	375	365	A	--	A	A	A	100
11010	JAB517	531	-----	241	371	359	A	--	A	A	A	100
11020	JAB517	541	444	-----	380	365	A	A	--	B	A	92.9
11023	JAB514	536	447	-----	371	366	A	A	--	A	A	100
11033	JAB519	532	-----	242	372	357	A	--	A	A	A	100
12001	JAB517	535	-----	241	375	363	A	--	A	A	A	100
12002	JAB517	533	445	-----	366	360	A	A	--	A	A	100
12008	JAB517	533	-----	241	369	365	A	--	A	A	A	100
12016	JAB514	524	-----	243	370	361	A	--	A	A	A	100
12019	JAB514	526	440	-----	376	362	A	A	--	A	A	100
13002	JAB514	529	-----	249	374	362	A	--	A	A	A	100
13003	JAB521	539	-----	242	371	365	A	--	A	A	A	100
13016	JAB517	531	444	-----	359	362	A	A	--	B	A	85.7
13017	JAB517	527	438	-----	360	360	A	A	--	B	A	85.7
13026	JAB521	541	446	-----	380	361	A	A	--	B	A	92.9
13053	JAB512	540	-----	251	380	367	A	--	A	B	A	92.9
13061	JAB521	543	-----	246	372	361	A	--	A	A	A	100
13064	JAB512	537	-----	253	375	367	A	--	A	A	A	100
13074	JAB517	534	444	-----	349	358	A	A	--	C	A	64.3
13084	JAB514	536	-----	249	373	362	A	--	A	A	A	100
13103	JAB521	542	-----	245	372	364	A	--	A	A	A	100
13145	JAS304	517	446	-----	381	364	A	A	--	B	A	92.9
14001	JAB517	530	-----	240	373	361	A	--	A	A	A	100
14003	JAB512	534	-----	250	374	364	A	--	A	A	A	100
14010	JAB512	532	451	-----	371	366	A	A	--	A	A	100
14025	JAB517	530	449	-----	360	364	A	A	--	B	A	85.7
14030	JAB517	521	443	-----	371	360	A	A	--	A	A	100
14046	JAB512	536	452	-----	380	369	A	A	--	B	A	92.9

[15] 赤血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	JAB517	534	-----	242	375	361	A	--	A	A	A	100
15006	JAB517	536	-----	241	377	368	A	--	A	A	A	100
15011	JAB512	538	-----	254	376	373	A	--	A	A	B	85.7
15012	JAB514	527	437	-----	368	355	A	A	--	A	A	100
16002	JAB517	526	441	-----	363	362	A	A	--	B	A	92.9
16006	JAB517	537	451	-----	374	359	A	A	--	A	A	100
17001	JAB517	539	446	-----	374	364	A	A	--	A	A	100
18001	JAB517	532	444	-----	370	358	A	A	--	A	A	100
21002	JAB517	528	443	-----	370	362	A	A	--	A	A	100
21005	JAB517	529	-----	241	372	360	A	--	A	A	A	100
21006	JAB517	533	451	-----	364	363	A	A	--	A	A	100
22002	JAB514	527	441	-----	375	363	A	A	--	A	A	100
22003	JAB521	538	450	-----	371	362	A	A	--	A	A	100
22004	JAB521	540	448	-----	373	367	A	A	--	A	A	100
22006	JAB517	537	446	-----	374	362	A	A	--	A	A	100
22012	JAB517	532	-----	241	372	362	A	--	A	A	A	100
22017	JAB514	529	-----	244	375	362	A	--	A	A	A	100
22028	JAB516	534	-----	243	375	366	A	--	A	A	A	100
23003	JAB521	533	-----	241	373	366	A	--	A	A	A	100
23008	JAJ012	522	433	-----	373	358	A	A	--	A	A	100
23011	JAJ012	517	-----	238	379	357	A	--	A	A	A	100
23015	JAB517	533	-----	241	370	360	A	--	A	A	A	100
23016	JAB517	534	-----	240	374	365	A	--	A	A	A	100
23017	JAB517	536	-----	241	377	367	A	--	A	A	A	100
23019	JAB517	543	450	-----	380	369	A	A	--	B	A	92.9
23024	JAB517	527	441	-----	373	361	A	A	--	A	A	100
23067	JAB521	542	441	-----	371	364	A	A	--	A	A	100
24012	JAB512	540	-----	245	377	367	A	--	B	A	A	100
25003	JAB517	532	445	-----	370	361	A	A	--	A	A	100
26001	JAB517	535	443	-----	377	364	A	A	--	A	A	100
26003	JAB517	537	447	-----	353	359	A	A	--	C	A	71.4
26006	JAB517	536	-----	245	367	364	A	--	A	A	A	100
27014	JAB521	536	448	-----	369	361	A	A	--	A	A	100
27020	JAB517	528	440	-----	369	360	A	A	--	A	A	100
27044	JAB517	530	443	-----	374	363	A	A	--	A	A	100
27046	JAB517	529	-----	241	371	370	A	--	A	A	A	100
28002	JAB517	530	-----	243	345	361	A	--	A	D	A	57.1
28003	JAB521	533	444	-----	368	360	A	A	--	A	A	100
28011	JAJ803	516	429	-----	374	357	A	A	--	A	A	100
28016	JAB512	530	447	-----	373	362	A	A	--	A	A	100
28017	JAB521	529	440	-----	370	362	A	A	--	A	A	100
28031	JAB517	528	-----	239	370	357	A	--	A	A	A	100
28034	JAB512	538	452	-----	368	364	A	A	--	A	A	100
30004	JAB517	538	-----	242	381	366	A	--	A	B	A	92.9
30005	JAB517	530	438	-----	374	359	A	A	--	A	A	100
30006	JAB519	537	-----	241	377	362	A	--	A	A	A	100
31005	JAB517	527	-----	244	371	369	A	--	A	A	A	100
32001	JAB521	540	-----	247	373	365	A	--	A	A	A	100
32002	JAB519	538	445	-----	370	358	A	B	--	A	A	100
33001	JAB517	533	-----	240	374	362	A	--	A	A	A	100
33005	JAB517	541	-----	244	378	368	A	--	A	A	A	100
33008	JAB517	546	-----	241	374	364	B	--	A	A	A	100

[15] 赤血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	JAJ012	520	-----	238	370	362	A	--	A	A	A	100
34004	JAB517	530	-----	241	358	363	A	--	A	B	A	78.6
34009	JAB517	530	442	-----	375	359	A	A	--	A	A	100
34010	JAB519	432	523	-----	366	357	D	D	--	A	A	100
34011	JAB517	538	-----	244	376	366	A	--	A	A	A	100
34012	JAB521	538	448	-----	365	357	A	A	--	A	A	100
34015	JAB517	527	-----	238	369	355	A	--	A	A	A	100
35001	JAB521	530	-----	241	364	363	A	--	A	A	A	100
39001	JAB517	524	-----	240	368	360	A	--	A	A	A	100
39002	JAB512	539	451	-----	379	367	A	A	--	A	A	100
39003	JAB512	539	-----	251	376	366	A	--	A	A	A	100
39004	JAB517	535	-----	246	376	366	A	--	A	A	A	100
40007	JAB517	531	-----	240	369	359	A	--	A	A	A	100
40009	JAB521	538	447	-----	378	367	A	A	--	A	A	100
40027	JAB517	535	-----	244	373	364	A	--	A	A	A	100
43001	JAB517	532	-----	243	360	359	A	--	A	B	A	85.7
43003	JAB517	531	439	-----	361	357	A	A	--	B	A	85.7
45002	JAB517	523	-----	244	360	358	A	--	A	B	A	85.7
46004	JAB517	530	-----	241	370	360	A	--	A	A	A	100
47001	JAB517	529	-----	239	364	363	A	--	A	A	A	100
47004	JAB517	526	-----	244	376	364	A	--	A	A	A	100
47005	JAB517	524	440	-----	365	359	A	A	--	A	A	100
47006	JAB517	529	-----	241	372	360	A	--	A	A	A	100

［16］ ヘモグロビン量　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値					試料No別判定値					総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	2	16.9	12.5	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
01013	9	16.7	12.4	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
01018	2	16.9	12.5	-----	10.0	11.9	A	A	--	A	A	100
01025	2	16.5	12.4	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
01040	2	16.6	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
02004	2	16.7	-----	6.0	10.0	12.0	A	--	A	A	A	100
03001	2	17.0	12.4	-----	10.3	12.2	A	A	--	A	A	100
03006	2	16.7	12.3	-----	10.1	12.1	A	A	--	A	A	100
04004	2	16.7	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
04008	2	16.8	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
04009	2	16.8	12.5	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
04012	2	16.9	-----	5.9	10.3	12.1	A	--	A	A	A	100
04015	2	16.9	-----	5.9	10.1	12.1	A	--	A	A	A	100
08001	1	16.8	-----	5.9	10.1	11.9	A	--	A	A	A	100
08003	2	16.7	-----	5.9	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
08006	2	16.7	12.4	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
08009	2	16.9	-----	6.0	10.3	12.2	A	--	A	A	A	100
08010	2	16.7	-----	6.0	10.1	12.0	A	--	A	A	A	100
09001	2	17.0	12.5	-----	10.1	11.9	A	A	--	A	A	100
09005	1	17.0	12.4	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
09012	2	17.0	12.5	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
09013	2	16.7	-----	5.9	10.0	11.9	A	--	A	A	A	100
10005	2	16.8	12.4	-----	10.1	11.9	A	A	--	A	A	100
10007	9	16.8	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
11006	2	17.0	-----	6.0	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
11010	2	16.8	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
11020	2	16.6	12.3	-----	10.3	12.0	A	A	--	A	A	100
11023	2	16.8	12.6	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
11033	2	16.7	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
12001	2	16.8	-----	5.9	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
12002	2	16.7	12.3	-----	10.1	11.9	A	A	--	A	A	100
12008	2	16.8	-----	5.8	10.1	12.1	A	--	B	A	A	100
12016	2	16.7	-----	6.1	10.2	12.0	A	--	B	A	A	100
12019	2	16.7	12.4	-----	10.3	12.0	A	A	--	A	A	100
13002	2	16.4	-----	6.0	10.2	12.0	B	--	A	A	A	100
13003	2	16.8	-----	5.9	10.1	12.0	A	--	A	A	A	100
13016	9	16.6	12.2	-----	10.0	12.0	A	A	--	A	A	100
13017	2	16.7	12.2	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
13026	2	16.9	12.4	-----	10.2	11.9	A	A	--	A	A	100
13053	2	17.1	-----	6.1	10.3	11.9	A	--	B	A	A	100
13061	9	16.7	-----	5.9	10.1	11.9	A	--	A	A	A	100
13064	1	16.9	-----	6.0	10.3	12.1	A	--	A	A	A	100
13074	9	16.7	12.4	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
13084	2	16.5	-----	6.1	10.2	12.0	A	--	B	A	A	100
13103	2	16.9	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
13145	2	16.9	12.7	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
14001	2	16.5	-----	6.0	10.0	11.9	A	--	A	A	A	100
14003	2	16.9	-----	6.0	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
14010	2	16.9	12.5	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
14025	2	16.7	12.5	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
14030	2	16.5	12.3	-----	10.3	12.2	A	A	--	A	A	100
14046	2	17.0	12.6	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100

[16] ヘモグロビン量　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値					試料No別判定値					総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	2	16.7	-----	5.9	10.1	11.9	A	--	A	A	A	100
15006	2	16.9	-----	5.9	10.3	12.1	A	--	A	A	A	100
15011	2	17.1	-----	6.0	10.2	12.2	A	--	A	A	A	100
15012	2	16.7	12.4	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
16002	2	16.7	12.3	-----	10.3	12.0	A	A	--	A	A	100
16006	2	16.6	12.3	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
17001	2	16.8	12.4	-----	10.1	12.1	A	A	--	A	A	100
18001	2	16.7	12.4	-----	10.1	11.9	A	A	--	A	A	100
21002	2	16.8	12.5	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
21005	2	16.7	-----	5.9	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
21006	2	16.8	12.3	-----	9.9	11.9	A	A	--	B	A	85.7
22002	1	16.7	12.4	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
22003	2	16.9	12.4	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
22004	2	17.0	12.5	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
22006	2	16.9	12.4	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
22012	2	16.9	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
22017	2	16.8	-----	6.1	10.2	12.2	A	--	B	A	A	100
22028	2	17.0	-----	6.0	10.3	12.3	A	--	A	A	B	92.9
23003	2	16.9	-----	5.9	10.3	12.2	A	--	A	A	A	100
23008	2	16.4	12.2	-----	10.3	12.1	B	A	--	A	A	100
23011	9	16.4	-----	6.0	10.4	12.1	B	--	A	B	A	92.9
23015	2	16.7	-----	5.9	10.1	11.8	A	--	A	A	A	100
23016	2	16.9	-----	5.9	10.3	12.2	A	--	A	A	A	100
23017	2	16.7	-----	6.0	10.4	12.2	A	--	A	B	A	92.9
23019	2	17.0	12.6	-----	10.3	12.2	A	A	--	A	A	100
23024	2	16.7	12.5	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
23067	2	16.8	12.5	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
24012	2	16.8	-----	5.9	10.0	11.9	A	--	A	A	A	100
25003	2	16.8	12.5	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
26001	2	16.8	12.5	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
26003	2	16.6	12.3	-----	10.1	11.9	A	A	--	A	A	100
26006	2	16.9	-----	6.1	10.2	12.1	A	--	B	A	A	100
27014	2	16.9	12.5	-----	10.3	12.0	A	A	--	A	A	100
27020	1	16.8	12.6	-----	10.1	12.1	A	A	--	A	A	100
27044	2	16.8	12.4	-----	10.3	12.2	A	A	--	A	A	100
27046	9	16.6	-----	5.9	10.0	12.2	A	--	A	A	A	100
28002	2	16.7	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
28003	2	16.8	12.5	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
28011	2	16.9	12.5	-----	10.7	12.3	A	A	--	C	B	64.3
28016	2	16.9	12.5	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
28017	2	16.8	12.4	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
28031	1	16.7	-----	5.9	10.2	11.8	A	--	A	A	A	100
28034	2	17.0	12.5	-----	10.3	12.1	A	A	--	A	A	100
30004	2	16.6	-----	5.8	10.1	11.8	A	--	B	A	A	100
30005	2	16.8	12.4	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
30006	2	16.9	-----	6.0	10.3	12.1	A	--	A	A	A	100
31005	2	16.4	-----	6.0	10.2	12.1	B	--	A	A	A	100
32001	2	16.8	-----	5.9	10.1	12.0	A	--	A	A	A	100
32002	2	16.9	12.5	-----	10.3	12.2	A	A	--	A	A	100
33001	2	16.8	-----	5.9	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
33005	2	16.9	-----	5.9	10.5	12.1	A	--	A	B	A	85.7
33008	2	16.8	-----	5.8	10.1	11.9	A	--	B	A	A	100

[16] ヘモグロビン量　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定法	測定値					試料No別判定値					総合
コード		試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	1	16.4	-----	5.9	10.3	12.2	B	--	A	A	A	100
34004	2	16.7	-----	5.9	10.1	12.1	A	--	A	A	A	100
34009	2	16.7	12.5	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
34010	2	12.3	16.6	-----	10.1	12.0	D	D	--	A	A	100
34011	9	16.8	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
34012	2	16.8	12.5	-----	10.0	11.9	A	A	--	A	A	100
34015	2	16.7	-----	5.8	10.1	12.0	A	--	B	A	A	100
35001	2	17.0	-----	6.0	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100
39001	2	16.8	-----	5.9	10.1	12.0	A	--	A	A	A	100
39002	2	17.0	12.6	-----	10.2	12.0	A	A	--	A	A	100
39003	2	17.1	-----	6.1	10.3	12.1	A	--	B	A	A	100
39004	2	16.5	-----	5.9	10.1	11.9	A	--	A	A	A	100
40007	2	16.7	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
40009	2	16.8	12.4	-----	10.1	12.1	A	A	--	A	A	100
40027	2	16.8	-----	6.0	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
43001	2	16.9	-----	6.0	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
43003	2	17.0	12.4	-----	10.1	12.0	A	A	--	A	A	100
45002	2	16.8	-----	6.1	10.1	12.2	A	--	B	A	A	100
46004	2	16.8	-----	5.9	10.2	12.0	A	--	A	A	A	100
47001	2	17.0	-----	6.0	10.3	12.2	A	--	A	A	A	100
47004	2	16.5	-----	5.9	10.0	12.0	A	--	A	A	A	100
47005	2	16.8	12.3	-----	10.2	12.1	A	A	--	A	A	100
47006	2	16.8	-----	5.9	10.2	12.1	A	--	A	A	A	100

[17] ヘマトクリット値　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB519	47.1	34.9	-----	32.4	35.1	--	--	--	--	--	=======
01013	JAB517	46.8	35.6	-----	32.6	35.7	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	48.7	37.1	-----	32.5	35.2	A	A	--	--	--	100
01025	JAB517	46.3	35.0	-----	32.6	35.2	A	A	--	--	--	100
01040	JAB517	46.3	-----	16.8	32.6	35.6	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	47.3	-----	17.8	32.5	35.8	--	--	--	--	--	=======
03001	JAB517	49.0	35.9	-----	32.8	35.5	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	48.7	36.8	-----	32.2	35.7	A	A	--	--	--	100
04004	JAB517	47.3	-----	17.2	33.3	36.2	A	--	A	--	--	100
04008	JAB517	48.3	-----	17.7	32.5	35.5	A	--	A	--	--	100
04009	JAB521	48.9	36.6	-----	33.2	36.2	A	A	--	--	--	100
04012	JAB517	48.1	-----	16.8	33.1	35.9	A	--	A	--	--	100
04015	JAB517	48.3	-----	17.0	32.7	35.8	A	--	A	--	--	100
08001	JAB517	47.4	-----	17.0	32.3	35.4	A	--	A	--	--	100
08003	JAB517	47.4	-----	17.2	31.8	34.8	A	--	A	--	--	100
08006	JAB517	47.1	35.7	-----	32.4	35.3	A	A	--	--	--	100
08009	JAB517	48.0	-----	17.1	33.0	35.4	A	--	A	--	--	100
08010	JAB517	49.4	-----	17.5	33.1	36.2	A	--	A	--	--	100
09001	JAB521	48.5	36.1	-----	32.6	35.8	A	A	--	--	--	100
09005	JAB517	47.6	35.7	-----	32.4	35.4	A	A	--	--	--	100
09012	JAB512	49.3	37.4	-----	33.7	36.4	A	A	--	--	--	100
09013	JAB521	47.7	-----	17.0	32.4	35.4	A	--	A	--	--	100
10005	JAB517	47.5	35.8	-----	32.5	35.3	A	A	--	--	--	100
10007	JAB517	48.3	-----	17.4	32.5	35.7	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	48.1	-----	17.6	32.5	35.4	A	--	A	--	--	100
11010	JAB517	48.1	-----	17.5	33.1	35.3	A	--	A	--	--	100
11020	JAB517	47.8	35.5	-----	32.4	35.2	A	A	--	--	--	100
11023	JAB514	48.4	36.0	-----	32.4	35.7	--	--	--	--	--	=======
11033	JAB519	47.1	-----	16.9	32.6	35.2	--	--	--	--	--	=======
12001	JAB517	48.2	-----	17.0	32.8	35.4	A	--	A	--	--	100
12002	JAB517	47.0	35.4	-----	32.1	35.1	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	48.0	-----	17.1	32.7	35.9	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	45.9	-----	17.2	31.3	34.6	--	--	--	--	--	=======
12019	JAB514	46.8	35.4	-----	32.3	35.2	--	--	--	--	--	=======
13002	JAB514	47.1	-----	17.8	32.2	35.2	--	--	--	--	--	=======
13003	JAB521	47.9	-----	16.9	31.9	35.3	A	--	A	--	--	100
13016	JAB517	47.6	35.6	-----	32.1	35.4	A	A	--	--	--	100
13017	JAB517	47.2	35.2	-----	32.3	35.2	A	A	--	--	--	100
13026	JAB521	48.4	35.9	-----	32.0	35.0	A	A	--	--	--	100
13053	JAB512	47.9	-----	17.7	32.3	35.2	A	--	A	--	--	100
13061	JAB521	48.3	-----	17.3	32.5	35.2	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	49.2	-----	18.4	32.5	35.6	A	--	A	--	--	100
13074	JAB517	48.3	36.1	-----	32.3	35.4	A	A	--	--	--	100
13084	JAB514	47.4	-----	17.8	32.0	35.5	--	--	--	--	--	=======
13103	JAB521	48.9	-----	17.4	32.9	35.8	A	--	A	--	--	100
13145	JAS304	49.2	37.9	-----	31.7	35.5	--	--	--	--	--	=======
14001	JAB517	47.8	-----	17.2	33.1	35.7	A	--	A	--	--	100
14003	JAB512	48.4	-----	17.9	32.7	35.7	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	48.7	37.3	-----	33.2	36.1	A	A	--	--	--	100
14025	JAB517	47.4	36.2	-----	32.4	35.3	A	A	--	--	--	100
14030	JAB517	47.4	36.5	-----	32.4	35.5	A	A	--	--	--	100
14046	JAB512	48.5	36.8	-----	32.4	35.5	A	A	--	--	--	100

[17] ヘマトクリット値　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	JAB517	47.3	-----	16.8	32.2	35.3	A	--	A	--	--	100
15006	JAB517	48.8	-----	17.3	33.3	36.2	A	--	A	--	--	100
15011	JAB512	48.4	-----	18.0	32.3	35.8	A	--	A	--	--	100
15012	JAB514	46.4	34.4	-----	31.4	34.3	--	--	--	--	--	======
16002	JAB517	47.1	35.3	-----	31.8	35.0	A	A	--	--	--	100
16006	JAB517	47.2	35.3	-----	32.2	34.8	A	A	--	--	--	100
17001	JAB517	48.1	35.8	-----	32.7	34.9	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	47.9	35.8	-----	32.5	35.1	A	A	--	--	--	100
21002	JAB517	47.2	35.6	-----	32.3	34.7	A	A	--	--	--	100
21005	JAB517	47.3	-----	17.0	32.4	34.8	A	--	A	--	--	100
21006	JAB517	47.6	36.2	-----	31.8	35.2	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	46.6	35.3	-----	32.2	35.3	--	--	--	--	--	======
22003	JAB521	48.5	36.3	-----	32.8	35.3	A	A	--	--	--	100
22004	JAB521	48.1	36.0	-----	32.0	35.2	A	A	--	--	--	100
22006	JAB517	47.7	35.6	-----	32.7	35.4	A	A	--	--	--	100
22012	JAB517	47.8	-----	17.1	32.4	35.1	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	46.1	-----	17.1	31.8	34.7	--	--	--	--	--	======
22028	JAB516	47.7	-----	17.4	32.2	35.4	--	--	--	--	--	======
23003	JAB521	47.5	-----	16.7	33.1	35.8	A	--	A	--	--	100
23008	JAJ012	49.0	36.6	-----	31.6	35.4	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	49.1	-----	17.9	32.4	35.8	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	48.0	-----	16.9	32.5	35.8	A	--	A	--	--	100
23016	JAB517	47.5	-----	16.7	33.0	35.9	A	--	A	--	--	100
23017	JAB517	47.5	-----	16.9	32.3	35.1	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	48.7	36.4	-----	33.5	36.6	A	A	--	--	--	100
23024	JAB517	46.8	35.0	-----	32.2	35.0	A	A	--	--	--	100
23067	JAB521	48.4	35.4	-----	32.6	35.3	A	A	--	--	--	100
24012	JAB512	47.7	-----	17.1	32.4	35.7	A	--	B	--	--	92.9
25003	JAB517	47.2	36.0	-----	32.4	34.8	A	A	--	--	--	100
26001	JAB517	48.2	36.2	-----	32.6	35.5	A	A	--	--	--	100
26003	JAB517	48.4	36.4	-----	31.5	34.4	A	A	--	--	--	100
26006	JAB517	47.9	-----	17.4	32.5	35.5	A	--	A	--	--	100
27014	JAB521	49.1	36.8	-----	32.7	35.1	A	A	--	--	--	100
27020	JAB517	47.1	35.4	-----	31.9	35.0	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	47.1	35.2	-----	32.5	35.4	A	A	--	--	--	100
27046	JAB517	46.2	-----	16.6	31.7	35.6	A	--	A	--	--	100
28002	JAB517	48.9	-----	17.7	31.9	35.8	A	--	A	--	--	100
28003	JAB521	48.1	36.0	-----	31.7	34.5	A	A	--	--	--	100
28011	JAJ803	45.2	33.1	-----	34.6	36.7	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	47.8	36.5	-----	32.2	35.2	A	A	--	--	--	100
28017	JAB521	47.7	35.7	-----	32.4	35.3	A	A	--	--	--	100
28031	JAB517	46.5	-----	16.8	32.0	34.8	A	--	A	--	--	100
28034	JAB512	48.0	36.0	-----	32.0	35.4	A	A	--	--	--	100
30004	JAB517	47.1	-----	16.7	32.3	34.9	A	--	A	--	--	100
30005	JAB517	48.4	35.9	-----	32.8	36.0	A	A	--	--	--	100
30006	JAB519	47.9	-----	17.1	32.4	35.4	--	--	--	--	--	======
31005	JAB517	46.1	-----	16.8	32.2	34.9	A	--	A	--	--	100
32001	JAB521	49.1	-----	17.9	33.4	36.1	A	--	A	--	--	100
32002	JAB519	47.3	35.0	-----	32.1	34.4	--	--	--	--	--	======
33001	JAB517	47.6	-----	17.0	32.7	35.4	A	--	A	--	--	100
33005	JAB517	47.9	-----	17.0	32.8	36.1	A	--	A	--	--	100
33008	JAB517	48.0	-----	16.8	32.4	34.9	A	--	A	--	--	100

[17] ヘマトクリット値　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	JAJ012	49.3	-----	17.9	32.0	36.0	--	--	--	--	--	=======
34004	JAB517	47.1	-----	16.9	31.6	35.1	A	--	A	--	--	100
34009	JAB517	47.1	35.1	-----	32.6	35.0	A	A	--	--	--	100
34010	JAB519	34.3	46.2	-----	31.9	34.9	--	--	--	--	--	=======
34011	JAB517	48.9	-----	17.5	32.7	36.4	A	--	A	--	--	100
34012	JAB521	48.2	36.2	-----	32.4	35.2	A	A	--	--	--	100
34015	JAB517	47.1	-----	16.7	32.2	34.9	A	--	A	--	--	100
35001	JAB521	47.8	-----	17.2	32.0	35.1	A	--	A	--	--	100
39001	JAB517	46.0	-----	16.5	31.5	34.4	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	48.5	36.5	-----	32.6	35.5	A	A	--	--	--	100
39003	JAB512	49.3	-----	18.2	32.0	35.4	A	--	A	--	--	100
39004	JAB517	48.2	-----	17.7	33.4	36.6	A	--	A	--	--	100
40007	JAB517	48.5	-----	17.3	33.2	35.7	A	--	A	--	--	100
40009	JAB521	48.0	35.8	-----	32.9	35.8	A	A	--	--	--	100
40027	JAB517	47.5	-----	17.4	32.5	35.6	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	47.8	-----	17.2	32.2	35.3	A	--	A	--	--	100
43003	JAB517	47.6	35.5	-----	31.7	35.0	A	A	--	--	--	100
45002	JAB517	48.6	-----	17.9	31.9	36.2	A	--	B	--	--	92.9
46004	JAB517	48.2	-----	17.3	32.8	35.6	A	--	A	--	--	100
47001	JAB517	46.7	-----	16.6	31.8	35.5	A	--	A	--	--	100
47004	JAB517	47.3	-----	17.3	32.8	35.7	A	--	A	--	--	100
47005	JAB517	45.3	34.3	-----	31.3	34.5	B	A	--	--	--	92.9
47006	JAB517	47.2	-----	16.7	32.6	35.9	A	--	A	--	--	100

[18] 白血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB519	32	71	-----	85	36	--	--	--	--	--	=======
01013	JAB517	31	69	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	31	74	-----	91	37	A	A	--	--	--	100
01025	JAB517	32	67	-----	89	39	A	A	--	--	--	100
01040	JAB517	31	-----	77	90	37	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	34	-----	81	89	37	--	--	--	--	--	=======
03001	JAB517	32	69	-----	87	36	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	31	69	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
04004	JAB517	31	-----	79	88	38	A	--	A	--	--	100
04008	JAB517	32	-----	79	89	38	A	--	A	--	--	100
04009	JAB521	31	67	-----	86	37	A	A	--	--	--	100
04012	JAB517	31	-----	79	91	36	A	--	A	--	--	100
04015	JAB517	32	-----	79	88	37	A	--	A	--	--	100
08001	JAB517	31	-----	78	89	37	A	--	A	--	--	100
08003	JAB517	32	-----	77	90	37	A	--	A	--	--	100
08006	JAB517	32	68	-----	88	36	A	A	--	--	--	100
08009	JAB517	31	-----	75	86	36	A	--	A	--	--	100
08010	JAB517	32	-----	77	88	37	A	--	A	--	--	100
09001	JAB521	31	66	-----	90	37	A	A	--	--	--	100
09005	JAB517	32	67	-----	90	38	A	A	--	--	--	100
09012	JAB512	31	72	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
09013	JAB521	31	-----	77	87	36	A	--	A	--	--	100
10005	JAB517	32	72	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
10007	JAB517	32	-----	79	89	37	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	31	-----	80	90	38	A	--	A	--	--	100
11010	JAB517	31	-----	77	88	37	A	--	A	--	--	100
11020	JAB517	31	66	-----	89	36	A	A	--	--	--	100
11023	JAB514	32	70	-----	87	37	--	--	--	--	--	=======
11033	JAB519	32	-----	77	88	37	--	--	--	--	--	=======
12001	JAB517	32	-----	79	91	37	A	--	A	--	--	100
12002	JAB517	31	69	-----	90	37	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	31	-----	76	87	37	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	33	-----	79	86	37	--	--	--	--	--	=======
12019	JAB514	34	71	-----	86	36	--	--	--	--	--	=======
13002	JAB514	32	-----	81	91	38	--	--	--	--	--	=======
13003	JAB521	32	-----	79	88	37	A	--	A	--	--	100
13016	JAB517	32	69	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
13017	JAB517	32	69	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
13026	JAB521	30	66	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
13053	JAB512	31	-----	80	90	38	A	--	A	--	--	100
13061	JAB521	31	-----	79	89	37	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	31	-----	79	91	37	A	--	A	--	--	100
13074	JAB517	31	68	-----	86	36	A	A	--	--	--	100
13084	JAB514	31	-----	79	91	39	--	--	--	--	--	=======
13103	JAB521	32	-----	79	89	37	A	--	A	--	--	100
13145	JAS304	32	71	-----	87	36	--	--	--	--	--	=======
14001	JAB517	32	-----	79	90	36	A	--	A	--	--	100
14003	JAB512	31	-----	80	90	37	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	31	72	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
14025	JAB517	31	71	-----	88	38	A	A	--	--	--	100
14030	JAB517	32	69	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
14046	JAB512	33	75	-----	88	39	A	A	--	--	--	100

[18] 白血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	JAB517	32	-----	78	90	37	A	--	A	--	--	100
15006	JAB517	31	-----	78	88	38	A	--	A	--	--	100
15011	JAB512	31	-----	82	87	38	A	--	A	--	--	100
15012	JAB514	34	74	-----	91	37	--	--	--	--	--	=======
16002	JAB517	32	70	-----	91	37	A	A	--	--	--	100
16006	JAB517	32	69	-----	88	36	A	A	--	--	--	100
17001	JAB517	30	67	-----	86	36	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	32	69	-----	89	38	A	A	--	--	--	100
21002	JAB517	32	69	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
21005	JAB517	31	-----	78	88	37	A	--	A	--	--	100
21006	JAB517	32	69	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	33	73	-----	89	37	--	--	--	--	--	=======
22003	JAB521	31	68	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
22004	JAB521	31	66	-----	85	36	A	A	--	--	--	100
22006	JAB517	32	69	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
22012	JAB517	32	-----	78	88	37	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	34	-----	77	86	37	--	--	--	--	--	=======
22028	JAB516	32	-----	77	87	38	--	--	--	--	--	=======
23003	JAB521	31	-----	77	85	36	A	--	A	--	--	100
23008	JAJ012	32	73	-----	82	34	--	--	--	--	--	=======
23011	JAJ012	33	-----	80	79	34	--	--	--	--	--	=======
23015	JAB517	31	-----	75	88	37	A	--	A	--	--	100
23016	JAB517	31	-----	77	85	36	A	--	A	--	--	100
23017	JAB517	32	-----	79	90	38	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	32	70	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
23024	JAB517	32	68	-----	82	34	A	A	--	--	--	100
23067	JAB521	32	69	-----	86	36	A	A	--	--	--	100
24012	JAB512	32	-----	76	79	32	A	--	A	--	--	100
25003	JAB517	32	71	-----	87	36	A	A	--	--	--	100
26001	JAB517	32	70	-----	90	37	A	A	--	--	--	100
26003	JAB517	32	69	-----	85	37	A	A	--	--	--	100
26006	JAB517	31	-----	78	87	37	A	--	A	--	--	100
27014	JAB521	32	68	-----	88	36	A	A	--	--	--	100
27020	JAB517	32	68	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	32	69	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
27046	JAB517	32	-----	80	89	38	A	--	A	--	--	100
28002	JAB517	32	-----	79	87	38	A	--	A	--	--	100
28003	JAB521	32	66	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
28011	JAJ803	33	67	-----	82	35	--	--	--	--	--	=======
28016	JAB512	31	73	-----	91	38	A	A	--	--	--	100
28017	JAB521	31	69	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
28031	JAB517	32	-----	80	92	39	A	--	A	--	--	100
28034	JAB512	31	70	-----	89	37	A	A	--	--	--	100
30004	JAB517	32	-----	80	83	35	A	--	A	--	--	100
30005	JAB517	31	68	-----	90	36	A	A	--	--	--	100
30006	JAB519	33	-----	79	89	37	--	--	--	--	--	=======
31005	JAB517	32	-----	78	89	37	A	--	A	--	--	100
32001	JAB521	32	-----	79	88	38	A	--	A	--	--	100
32002	JAB519	32	71	-----	87	35	--	--	--	--	--	=======
33001	JAB517	31	-----	78	90	37	A	--	A	--	--	100
33005	JAB517	31	-----	75	86	37	A	--	A	--	--	100
33008	JAB517	33	-----	80	91	37	A	--	A	--	--	100

[18] 白血球数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	JAJ012	32	-----	79	86	37	--	--	--	--	--	======
34004	JAB517	32	-----	79	89	38	A	--	A	--	--	100
34009	JAB517	31	69	-----	90	37	A	A	--	--	--	100
34010	JAB519	73	32	-----	88	38	--	--	--	--	--	======
34011	JAB517	32	-----	79	90	38	A	--	A	--	--	100
34012	JAB521	31	68	-----	87	37	A	A	--	--	--	100
34015	JAB517	31	-----	77	88	36	A	--	A	--	--	100
35001	JAB521	31	-----	77	88	38	A	--	A	--	--	100
39001	JAB517	32	-----	79	90	37	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	31	73	-----	92	37	A	A	--	--	--	100
39003	JAB512	32	-----	79	90	38	A	--	A	--	--	100
39004	JAB517	30	-----	76	88	38	A	--	A	--	--	100
40007	JAB517	31	-----	76	89	37	A	--	A	--	--	100
40009	JAB521	32	69	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
40027	JAB517	31	-----	77	88	36	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	32	-----	78	89	37	A	--	A	--	--	100
43003	JAB517	30	69	-----	87	36	A	A	--	--	--	100
45002	JAB517	32	-----	82	89	39	A	--	A	--	--	100
46004	JAB517	30	-----	77	88	37	A	--	A	--	--	100
47001	JAB517	31	-----	77	89	37	A	--	A	--	--	100
47004	JAB517	31	-----	78	89	36	A	--	A	--	--	100
47005	JAB517	31	66	-----	88	37	A	A	--	--	--	100
47006	JAB517	31	-----	76	89	37	A	--	A	--	--	100

[19] 血小板数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB519	14.6	24.6	-----	36.9	18.7	--	--	--	--	--	=======
01013	JAB517	13.4	21.6	-----	36.1	18.8	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	13.0	23.5	-----	37.2	18.8	A	A	--	--	--	100
01025	JAB517	13.2	24.0	-----	35.5	18.3	A	A	--	--	--	100
01040	JAB517	13.8	-----	34.1	35.6	18.6	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	13.4	-----	34.5	38.4	19.4	--	--	--	--	--	=======
03001	JAB517	13.5	22.5	-----	36.2	18.9	A	A	--	--	--	100
03006	JAB517	13.1	23.1	-----	35.9	17.7	A	A	--	--	--	100
04004	JAB517	13.6	-----	33.0	35.4	18.7	A	--	A	--	--	100
04008	JAB517	13.3	-----	33.0	35.4	18.2	A	--	A	--	--	100
04009	JAB521	13.2	22.8	-----	34.6	18.4	A	A	--	--	--	100
04012	JAB517	13.5	-----	32.2	35.3	17.8	A	--	A	--	--	100
04015	JAB517	13.7	-----	33.6	35.4	18.2	A	--	A	--	--	100
08001	JAB517	12.8	-----	30.9	34.5	17.3	A	--	A	--	--	100
08003	JAB517	13.4	-----	31.9	34.2	18.4	A	--	A	--	--	100
08006	JAB517	13.5	22.8	-----	35.2	18.9	A	A	--	--	--	100
08009	JAB517	13.0	-----	31.5	34.5	18.3	A	--	A	--	--	100
08010	JAB517	13.4	-----	31.5	33.8	17.4	A	--	A	--	--	100
09001	JAB521	13.5	22.1	-----	34.9	18.5	A	A	--	--	--	100
09005	JAB517	14.0	25.3	-----	36.4	18.1	A	B	--	--	--	78.6
09012	JAB512	13.3	23.0	-----	38.0	19.5	A	A	--	--	--	100
09013	JAB521	13.8	-----	30.9	35.7	18.1	A	--	B	--	--	92.9
10005	JAB517	13.8	23.3	-----	36.2	18.6	A	A	--	--	--	100
10007	JAB517	13.0	-----	31.4	34.3	18.3	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	13.1	-----	36.2	38.5	19.6	A	--	A	--	--	100
11010	JAB517	13.6	-----	32.5	34.6	18.5	A	--	A	--	--	100
11020	JAB517	13.4	21.5	-----	34.8	18.7	A	A	--	--	--	100
11023	JAB514	13.1	22.3	-----	35.0	18.4	--	--	--	--	--	=======
11033	JAB519	13.4	-----	30.4	34.7	17.7	--	--	--	--	--	=======
12001	JAB517	13.4	-----	33.3	34.7	18.4	A	--	A	--	--	100
12002	JAB517	13.8	23.3	-----	34.3	17.3	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	13.7	-----	31.4	35.0	18.3	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	13.1	-----	33.7	36.6	18.6	--	--	--	--	--	=======
12019	JAB514	13.1	22.3	-----	34.8	17.8	--	--	--	--	--	=======
13002	JAB514	13.2	-----	35.6	37.4	18.5	--	--	--	--	--	=======
13003	JAB521	13.9	-----	35.1	35.8	18.5	A	--	A	--	--	100
13016	JAB517	12.9	22.9	-----	35.6	17.8	A	A	--	--	--	100
13017	JAB517	13.5	22.7	-----	35.7	18.2	A	A	--	--	--	100
13026	JAB521	13.2	22.5	-----	34.8	17.5	A	A	--	--	--	100
13053	JAB512	12.7	-----	36.2	36.2	19.2	A	--	A	--	--	100
13061	JAB521	13.4	-----	33.7	34.6	18.3	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	13.3	-----	36.7	37.9	19.8	A	--	A	--	--	100
13074	JAB517	13.2	22.5	-----	33.6	18.1	A	A	--	--	--	100
13084	JAB514	47.4	-----	17.8	36.7	18.6	--	--	--	--	--	=======
13103	JAB521	13.3	-----	35.0	34.5	18.3	A	--	A	--	--	100
13145	JAS304	15.5	25.5	-----	36.3	18.8	--	--	--	--	--	=======
14001	JAB517	13.5	-----	34.3	35.0	17.7	A	--	A	--	--	100
14003	JAB512	13.1	-----	36.2	37.1	19.4	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	13.2	23.0	-----	37.4	18.8	A	A	--	--	--	100
14025	JAB517	13.2	22.8	-----	34.8	18.4	A	A	--	--	--	100
14030	JAB517	13.4	23.3	-----	36.7	18.0	A	A	--	--	--	100
14046	JAB512	13.4	23.1	-----	37.0	19.4	A	A	--	--	--	100

[19] 血小板数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	JAB517	13.5	-----	31.3	34.3	17.8	A	--	A	--	--	100
15006	JAB517	13.8	-----	31.3	35.5	18.3	A	--	A	--	--	100
15011	JAB512	13.7	-----	35.3	36.9	18.9	A	--	A	--	--	100
15012	JAB514	13.0	23.1	-----	35.2	17.6	--	--	--	--	--	======
16002	JAB517	13.9	23.3	-----	35.5	18.7	A	A	--	--	--	100
16006	JAB517	13.0	22.3	-----	35.5	18.5	A	A	--	--	--	100
17001	JAB517	13.6	23.0	-----	35.9	18.4	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	14.1	23.2	-----	35.3	18.6	A	A	--	--	--	100
21002	JAB517	13.4	23.0	-----	34.1	17.8	A	A	--	--	--	100
21005	JAB517	13.3	-----	33.8	34.7	17.9	A	--	A	--	--	100
21006	JAB517	13.8	22.6	-----	34.9	18.2	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	13.8	23.4	-----	36.4	19.2	--	--	--	--	--	======
22003	JAB521	13.9	23.1	-----	35.5	18.4	A	A	--	--	--	100
22004	JAB521	14.0	24.1	-----	36.5	18.2	A	A	--	--	--	100
22006	JAB517	13.4	22.2	-----	36.3	18.5	A	A	--	--	--	100
22012	JAB517	13.4	-----	34.0	34.7	17.9	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	13.4	-----	33.7	37.2	18.7	--	--	--	--	--	======
22028	JAB516	12.9	-----	33.6	36.3	18.1	--	--	--	--	--	======
23003	JAB521	13.4	-----	33.2	35.6	18.6	A	--	A	--	--	100
23008	JAJ012	12.5	21.8	-----	32.5	17.2	--	--	--	--	--	======
23011	JAJ012	12.6	-----	32.4	33.8	17.8	--	--	--	--	--	======
23015	JAB517	13.1	-----	30.8	34.6	18.0	A	--	A	--	--	100
23016	JAB517	13.4	-----	33.1	35.7	18.4	A	--	A	--	--	100
23017	JAB517	13.3	-----	33.0	34.7	18.2	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	13.6	23.1	-----	34.0	17.4	A	A	--	--	--	100
23024	JAB517	13.5	23.2	-----	34.4	17.6	A	A	--	--	--	100
23067	JAB521	13.4	25.0	-----	34.4	18.2	A	B	--	--	--	92.9
24012	JAB512	13.4	-----	33.1	34.7	18.4	A	--	B	--	--	85.7
25003	JAB517	13.5	22.5	-----	34.3	18.0	A	A	--	--	--	100
26001	JAB517	13.8	23.9	-----	35.8	18.2	A	A	--	--	--	100
26003	JAB517	13.6	21.4	-----	35.1	18.0	A	A	--	--	--	100
26006	JAB517	13.8	-----	34.9	35.7	19.0	A	--	B	--	--	92.9
27014	JAB521	13.5	22.9	-----	34.5	17.8	A	A	--	--	--	100
27020	JAB517	13.3	22.9	-----	34.3	17.9	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	13.4	22.5	-----	34.8	18.1	A	A	--	--	--	100
27046	JAB517	13.5	-----	32.0	34.4	17.6	A	--	A	--	--	100
28002	JAB517	13.6	-----	33.6	35.4	18.4	A	--	A	--	--	100
28003	JAB521	13.4	23.5	-----	34.5	18.0	A	A	--	--	--	100
28011	JAJ803	11.3	19.4	-----	36.3	18.2	--	--	--	--	--	======
28016	JAB512	12.9	22.4	-----	36.5	19.5	A	A	--	--	--	100
28017	JAB521	13.5	23.1	-----	34.3	17.8	A	A	--	--	--	100
28031	JAB517	12.9	-----	32.3	34.4	17.6	A	--	A	--	--	100
28034	JAB512	13.2	23.3	-----	37.0	18.8	A	A	--	--	--	100
30004	JAB517	13.6	-----	32.8	34.1	17.5	A	--	A	--	--	100
30005	JAB517	13.1	22.4	-----	33.6	17.0	A	A	--	--	--	100
30006	JAB519	13.4	-----	33.3	34.5	18.2	--	--	--	--	--	======
31005	JAB517	13.5	-----	34.9	36.4	19.0	A	--	B	--	--	92.9
32001	JAB521	13.4	-----	34.6	35.6	18.2	A	--	A	--	--	100
32002	JAB519	13.7	24.2	-----	35.7	18.9	--	--	--	--	--	======
33001	JAB517	14.0	-----	32.8	34.4	17.5	A	--	A	--	--	100
33005	JAB517	13.3	-----	32.3	35.6	17.9	A	--	A	--	--	100
33008	JAB517	14.0	-----	32.7	35.1	18.4	A	--	A	--	--	100

[19] 血小板数　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	JAJ012	12.4	-----	31.7	33.4	17.8	--	--	--	--	--	=======
34004	JAB517	14.3	-----	30.2	34.1	19.3	A	--	B	--	--	92.9
34009	JAB517	13.4	23.4	-----	35.9	18.1	A	A	--	--	--	100
34010	JAB519	22.2	13.7	-----	34.9	18.7	--	--	--	--	--	=======
34011	JAB517	13.9	-----	31.6	35.7	18.5	A	--	A	--	--	100
34012	JAB521	13.7	23.7	-----	35.3	18.1	A	A	--	--	--	100
34015	JAB517	12.8	-----	31.8	34.3	18.2	A	--	A	--	--	100
35001	JAB521	13.1	-----	31.7	34.5	17.4	A	--	A	--	--	100
39001	JAB517	13.6	-----	32.1	35.0	18.8	A	--	A	--	--	100
39002	JAB512	13.0	23.1	-----	37.0	19.1	A	A	--	--	--	100
39003	JAB512	13.1	-----	35.3	36.1	19.0	A	--	A	--	--	100
39004	JAB517	13.0	-----	33.4	35.4	18.2	A	--	A	--	--	100
40007	JAB517	13.3	-----	33.9	35.2	18.1	A	--	A	--	--	100
40009	JAB521	13.7	22.0	-----	35.2	18.0	A	A	--	--	--	100
40027	JAB517	13.2	-----	32.9	35.4	18.5	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	13.3	-----	31.8	34.7	18.2	A	--	A	--	--	100
43003	JAB517	13.2	21.5	-----	34.7	17.8	A	A	--	--	--	100
45002	JAB517	13.0	-----	32.0	34.7	16.9	A	--	A	--	--	100
46004	JAB517	13.2	-----	31.9	33.1	17.4	A	--	A	--	--	100
47001	JAB517	0.2	-----	0.7	35.5	18.5	D	--	D	--	--	0.0
47004	JAB517	13.5	-----	30.9	36.4	18.6	A	--	A	--	--	100
47005	JAB517	12.3	21.5	-----	34.0	17.5	B	A	--	--	--	85.7
47006	JAB517	13.1	-----	30.9	34.9	17.1	A	--	A	--	--	100

［20］ 平均赤血球容積　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測　定　値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
01001	JAB519	87.2	78.6	-----	86.6	97.2	--	--	--	--	--	=======
01013	JAB517	88.6	79.5	-----	87.9	97.8	A	A	--	--	--	100
01018	JAB512	91.0	81.8	-----	87.4	97.1	A	A	--	--	--	100
01025	JAB517	88.2	79.2	-----	86.9	97.2	A	A	--	--	--	100
01040	JAB517	88.0	-----	69.4	87.4	97.5	A	--	A	--	--	100
02004	JAB514	90.0	-----	73.0	88.0	99.0	--	--	--	--	--	=======
03001	JAB517	92.5	81.3	-----	87.4	97.7	B	A	--	--	--	85.7
03006	JAB517	91.7	82.9	-----	88.2	98.3	B	B	--	--	--	78.6
04004	JAB517	90.1	-----	70.8	89.0	100.0	A	--	A	--	--	100
04008	JAB517	90.4	-----	71.7	88.6	98.1	A	--	A	--	--	100
04009	JAB521	90.7	82.1	-----	88.8	99.7	A	A	--	--	--	100
04012	JAB517	89.9	-----	70.6	89.0	97.8	A	--	A	--	--	100
04015	JAB517	89.4	-----	70.7	87.2	97.5	A	--	A	--	--	100
08001	JAB517	90.1	-----	70.8	87.8	99.7	A	--	A	--	--	100
08003	JAB517	90.1	-----	71.4	85.7	96.9	A	--	A	--	--	100
08006	JAB517	89.5	80.4	-----	87.2	97.5	A	A	--	--	--	100
08009	JAB517	89.7	-----	70.1	87.5	96.7	A	--	A	--	--	100
08010	JAB517	92.0	-----	72.3	89.7	100.3	B	--	B	--	--	85.7
09001	JAB521	89.7	80.7	-----	88.3	98.9	A	A	--	--	--	100
09005	JAB517	89.1	80.0	-----	86.2	97.0	A	A	--	--	--	100
09012	JAB512	92.1	82.6	-----	88.9	98.9	A	A	--	--	--	100
09013	JAB521	89.2	-----	70.0	86.4	98.6	A	--	A	--	--	100
10005	JAB517	88.8	79.9	-----	87.7	97.7	A	A	--	--	--	100
10007	JAB517	90.4	-----	71.3	89.0	98.1	A	--	A	--	--	100
11006	JAB512	89.9	-----	70.4	86.7	97.0	A	--	A	--	--	100
11010	JAB517	90.6	-----	72.6	89.2	98.3	A	--	B	--	--	92.9
11020	JAB517	88.4	80.0	-----	85.3	96.4	A	A	--	--	--	100
11023	JAB514	90.3	80.5	-----	87.3	97.5	--	--	--	--	--	=======
11033	JAB519	88.5	-----	69.8	87.6	98.6	--	--	--	--	--	=======
12001	JAB517	90.0	-----	70.6	87.4	97.5	A	--	A	--	--	100
12002	JAB517	88.2	79.6	-----	87.7	97.5	A	A	--	--	--	100
12008	JAB517	90.1	-----	71.0	88.6	98.0	A	--	A	--	--	100
12016	JAB514	87.6	-----	70.8	84.6	95.8	--	--	--	--	--	=======
12019	JAB514	89.0	80.5	-----	85.9	97.2	--	--	--	--	--	=======
13002	JAB514	89.0	-----	71.5	86.1	97.2	--	--	--	--	--	=======
13003	JAB521	88.9	-----	69.8	86.0	96.7	A	--	A	--	--	100
13016	JAB517	89.6	80.2	-----	89.4	97.8	A	A	--	--	--	100
13017	JAB517	89.6	80.4	-----	89.7	97.8	A	A	--	--	--	100
13026	JAB521	89.5	80.5	-----	85.8	97.5	A	A	--	--	--	100
13053	JAB512	88.7	-----	70.5	85.0	95.9	A	--	A	--	--	100
13061	JAB521	89.0	-----	70.3	87.4	97.5	A	--	A	--	--	100
13064	JAB512	91.6	-----	72.7	86.7	97.0	A	--	A	--	--	100
13074	JAB517	90.4	81.3	-----	92.6	98.9	A	A	--	--	--	100
13084	JAB514	88.4	-----	71.5	85.8	98.1	--	--	--	--	--	=======
13103	JAB521	90.2	-----	71.0	88.4	98.4	A	--	A	--	--	100
13145	JAS304	95.2	84.9	-----	83.4	97.5	--	--	--	--	--	=======
14001	JAB517	90.2	-----	71.7	88.7	98.9	A	--	A	--	--	100
14003	JAB512	90.6	-----	71.6	87.4	98.1	A	--	A	--	--	100
14010	JAB512	91.5	82.7	-----	89.5	98.6	A	A	--	--	--	100
14025	JAB517	90.4	80.6	-----	90.0	97.3	A	A	--	--	--	100
14030	JAB517	91.0	82.4	-----	87.3	98.6	A	B	--	--	--	92.9
14046	JAB512	90.5	81.4	-----	85.3	96.2	A	A	--	--	--	100

[20] 平均赤血球容積　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
15001	JAB517	88.6	-----	69.4	85.9	97.8	A	--	A	--	--	100
15006	JAB517	91.0	-----	71.8	88.3	98.4	A	--	A	--	--	100
15011	JAB512	90.0	-----	70.9	85.9	96.0	A	--	A	--	--	100
15012	JAB514	88.0	78.7	-----	85.3	96.6	--	--	--	--	--	=======
16002	JAB517	89.5	80.0	-----	87.6	96.7	A	A	--	--	--	100
16006	JAB517	87.9	78.3	-----	86.1	96.9	A	B	--	--	--	92.9
17001	JAB517	89.3	80.4	-----	87.5	95.9	A	A	--	--	--	100
18001	JAB517	90.0	80.6	-----	87.8	98.0	A	A	--	--	--	100
21002	JAB517	89.4	80.4	-----	87.3	95.9	A	A	--	--	--	100
21005	JAB517	89.4	-----	70.5	87.1	96.7	A	--	A	--	--	100
21006	JAB517	89.3	80.3	-----	87.4	97.0	A	A	--	--	--	100
22002	JAB514	88.4	80.0	-----	85.9	97.2	--	--	--	--	--	=======
22003	JAB521	90.2	80.6	-----	88.4	97.5	A	A	--	--	--	100
22004	JAB521	89.1	80.4	-----	85.8	95.9	A	A	--	--	--	100
22006	JAB517	89.0	79.9	-----	87.8	97.8	A	A	--	--	--	100
22012	JAB517	89.8	-----	71.0	87.1	97.0	A	--	A	--	--	100
22017	JAB514	87.1	-----	70.1	84.8	95.9	--	--	--	--	--	=======
22028	JAB516	89.3	-----	71.6	85.9	96.7	--	--	--	--	--	=======
23003	JAB521	89.1	-----	69.4	88.7	97.8	A	--	A	--	--	100
23008	JAJ012	93.9	84.4	-----	84.6	99.0	--	--	--	--	--	=======
23011	JAJ012	95.0	-----	75.2	85.5	100.3	--	--	--	--	--	=======
23015	JAB517	90.1	-----	70.1	87.8	99.4	A	--	A	--	--	100
23016	JAB517	88.9	-----	69.8	88.2	98.5	A	--	A	--	--	100
23017	JAB517	88.6	-----	70.1	85.8	95.7	A	--	A	--	--	100
23019	JAB517	89.8	80.9	-----	88.0	99.2	A	A	--	--	--	100
23024	JAB517	88.8	79.4	-----	86.3	97.0	A	A	--	--	--	100
23067	JAB521	89.3	80.3	-----	87.9	97.0	A	A	--	--	--	100
24012	JAB512	88.3	-----	69.8	85.9	97.3	B	--	A	--	--	92.9
25003	JAB517	88.7	80.9	-----	87.6	96.4	A	A	--	--	--	100
26001	JAB517	90.1	81.7	-----	86.5	97.5	A	A	--	--	--	100
26003	JAB517	90.1	81.4	-----	90.5	95.8	A	A	--	--	--	100
26006	JAB517	89.3	-----	71.0	88.6	97.5	A	--	A	--	--	100
27014	JAB521	91.6	82.1	-----	88.6	97.2	A	A	--	--	--	100
27020	JAB517	89.2	80.5	-----	86.4	97.2	A	A	--	--	--	100
27044	JAB517	88.9	79.5	-----	86.9	97.3	A	A	--	--	--	100
27046	JAB517	87.3	-----	68.9	85.4	96.2	B	--	B	--	--	85.7
28002	JAB517	92.3	-----	72.8	92.5	99.2	B	--	B	--	--	78.6
28003	JAB521	90.2	81.1	-----	86.1	95.8	A	A	--	--	--	100
28011	JAJ803	87.6	77.2	-----	92.4	102.7	--	--	--	--	--	=======
28016	JAB512	90.2	81.7	-----	86.3	97.2	A	A	--	--	--	100
28017	JAB521	90.2	81.1	-----	87.6	97.5	A	A	--	--	--	100
28031	JAB517	88.1	-----	70.3	86.5	97.5	A	--	A	--	--	100
28034	JAB512	89.2	79.7	-----	87.0	97.2	A	A	--	--	--	100
30004	JAB517	87.5	-----	69.0	84.8	95.4	A	--	B	--	--	92.9
30005	JAB517	91.4	81.9	-----	87.7	100.3	A	A	--	--	--	100
30006	JAB519	89.2	-----	71.0	85.9	97.8	--	--	--	--	--	=======
31005	JAB517	87.5	-----	68.9	86.8	94.6	A	--	B	--	--	92.9
32001	JAB521	90.9	-----	72.5	89.5	98.9	A	--	B	--	--	92.9
32002	JAB519	87.9	78.7	-----	86.8	96.1	--	--	--	--	--	=======
33001	JAB517	89.3	-----	70.8	87.4	97.8	A	--	A	--	--	100
33005	JAB517	88.5	-----	69.7	86.8	98.1	A	--	A	--	--	100
33008	JAB517	87.9	-----	69.7	86.5	96.1	A	--	A	--	--	100

[20] 平均赤血球容積　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値					試料No別判定値					総合
コード	コード	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５	1	2	3	4	5	評価点
33009	JAJ012	95.0	-----	75.1	86.5	99.3	--	--	--	--	--	=======
34004	JAB517	89.0	-----	70.2	88.3	96.7	A	--	A	--	--	100
34009	JAB517	88.8	79.2	-----	86.8	97.5	A	A	--	--	--	100
34010	JAB519	79.4	88.3	-----	87.2	97.8	--	--	--	--	--	=======
34011	JAB517	90.9	-----	71.7	87.0	99.5	A	--	A	--	--	100
34012	JAB521	89.6	80.7	-----	88.8	98.5	A	A	--	--	--	100
34015	JAB517	89.4	-----	70.2	87.3	98.3	A	--	A	--	--	100
35001	JAB521	90.2	-----	71.0	87.4	96.7	A	--	A	--	--	100
39001	JAB517	87.8	-----	68.8	85.6	95.6	A	--	B	--	--	92.9
39002	JAB512	90.0	80.9	-----	86.0	96.7	A	A	--	--	--	100
39003	JAB512	91.5	-----	72.5	85.1	96.7	A	--	A	--	--	100
39004	JAB517	90.1	-----	72.0	88.8	100.0	A	--	A	--	--	100
40007	JAB517	91.3	-----	72.1	90.0	99.4	A	--	A	--	--	100
40009	JAB521	89.3	80.1	-----	86.8	97.3	A	A	--	--	--	100
40027	JAB517	88.8	-----	71.3	87.1	97.8	A	--	A	--	--	100
43001	JAB517	89.9	-----	70.7	89.4	98.3	A	--	A	--	--	100
43003	JAB517	89.6	80.9	-----	87.8	98.0	A	A	--	--	--	100
45002	JAB517	92.9	-----	73.4	88.6	101.1	B	--	B	--	--	57.1
46004	JAB517	90.9	-----	71.8	88.6	98.9	A	--	A	--	--	100
47001	JAB517	88.1	-----	69.3	87.1	97.6	A	--	A	--	--	100
47004	JAB517	89.9	-----	70.9	87.2	98.1	A	--	A	--	--	100
47005	JAB517	86.5	78.0	-----	85.8	96.1	B	B	--	--	--	78.6
47006	JAB517	88.1	-----	69.3	87.6	98.4	A	--	A	--	--	100

[21] 好中球　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値	
コード	コード	試料４	試料５
01001	JAB519	54.6	59.7
01013	JAB517	54.4	61.4
01018	JAB512	54.6	58.6
01025	JAB517	54.9	60.7
01040	JAB517	54.4	60.6
02004	JAB514	54.6	58.4
03001	JAB517	55.4	61.0
03006	JAB517	54.9	59.4
04004	JAB517	55.8	59.2
04008	JAB517	55.4	59.2
04009	JAB521	54.5	57.2
04012	JAB517	54.5	58.6
04015	JAB517	54.2	60.3
08001	JAB517	54.2	60.6
08003	JAB517	49.0	22.0
08006	JAB517	54.6	58.8
08009	JAB517	52.8	57.7
08010	JAB517	54.3	61.4
09001	JAB521	52.8	57.2
09005	JAB517	55.3	60.9
09012	JAB512	54.1	59.9
09013	JAB521	53.4	59.2
10005	JAB517	54.0	61.5
10007	JAB517	54.4	59.6
11006	JAB512	53.9	58.6
11010	JAB517	54.8	60.7
11020	JAB517	54.4	60.8
11023	JAB514	54.6	59.3
11033	JAB519	54.6	60.2
12001	JAB517	54.9	61.4
12002	JAB517	53.8	59.4
12008	JAB517	53.7	59.9
12016	JAB514	54.2	61.1
12019	JAB514	55.3	60.0
13002	JAB514	53.8	60.9
13003	JAB521	53.3	57.5
13016	JAB517	54.0	60.0
13017	JAB517	54.5	59.2
13026	JAB521	53.5	58.1
13053	JAB512	54.0	57.8
13061	JAB521	52.9	58.5
13064	JAB512	53.8	60.5
13074	JAB517	54.3	58.5
13084	JAB514	54.9	59.5
13103	JAB521	54.4	59.9
13145	JAS304	69.8	72.1
14001	JAB517	54.7	59.8
14003	JAB512	53.9	59.6
14010	JAB512	53.0	58.8
14025	JAB517	54.5	59.1
14030	JAB517	54.7	60.8
14046	JAB512	55.0	60.1
15001	JAB517	54.1	58.8
15006	JAB517	53.6	56.9
15011	JAB512	52.1	58.5
15012	JAB514	55.7	61.2
16002	JAB517	55.2	59.9
16006	JAB517	53.5	58.9
17001	JAB517	54.4	58.6
18001	JAB517	54.1	57.7
21002	JAB517	55.2	60.3
21005	JAB517	54.7	59.8
21006	JAB517	54.2	59.5
22002	JAB514	54.8	57.9
22003	JAB521	53.5	58.3
22004	JAB521	54.0	58.4
22006	JAB517	54.4	60.0
22012	JAB517	55.0	60.4
22017	JAB514	56.7	60.4
22028	JAB516	55.2	60.0
23003	JAB521	51.7	55.8
23008	JAJ012	53.6	53.8
23011	JAJ012	51.3	50.3
23015	JAB517	52.3	58.0
23016	JAB517	51.6	55.7
23017	JAB517	53.0	57.7
23019	JAB517	53.3	57.1
23024	JAB517	51.8	56.7
23067	JAB521	52.5	58.3
24012	JAB512	49.0	54.1
25003	JAB517	52.2	56.9
26001	JAB517	54.2	61.0
26006	JAB517	55.3	59.1
27014	JAB521	54.3	58.1
27020	JAB517	55.0	58.5
27044	JAB517	54.7	61.2
27046	JAB517	53.9	59.8
28002	JAB517	54.4	61.6
28003	JAB521	52.8	57.5
28011	JAJ803	55.1	58.8
28016	JAB512	54.0	58.8
28017	JAB521	53.2	57.7
28031	JAB517	50.2	23.4
28034	JAB512	52.5	57.0
30004	JAB517	52.1	58.2
30005	JAB517	53.7	59.3
30006	JAB519	53.9	58.4
31005	JAB517	50.9	55.0
32001	JAB521	53.2	56.8
32002	JAB519	54.1	57.3
33001	JAB517	54.7	59.9
33005	JAB517	53.1	58.8
33008	JAB517	54.7	59.8
33009	JAJ012	58.0	61.8
34004	JAB517	54.3	60.6
34009	JAB517	54.1	58.2
34010	JAB519	53.3	59.5
34011	JAB517	54.8	59.6
34012	JAB521	53.2	58.5
34015	JAB517	53.9	60.3
35001	JAB521	52.8	58.9
39001	JAB517	55.9	59.5
39002	JAB512	55.0	59.9
39003	JAB512	54.2	58.8
39004	JAB517	54.5	58.9
40007	JAB517	54.8	60.6
40009	JAB521	53.5	58.9
40027	JAB517	54.2	59.1
43001	JAB517	54.9	60.5
43003	JAB517	53.7	58.3
45002	JAB517	55.3	58.2
46004	JAB517	54.9	60.8
47001	JAB517	54.7	59.7
47004	JAB517	54.8	60.6
47005	JAB517	53.8	61.0
47006	JAB517	55.4	59.3

[21] リンパ球　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値	
コード	コード	試料４	試料５
01001	JAB519	37.5	30.9
01013	JAB517	38.4	29.0
01018	JAB512	38.2	31.5
01025	JAB517	37.3	29.8
01040	JAB517	37.8	29.7
02004	JAB514	37.7	30.6
03001	JAB517	36.9	29.6
03006	JAB517	37.6	30.2
04004	JAB517	36.5	31.5
04008	JAB517	36.9	31.3
04009	JAB521	37.9	32.0
04012	JAB517	38.0	32.1
04015	JAB517	38.3	30.2
08001	JAB517	38.6	30.5
08003	JAB517	34.3	11.0
08006	JAB517	38.0	31.4
08009	JAB517	38.0	31.1
08010	JAB517	37.9	28.9
09001	JAB521	38.5	30.9
09005	JAB517	37.4	30.9
09012	JAB512	38.1	31.1
09013	JAB521	38.1	29.8
10005	JAB517	38.3	29.4
10007	JAB517	38.2	30.8
11006	JAB512	38.5	32.6
11010	JAB517	37.3	30.0
11020	JAB517	38.2	29.8
11023	JAB514	37.3	30.8
11033	JAB519	37.9	30.0
12001	JAB517	37.8	29.2
12002	JAB517	38.5	31.2
12008	JAB517	38.5	31.4
12016	JAB514	37.8	29.0
12019	JAB514	37.7	31.1
13002	JAB514	37.9	28.7
13003	JAB521	37.8	30.7
13016	JAB517	38.5	31.0
13017	JAB517	37.7	31.1
13026	JAB521	37.5	30.6
13053	JAB512	39.5	33.6
13061	JAB521	38.1	29.7
13064	JAB512	38.0	30.5
13074	JAB517	38.2	31.6
13084	JAB514	36.9	30.7
13103	JAB521	38.2	30.7
13145	JAS304	19.3	15.4
14001	JAB517	37.6	30.2
14003	JAB512	39.2	30.7
14010	JAB512	39.5	33.2
14025	JAB517	37.9	30.9
14030	JAB517	37.6	30.0
14046	JAB512	37.7	32.0
15001	JAB517	37.9	30.8
15006	JAB517	37.1	31.3
15011	JAB512	40.1	33.3
15012	JAB514	36.8	28.4
16002	JAB517	37.1	30.8
16006	JAB517	37.2	30.2
17001	JAB517	37.9	31.7
18001	JAB517	37.5	32.0
21002	JAB517	37.3	30.4
21005	JAB517	37.8	30.2
21006	JAB517	37.8	31.2
22002	JAB514	36.6	32.3
22003	JAB521	37.5	30.6
22004	JAB521	36.4	30.6
22006	JAB517	38.3	30.4
22012	JAB517	37.4	30.2
22017	JAB514	35.6	29.5
22028	JAB516	37.3	30.7
23003	JAB521	38.5	32.0
23008	JAJ012	35.6	27.9
23011	JAJ012	37.7	31.8
23015	JAB517	38.1	30.1
23016	JAB517	38.5	32.0
23017	JAB517	38.1	30.6
23019	JAB517	37.3	31.2
23024	JAB517	40.1	32.0
23067	JAB521	38.4	30.9
24012	JAB512	42.1	35.2
25003	JAB517	39.4	32.0
26001	JAB517	38.0	29.7
26006	JAB517	36.5	30.9
27014	JAB521	37.2	30.8
27020	JAB517	37.4	32.0
27044	JAB517	37.8	29.0
27046	JAB517	38.6	30.8
28002	JAB517	37.8	29.3
28003	JAB521	37.6	30.8
28011	JAJ803	33.4	28.7
28016	JAB512	39.4	33.2
28017	JAB521	36.4	30.4
28031	JAB517	35.1	11.4
28034	JAB512	40.1	33.6
30004	JAB517	39.0	31.9
30005	JAB517	38.1	30.6
30006	JAB519	38.4	31.6
31005	JAB517	40.6	34.8
32001	JAB521	38.0	31.6
32002	JAB519	37.9	31.8
33001	JAB517	37.5	30.8
33005	JAB517	38.6	31.2
33008	JAB517	37.5	31.0
33009	JAJ012	32.4	25.9
34004	JAB517	38.3	29.8
34009	JAB517	38.0	31.7
34010	JAB519	38.7	31.3
34011	JAB517	38.1	30.7
34012	JAB521	37.4	29.1
34015	JAB517	38.7	30.0
35001	JAB521	38.2	29.6
39001	JAB517	36.6	30.8
39002	JAB512	37.6	30.0
39003	JAB512	38.5	31.6
39004	JAB517	37.4	31.6
40007	JAB517	37.1	29.6
40009	JAB521	37.7	30.1
40027	JAB517	37.8	30.6
43001	JAB517	37.5	30.0
43003	JAB517	38.0	32.0
45002	JAB517	37.0	31.9
46004	JAB517	37.2	30.2
47001	JAB517	37.7	31.2
47004	JAB517	37.2	29.8
47005	JAB517	38.2	29.6
47006	JAB517	38.4	30.4

[21] 単球　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値	
コード	コード	試料４	試料５
01001	JAB519	4.5	6.9
01013	JAB517	4.3	7.2
01018	JAB512	4.3	8.0
01025	JAB517	4.5	7.1
01040	JAB517	4.4	7.2
02004	JAB514	4.5	7.8
03001	JAB517	4.6	6.9
03006	JAB517	4.5	7.9
04004	JAB517	4.8	7.1
04008	JAB517	4.5	7.3
04009	JAB521	4.4	8.6
04012	JAB517	4.7	6.9
04015	JAB517	4.5	7.1
08001	JAB517	4.0	6.5
08003	JAB517	3.6	2.7
08006	JAB517	4.3	6.8
08009	JAB517	5.9	8.7
08010	JAB517	4.8	7.8
09001	JAB521	5.6	9.8
09005	JAB517	4.4	6.6
09012	JAB512	4.7	7.0
09013	JAB521	5.4	8.7
10005	JAB517	4.5	7.0
10007	JAB517	4.4	7.4
11006	JAB512	4.6	6.3
11010	JAB517	4.6	6.8
11020	JAB517	4.2	7.0
11023	JAB514	5.0	7.1
11033	JAB519	4.4	7.1
12001	JAB517	4.3	7.1
12002	JAB517	4.2	7.5
12008	JAB517	4.8	6.8
12016	JAB514	4.8	7.7
12019	JAB514	4.1	6.7
13002	JAB514	5.1	7.8
13003	JAB521	5.7	9.6
13016	JAB517	4.5	6.8
13017	JAB517	4.4	7.0
13026	JAB521	5.7	8.9
13053	JAB512	3.5	6.0
13061	JAB521	6.1	9.4
13064	JAB512	4.7	7.0
13074	JAB517	4.2	7.4
13084	JAB514	5.1	7.5
13103	JAB521	4.4	6.9
13145	JAS304	6.5	9.5
14001	JAB517	4.5	7.5
14003	JAB512	4.2	7.2
14010	JAB512	4.4	6.3
14025	JAB517	5.0	7.4
14030	JAB517	4.4	6.8
14046	JAB512	4.3	5.6
15001	JAB517	4.5	7.2
15006	JAB517	5.9	8.8
15011	JAB512	4.4	6.3
15012	JAB514	4.7	8.3
16002	JAB517	4.5	6.8
16006	JAB517	5.9	9.3
17001	JAB517	4.5	7.2
18001	JAB517	5.5	8.7
21002	JAB517	4.4	6.9
21005	JAB517	4.4	7.5
21006	JAB517	4.5	7.2
22002	JAB514	5.6	7.1
22003	JAB521	5.5	8.8
22004	JAB521	6.4	8.3
22006	JAB517	4.3	7.0
22012	JAB517	4.4	7.2
22017	JAB514	4.6	7.7
22028	JAB516	4.4	7.2
23003	JAB521	6.1	9.5
23008	JAJ012	7.3	14.8
23011	JAJ012	7.0	10.9
23015	JAB517	6.0	8.9
23016	JAB517	6.1	9.6
23017	JAB517	5.9	9.8
23019	JAB517	6.1	9.2
23024	JAB517	4.0	8.1
23067	JAB521	5.6	8.6
24012	JAB512	4.9	7.5
25003	JAB517	5.0	8.4
26001	JAB517	4.5	6.8
26006	JAB517	4.8	7.0
27014	JAB521	5.2	8.9
27020	JAB517	4.5	6.9
27044	JAB517	4.4	7.3
27046	JAB517	4.4	6.8
28002	JAB517	4.5	6.9
28003	JAB521	6.1	9.2
28011	JAJ803	3.9	6.5
28016	JAB512	3.8	5.8
28017	JAB521	6.3	9.3
28031	JAB517	4.3	2.5
28034	JAB512	4.0	6.7
30004	JAB517	5.2	6.8
30005	JAB517	4.2	7.1
30006	JAB519	4.7	7.7
31005	JAB517	4.6	6.9
32001	JAB521	5.6	9.2
32002	JAB519	4.4	7.3
33001	JAB517	4.7	7.0
33005	JAB517	4.9	8.1
33008	JAB517	4.5	6.9
33009	JAJ012	6.1	9.8
34004	JAB517	4.3	7.3
34009	JAB517	4.4	7.3
34010	JAB519	4.8	6.4
34011	JAB517	4.0	7.3
34012	JAB521	5.9	9.2
34015	JAB517	4.6	7.3
35001	JAB521	5.8	9.3
39001	JAB517	4.7	7.3
39002	JAB512	4.5	8.0
39003	JAB512	4.3	7.0
39004	JAB517	4.5	6.8
40007	JAB517	4.5	7.1
40009	JAB521	5.4	8.8
40027	JAB517	4.8	7.3
43001	JAB517	4.5	7.3
43003	JAB517	4.7	7.2
45002	JAB517	4.7	7.1
46004	JAB517	4.8	7.1
47001	JAB517	4.5	6.7
47004	JAB517	4.8	7.4
47005	JAB517	4.7	7.3
47006	JAB517	4.2	7.1

[21] 好酸球　自施設測定施設測定結果一覧

施設コード	測定装置コード	測定値	
		試料4	試料5
01001	JAB519	2.8	1.3
01013	JAB517	2.4	1.3
01018	JAB512	2.6	1.2
01025	JAB517	2.8	1.4
01040	JAB517	2.9	1.7
02004	JAB514	2.9	1.9
03001	JAB517	2.8	1.4
03006	JAB517	2.5	1.1
04004	JAB517	2.6	1.4
04008	JAB517	2.7	1.2
04009	JAB521	2.7	1.1
04012	JAB517	2.5	1.6
04015	JAB517	2.6	1.2
08001	JAB517	2.9	1.6
08003	JAB517	2.2	0.6
08006	JAB517	2.5	1.6
08009	JAB517	2.8	1.4
08010	JAB517	2.5	1.1
09001	JAB521	2.7	1.3
09005	JAB517	2.6	1.1
09012	JAB512	2.8	1.2
09013	JAB521	2.6	1.3
10005	JAB517	2.8	1.1
10007	JAB517	2.6	1.1
11006	JAB512	2.7	1.5
11010	JAB517	2.7	1.4
11020	JAB517	2.8	1.6
11023	JAB514	2.7	1.7
11033	JAB519	2.6	1.6
12001	JAB517	2.7	1.5
12002	JAB517	2.8	1.1
12008	JAB517	2.5	1.1
12016	JAB514	2.8	1.4
12019	JAB514	2.3	1.4
13002	JAB514	3.0	1.8
13003	JAB521	2.7	1.3
13016	JAB517	2.7	1.1
13017	JAB517	2.8	1.6
13026	JAB521	2.7	1.6
13053	JAB512	2.7	1.6
13061	JAB521	2.6	1.3
13064	JAB512	3.1	1.1
13074	JAB517	2.7	1.4
13084	JAB514	2.8	1.8
13103	JAB521	2.6	1.4
13145	JAS304	3.2	1.6
14001	JAB517	2.6	1.7
14003	JAB512	2.4	1.4
14010	JAB512	2.9	1.1
14025	JAB517	2.3	1.3
14030	JAB517	2.7	1.6
14046	JAB512	2.5	1.5
15001	JAB517	2.8	1.9
15006	JAB517	2.9	1.9
15011	JAB512	2.9	1.1
15012	JAB514	2.6	1.6
16002	JAB517	2.8	1.4
16006	JAB517	3.1	1.1
17001	JAB517	2.5	1.4
18001	JAB517	2.6	1.1
21002	JAB517	2.7	1.2
21005	JAB517	2.6	1.4
21006	JAB517	3.0	1.3
22002	JAB514	2.7	1.6
22003	JAB521	2.9	1.3
22004	JAB521	2.8	1.9
22006	JAB517	2.6	1.5
22012	JAB517	2.7	1.4
22017	JAB514	2.8	1.6
22028	JAB516	2.5	1.3
23003	JAB521	2.9	1.3
23008	JAJ012	3.1	1.9
23011	JAJ012	3.5	6.0
23015	JAB517	2.8	1.7
23016	JAB517	2.9	1.3
23017	JAB517	2.6	1.1
23019	JAB517	2.7	1.5
23024	JAB517	2.9	1.7
23067	JAB521	2.9	1.4
24012	JAB512	3.0	1.9
25003	JAB517	2.8	1.5
26001	JAB517	2.9	1.4
26006	JAB517	2.8	1.6
27014	JAB521	2.8	1.4
27020	JAB517	2.7	1.5
27044	JAB517	2.7	1.4
27046	JAB517	2.4	1.3
28002	JAB517	2.8	1.1
28003	JAB521	2.5	1.4
28011	JAJ803	3.9	1.9
28016	JAB512	2.5	1.4
28017	JAB521	3.1	1.3
28031	JAB517	2.4	0.7
28034	JAB512	3.2	1.6
30004	JAB517	3.0	1.7
30005	JAB517	3.3	1.7
30006	JAB519	2.6	1.4
31005	JAB517	3.4	2.1
32001	JAB521	2.7	1.4
32002	JAB519	2.7	1.4
33001	JAB517	2.6	1.3
33005	JAB517	2.7	1.1
33008	JAB517	2.8	1.4
33009	JAJ012	3.0	1.6
34004	JAB517	2.6	1.4
34009	JAB517	3.0	1.7
34010	JAB519	2.5	1.1
34011	JAB517	2.7	1.6
34012	JAB521	3.3	2.0
34015	JAB517	2.4	1.7
35001	JAB521	2.7	1.1
39001	JAB517	2.5	1.6
39002	JAB512	2.6	1.3
39003	JAB512	2.8	1.4
39004	JAB517	2.9	1.6
40007	JAB517	3.3	1.6
40009	JAB521	2.9	1.4
40027	JAB517	2.7	1.4
43001	JAB517	2.6	1.3
43003	JAB517	2.8	1.1
45002	JAB517	2.6	1.8
46004	JAB517	2.6	1.1
47001	JAB517	2.6	1.3
47004	JAB517	2.6	1.1
47005	JAB517	2.7	1.3
47006	JAB517	2.6	1.3

[22] 好塩基球　自施設測定施設測定結果一覧

施設	測定装置	測定値	
コード	コード	試料４	試料５
01001	JAB519	0.6	1.2
01013	JAB517	0.5	1.1
01018	JAB512	0.3	0.7
01025	JAB517	0.5	1.0
01040	JAB517	0.5	0.8
02004	JAB514	0.3	1.3
03001	JAB517	0.3	1.1
03006	JAB517	0.5	1.4
04004	JAB517	0.3	0.8
04008	JAB517	0.5	1.0
04009	JAB521	0.5	1.1
04012	JAB517	0.3	0.8
04015	JAB517	0.4	1.1
08001	JAB517	0.3	0.8
08003	JAB517	0.5	0.4
08006	JAB517	0.6	1.4
08009	JAB517	0.5	1.1
08010	JAB517	0.5	0.8
09001	JAB521	0.4	0.8
09005	JAB517	0.3	0.5
09012	JAB512	0.3	0.8
09013	JAB521	0.5	1.0
10005	JAB517	0.4	1.0
10007	JAB517	0.4	1.1
11006	JAB512	0.3	1.0
11010	JAB517	0.6	1.1
11020	JAB517	0.4	0.8
11023	JAB514	0.4	1.1
11033	JAB519	0.5	1.1
12001	JAB517	0.3	0.8
12002	JAB517	0.7	0.8
12008	JAB517	0.5	0.8
12016	JAB514	0.4	0.8
12019	JAB514	0.6	0.8
13002	JAB514	0.2	0.8
13003	JAB521	0.5	0.9
13016	JAB517	0.3	1.1
13017	JAB517	0.6	1.1
13026	JAB521	0.6	0.8
13053	JAB512	0.3	1.0
13061	JAB521	0.3	1.1
13064	JAB512	0.4	0.9
13074	JAB517	0.6	1.1
13084	JAB514	0.3	0.5
13103	JAB521	0.4	1.1
13145	JAS304	1.1	1.4
14001	JAB517	0.6	0.8
14003	JAB512	0.3	1.1
14010	JAB512	0.2	0.6
14025	JAB517	0.3	1.3
14030	JAB517	0.6	0.8
14046	JAB512	0.5	0.8
15001	JAB517	0.7	1.3
15006	JAB517	0.5	1.1
15011	JAB512	0.5	0.8
15012	JAB514	0.2	0.5
16002	JAB517	0.4	1.1
16006	JAB517	0.3	0.6
17001	JAB517	0.7	1.1
18001	JAB517	0.3	0.5
21002	JAB517	0.4	1.2
21005	JAB517	0.5	1.1
21006	JAB517	0.5	0.8
22002	JAB514	0.3	1.1
22003	JAB521	0.5	1.0
22004	JAB521	0.4	0.8
22006	JAB517	0.4	1.1
22012	JAB517	0.5	0.8
22017	JAB514	0.3	0.8
22028	JAB516	0.6	0.8
23003	JAB521	0.8	1.4
23008	JAJ012	0.4	1.6
23011	JAJ012	0.6	1.0
23015	JAB517	0.8	1.3
23016	JAB517	0.9	1.4
23017	JAB517	0.4	0.8
23019	JAB517	0.7	1.0
23024	JAB517	1.2	1.5
23067	JAB521	0.6	0.8
24012	JAB512	1.0	1.3
25003	JAB517	0.6	1.2
26001	JAB517	0.4	1.1
26006	JAB517	0.6	1.4
27014	JAB521	0.5	0.8
27020	JAB517	0.4	1.1
27044	JAB517	0.4	1.1
27046	JAB517	0.7	1.3
28002	JAB517	0.5	1.1
28003	JAB521	1.0	1.1
28011	JAJ803	0.3	0.6
28016	JAB512	0.3	0.8
28017	JAB521	1.0	1.3
28031	JAB517	0.4	0.3
28034	JAB512	0.2	1.1
30004	JAB517	0.7	1.4
30005	JAB517	0.7	1.3
30006	JAB519	0.4	0.9
31005	JAB517	0.5	1.2
32001	JAB521	0.5	1.0
32002	JAB519	0.9	2.2
33001	JAB517	0.5	1.0
33005	JAB517	0.7	0.8
33008	JAB517	0.6	1.1
33009	JAJ012	0.5	0.9
34004	JAB517	0.4	0.9
34009	JAB517	0.5	1.1
34010	JAB519	0.7	1.7
34011	JAB517	0.4	0.8
34012	JAB521	0.5	1.1
34015	JAB517	0.4	0.7
35001	JAB521	0.5	1.1
39001	JAB517	0.3	0.8
39002	JAB512	0.3	0.8
39003	JAB512	0.2	1.2
39004	JAB517	0.7	1.1
40007	JAB517	0.3	1.1
40009	JAB521	0.5	0.8
40027	JAB517	0.5	1.6
43001	JAB517	0.5	0.9
43003	JAB517	0.8	1.4
45002	JAB517	0.4	1.0
46004	JAB517	0.5	0.8
47001	JAB517	0.5	1.1
47004	JAB517	0.6	1.1
47005	JAB517	0.6	0.8
47006	JAB517	0.4	1.1

Ⅱ．調査試料測定結果（５）
（自施設測定施設 解析値一覧）

［１］　総コレステロール

［２］　中性脂肪

［３］　尿酸

［４］　クレアチニン

［５］　ＡＳＴ（ＧＯＴ）

［６］　ＡＬＴ（ＧＰＴ）

［７］　γ－ＧＴ

［８］　血糖

解析値結果

５試料を送付した［1］総コレステロールから［８］血糖までの項目の解析値評価について、各解析項目の得点と100点満点に換算した解析値評価点を示す。

[1] 総コレステロール　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	11	0.971	0.8784	0.9714	0.0051	0.0048	4.7903	2	3	2	3	3	13	86.7
01013	11	0.976	0.8307	0.9762	0.0343	0.0345	-1.9747	2	3	2	0	0	7	46.7
01018	11	0.9812	0.4112	0.9812	0.0034	0.003	3.0403	3	3	3	3	3	15	100
01025	11	1.0036	0.4099	1.0037	0.0108	0.011	1.4116	3	3	3	2	2	13	86.7
01040	11	0.9834	0.8068	0.9837	0.0104	0.0109	5.0854	3	3	3	3	2	14	93.3
02004	11	1.0433	1.4525	1.0441	0.016	0.0155	-5.3415	1	2	1	0	1	5	33.3
03001	11	0.9898	0.6082	0.99	0.0021	0.002	1.7987	3	3	3	3	3	15	100
03006	11	0.9939	0.5034	0.994	0.002	0.0021	1.0211	3	3	3	3	3	15	100
04004	11	1.003	0.6945	1.0032	0.0061	0.0062	0.5737	3	3	3	3	3	15	100
04008	11	0.9865	0.5121	0.9866	0.0027	0.0026	2.2117	3	3	3	3	3	15	100
04009	11	0.9678	0.1627	0.9678	0.0063	0.0057	5.0015	2	3	2	3	3	13	86.7
04012	11	1.0162	0.9014	1.0166	0.0137	0.0137	-0.4543	3	3	3	1	1	11	73.3
04015	11	1.0027	0.3669	1.0027	0.0034	0.0035	-1.1449	3	3	3	3	3	15	100
08001	11	0.9786	0.5381	0.9787	0.0343	0.0347	-2.4769	3	3	3	0	0	9	60
08003	11	1.0301	0.1541	1.0301	0.0118	0.0115	-3.4915	2	3	2	2	2	11	73.3
08006	11	1.0067	0.6812	1.0069	0.0028	0.003	-1.4759	3	3	3	3	3	15	100
08009	11	0.99	0.382	0.9901	0.0026	0.0025	1.4373	3	3	3	3	3	15	100
08010	11	1.0175	0.411	1.0176	0.0025	0.0026	-3.2853	3	3	3	3	3	15	100
09001	11	0.9887	0.4067	0.9887	0.0042	0.0046	2.9314	3	3	3	3	3	15	100
09005	11	1.0036	0.4099	1.0037	0.016	0.0162	2.4116	3	3	3	0	0	9	60
09012	11	0.9724	0.3864	0.9724	0.0039	0.0042	5.7323	2	3	2	3	3	13	86.7
09013	11	0.9886	0.7183	0.9889	0.0066	0.0065	0.901	3	3	3	3	3	15	100
09016	11	1.0249	0.4203	1.025	0.0055	0.0052	-3.7099	3	3	3	3	3	15	100
10005	11	1.003	0.7501	1.0032	0.0027	0.0026	-0.42	3	3	3	3	3	15	100
10007	11	1.0036	0.6349	1.0038	0.0106	0.0109	-2.78	3	3	3	2	2	13	86.7
11006	11	0.9923	0.4429	0.9924	0.004	0.0042	2.2066	3	3	3	3	3	15	100
11010	11	1.0036	0.3984	1.0037	0.0027	0.0027	-0.1892	3	3	3	3	3	15	100
11020	11	1.0174	0.4946	1.0175	0.0037	0.004	-3.9229	3	3	3	3	3	15	100
11023	11	0.9901	0.3782	0.9902	0.0019	0.0019	1.7446	3	3	3	3	3	15	100
11033	11	0.9572	3.4685	0.9623	0.0198	0.0193	4.5066	1	0	1	0	0	2	13.3
12001	11	1.0036	0.3126	1.0037	0.0021	0.002	-0.2932	3	3	3	3	3	15	100
12002	11	1.0129	0.2942	1.0129	0.0029	0.0027	-1.8433	3	3	3	3	3	15	100
12008	11	0.9846	0.465	0.9846	0.0033	0.0032	2.5035	3	3	3	3	3	15	100
12016	11	1.0085	0.8207	1.0089	0.0136	0.0136	0.9475	3	3	3	1	1	11	73.3
12019	11	0.9839	1.9013	0.9851	0.0054	0.0053	2.2347	3	0	3	3	3	12	80
13002	11	1.0069	1.3158	1.0077	0.005	0.0048	-0.8314	3	2	3	3	3	14	93.3
13003	11	1.0301	0.1625	1.0301	0.0038	0.0037	-5.5591	2	3	2	3	3	13	86.7
13016	11	0.9898	0.9077	0.9902	0.003	0.0032	2.003	3	3	3	3	3	15	100
13017	11	1.002	0.3169	1.002	0.0029	0.0029	-0.9243	3	3	3	3	3	15	100
13026	11	1.0008	0.2105	1.0009	0.0092	0.0095	-1.9164	3	3	3	3	3	15	100
13053	11	0.9775	1.1842	0.9782	0.0096	0.0102	5.993	3	2	3	3	3	14	93.3
13061	11	1.002	0.3169	1.002	0.0024	0.0024	0.0757	3	3	3	3	3	15	100
13064	11	1.0123	0.3144	1.0123	0.003	0.0028	-1.7558	3	3	3	3	3	15	100
13074	11	1.0146	0.3142	1.0146	0.0087	0.0086	-1.1305	3	3	3	3	3	15	100
13084	11	0.9952	0.7067	0.9955	0.0026	0.0026	0.9631	3	3	3	3	3	15	100
13103	11	1.0082	0.7353	1.0084	0.0029	0.0029	-1.5608	3	3	3	3	3	15	100
13145	11	0.9937	0.4816	0.9938	0.0106	0.0107	-0.8508	3	3	3	2	2	13	86.7
14001	11	1.003	0.4951	1.0031	0.008	0.0083	-2.024	3	3	3	3	3	15	100
14003	11	0.9887	0.4067	0.9887	0.0023	0.0022	1.9314	3	3	3	3	3	15	100
14010	11	1.0334	0.5788	1.0335	0.0139	0.0136	-3.8115	2	3	2	1	1	9	60
14025	11	0.9908	0.3949	0.9908	0.0035	0.0033	1.1349	3	3	3	3	3	15	100

[1] 総コレステロール　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	11	1.0049	0.3238	1.005	0.005	0.0052	-1.8973	3	3	3	3	3	15	100
14046	11	1.0036	0.3126	1.0037	0.0074	0.0075	0.7068	3	3	3	3	3	15	100
15001	11	0.9868	0.611	0.9869	0.0155	0.0155	-0.4387	3	3	3	1	1	11	73.3
15006	11	0.9964	0.1947	0.9964	0.0047	0.0048	-0.2116	3	3	3	3	3	15	100
15011	11	0.995	0.755	0.9951	0.0034	0.0035	0.5464	3	3	3	3	3	15	100
15012	11	0.977	1.6518	0.9783	0.0091	0.0089	2.6904	3	1	3	3	3	13	86.7
16002	11	0.9826	0.9722	0.9829	0.0106	0.0105	1.2804	3	3	3	2	3	14	93.3
16006	11	1.0279	0.1612	1.0279	0.0051	0.0058	-6.0691	2	3	2	3	3	13	86.7
17001	11	1.0002	0.8246	1.0005	0.0138	0.0142	2.6001	3	3	3	1	1	11	73.3
18001	11	1.0204	0.5027	1.0206	0.0037	0.0039	-4.4492	3	3	3	3	3	15	100
21002	11	1.0032	1.1635	1.0039	0.0066	0.0067	-1.8507	3	3	3	3	3	15	100
21005	11	1.0339	0.6948	1.0341	0.0046	0.0047	-6.215	2	3	2	3	3	13	86.7
21006	11	1.003	0.3283	1.003	0.0105	0.0107	1.3757	3	3	3	2	2	13	86.7
22002	11	1.0018	0.8028	1.002	0.0034	0.0035	0.102	3	3	3	3	3	15	100
22003	11	1.0078	0.5004	1.0079	0.0151	0.0155	-4.3119	3	3	3	1	1	11	73.3
22004	11	0.97	0.3485	0.9701	0.0091	0.0086	3.8434	2	3	2	3	3	13	86.7
22006	11	0.9964	0.5743	0.9965	0.0058	0.0059	-0.4097	3	3	3	3	3	15	100
22012	11	0.9964	0.6587	0.9966	0.008	0.0081	-0.812	3	3	3	3	3	15	100
22017	11	1.0065	0.5604	1.0066	0.0021	0.0022	-1.3954	3	3	3	3	3	15	100
22028	11	1.003	0.3704	1.003	0.0018	0.0018	-0.222	3	3	3	3	3	15	100
23003	11	0.9828	1.4075	0.9837	0.0047	0.0048	3.1438	3	2	3	3	3	14	93.3
23008	11	1.0036	0.3126	1.0037	0.0032	0.0034	-1.2932	3	3	3	3	3	15	100
23011	11	0.9971	0.6593	0.9972	0.0047	0.0049	1.4977	3	3	3	3	3	15	100
23015	11	0.9906	0.956	0.991	0.0038	0.0038	1.7653	3	3	3	3	3	15	100
23016	11	1.0036	0.4099	1.0037	0.0016	0.0017	-0.5884	3	3	3	3	3	15	100
23017	11	0.9964	0.1947	0.9964	0.0061	0.0063	1.7884	3	3	3	3	3	15	100
23019	11	1.0036	0.3126	1.0037	0.0021	0.002	-0.2932	3	3	3	3	3	15	100
23024	11	1.007	0.4152	1.0071	0.0045	0.0047	-2.25	3	3	3	3	3	15	100
23029	11	1.0102	0.5772	1.0103	0.0027	0.0027	-1.6745	3	3	3	3	3	15	100
23067	11	0.9997	0.846	1	0.003	0.0031	-0.4156	3	3	3	3	3	15	100
24012	11	0.9944	0.588	0.9945	0.0023	0.0022	1.2581	3	3	3	3	3	15	100
25003	11	1.0036	0.6349	1.0038	0.0023	0.0024	-0.78	3	3	3	3	3	15	100
26001	11	0.9797	0.6111	0.9799	0.0038	0.0036	3.3241	3	3	3	3	3	15	100
26003	11	0.9871	0.4229	0.9872	0.0076	0.0074	1.0438	3	3	3	3	3	15	100
26006	11	0.9977	0.528	0.9978	0.0034	0.0035	1.0829	3	3	3	3	3	15	100
27014	11	0.9917	0.6994	0.9919	0.0045	0.0045	0.9298	3	3	3	3	3	15	100
27020	11	0.9964	0.1947	0.9964	0.001	0.001	0.7884	3	3	3	3	3	15	100
27044	11	1.0017	0.7223	1.0018	0.0045	0.0046	0.4824	3	3	3	3	3	15	100
27046	11	1.0065	0.5604	1.0066	0.0113	0.0117	-3.3954	3	3	3	2	2	13	86.7
28002	11	0.9917	0.8022	0.992	0.0102	0.0103	-0.3522	3	3	3	3	3	15	100
28003	11	1.0154	1.0722	1.0158	0.0048	0.0049	-3.3156	3	3	3	3	3	15	100
28011	11	1.0235	0.4102	1.0236	0.0028	0.0028	-4.473	3	3	3	3	3	15	100
28016	11	1.0123	0.3144	1.0123	0.0083	0.0082	-0.7558	3	3	3	3	3	15	100
28017	11	1.0064	0.522	1.0065	0.0037	0.0038	-1.8482	3	3	3	3	3	15	100
28031	11	0.9634	0.7573	0.9637	0.0059	0.0059	6.2534	1	3	1	3	3	11	73.3
28034	11	0.9833	0.7136	0.9834	0.0026	0.0024	3.0401	3	3	3	3	3	15	100
30004	11	1.0228	0.457	1.0229	0.0181	0.018	-0.8644	3	3	3	0	0	9	60
30005	11	1.0249	0.4062	1.025	0.0125	0.0123	-2.3379	3	3	3	2	2	13	86.7
30006	11	0.9801	1.0541	0.9805	0.0047	0.0046	4.0394	3	3	3	3	3	15	100
31005	11	0.9789	1.0078	0.9792	0.0038	0.0044	4.1734	3	3	3	3	3	15	100
32001	11	1.0049	0.7171	1.0051	0.0112	0.0115	-3.0792	3	3	3	2	2	13	86.7

[1] 総コレステロール　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	11	1.0003	0.6732	1.0005	0.0029	0.0029	-0.4143	3	3	3	3	3	15	100
33001	11	0.9678	0.6994	0.968	0.0079	0.0075	4.6303	2	3	2	3	3	13	86.7
33005	11	0.962	1.168	0.9627	0.0311	0.031	1.3027	1	3	1	0	0	5	33.3
33008	11	1.0065	0.9663	1.0068	0.0039	0.0041	-1.3983	3	3	3	3	3	15	100
33009	11	0.9769	0.544	0.977	0.0047	0.0051	4.9537	3	3	3	3	3	15	100
34004	11	1.0204	0.4317	1.0205	0.0055	0.0051	-2.8587	3	3	3	3	3	15	100
34009	11	1.0096	0.4881	1.0097	0.0019	0.0019	-1.6347	3	3	3	3	3	15	100
34010	11	1.0145	0.2064	1.0146	0.0066	0.007	-3.9864	3	3	3	3	3	15	100
34011	11	0.9949	0.4025	0.9949	0.0024	0.0024	0.5627	3	3	3	3	3	15	100
34012	11	1.0217	0.497	1.0218	0.004	0.0045	-4.7005	3	3	3	3	3	15	100
34015	11	1.0102	0.4892	1.0102	0.0055	0.0053	-0.8967	3	3	3	3	3	15	100
35001	11	0.9945	0.5427	0.9947	0.0018	0.0018	0.9934	3	3	3	3	3	15	100
39001	11	0.9923	0.5418	0.9925	0.0027	0.0028	1.1179	3	3	3	3	3	15	100
39002	11	0.9815	1.4477	0.9822	0.0105	0.0104	1.6895	3	2	3	2	3	13	86.7
39003	11	1.0204	0.4104	1.0205	0.0157	0.0156	-0.894	3	3	3	1	1	11	73.3
39004	11	1.0175	0.411	1.0176	0.0055	0.0053	-2.2853	3	3	3	3	3	15	100
40007	11	0.9931	0.8358	0.9934	0.0041	0.0041	0.5947	3	3	3	3	3	15	100
40009	11	1.0006	0.9535	1.0009	0.0057	0.0059	-1.1268	3	3	3	3	3	15	100
40027	11	1.0081	0.5792	1.0082	0.0034	0.0032	-0.8965	3	3	3	3	3	15	100
43001	11	1.003	0.7501	1.0032	0.0102	0.0104	-2.42	3	3	3	3	3	15	100
43003	11	0.9688	0.8766	0.969	0.0074	0.0073	5.0055	2	3	2	3	3	13	86.7
45002	11	1.0018	0.8028	1.002	0.0034	0.0035	0.102	3	3	3	3	3	15	100
46004	11	0.9915	0.348	0.9916	0.0081	0.0081	0.0639	3	3	3	3	3	15	100
47001	11	1.0102	0.7053	1.0105	0.0037	0.0037	-1.483	3	3	3	3	3	15	100
47004	11	1.0129	0.3507	1.013	0.0075	0.008	-3.8445	3	3	3	3	3	15	100
47005	11	1.007	0.4152	1.0071	0.0108	0.0109	0.75	3	3	3	2	2	13	86.7
47006	11	0.9944	1.074	0.995	0.0061	0.0065	2.0107	3	3	3	3	3	15	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	21	0.9941	0.067	0.9941	0.0014	0.0015	0.7717	3	3	3	3	3	15	100
01013	21	1.0028	0.4306	1.0029	0.003	0.0029	-0.0015	3	3	3	3	3	15	100
01018	21	0.9947	0.0927	0.9947	0.0014	0.0016	0.6818	3	3	3	3	3	15	100
01025	21	0.9856	0.4678	0.9857	0.0029	0.0028	1.484	3	3	3	3	3	15	100
01040	21	0.9948	0.0905	0.9948	0.0011	0.0012	0.624	3	3	3	3	3	15	100
02004	21	1.0493	0.557	1.0495	0.0232	0.0223	-2.9722	0	3	0	0	1	4	26.7
03001	21	0.9956	0.0847	0.9956	0.0013	0.0015	0.5812	3	3	3	3	3	15	100
03006	21	0.9903	0.675	0.9906	0.0043	0.0044	0.7971	3	3	3	3	3	15	100
04004	21	1.0084	0.3478	1.0084	0.003	0.0028	-0.5603	3	3	3	3	3	15	100
04008	21	0.9828	0.3487	0.9829	0.0072	0.007	1.1171	3	3	3	3	3	15	100
04009	21	1.0061	0.3815	1.0062	0.0063	0.0069	-1.3675	3	3	3	3	3	15	100
04012	21	1.0084	0.6615	1.0087	0.0297	0.0307	2.2336	3	3	3	0	0	9	60
04015	21	0.9834	0.8963	0.9841	0.0062	0.0066	2.0603	3	3	3	3	3	15	100
08001	21	0.9674	0.6892	0.9677	0.0408	0.0412	-0.9025	2	3	2	0	0	7	46.7
08003	21	1.0103	0.3019	1.0104	0.0029	0.0027	-0.8146	3	3	3	3	3	15	100
08006	21	0.9955	0.0663	0.9955	0.001	0.0012	0.5388	3	3	3	3	3	15	100
08009	21	1.0434	0.5522	1.0436	0.0135	0.0124	-3.246	1	3	1	3	3	11	73.3
08010	21	0.9961	0.9391	0.9968	0.0071	0.0073	-0.243	3	2	3	3	3	14	93.3
09001	21	1.0048	0.6288	1.005	0.0062	0.0063	0.1303	3	3	3	3	3	15	100
09005	21	1.0026	0.475	1.0027	0.0197	0.0203	1.9481	3	3	3	1	1	11	73.3
09012	21	1.0103	0.3019	1.0104	0.0061	0.0066	-1.8146	3	3	3	3	3	15	100
09013	21	0.9948	0.0905	0.9948	0.0086	0.0088	-0.376	3	3	3	3	3	15	100
09016	21	1.0064	0.4706	1.0066	0.0084	0.0084	0.2107	3	3	3	3	3	15	100
10005	21	0.9956	0.0847	0.9956	0.0106	0.0112	1.5812	3	3	3	3	3	15	100
10007	21	0.9941	0.0827	0.9941	0.0172	0.0176	-1.284	3	3	3	2	2	13	86.7
11006	21	0.9853	0.7411	0.9858	0.0045	0.0042	1.6523	3	3	3	3	3	15	100
11010	21	0.9941	0.0827	0.9941	0.0011	0.0012	0.716	3	3	3	3	3	15	100
11020	21	1.0101	0.437	1.0103	0.0043	0.004	-0.6368	3	3	3	3	3	15	100
11023	21	0.9941	0.067	0.9941	0.0014	0.0015	0.7717	3	3	3	3	3	15	100
11033	21	0.9813	1.0389	0.982	0.0312	0.0316	-1.4217	3	2	3	0	0	8	53.3
12001	21	1.0148	0.2091	1.0149	0.006	0.0055	-0.9602	3	3	3	3	3	15	100
12002	21	0.9956	0.0847	0.9956	0.0013	0.0015	0.5812	3	3	3	3	3	15	100
12008	21	0.9902	0.4643	0.9903	0.0078	0.0088	1.9156	3	3	3	3	3	15	100
12016	21	0.9948	0.0905	0.9948	0.0011	0.0012	0.624	3	3	3	3	3	15	100
12019	21	0.9928	0.6752	0.9931	0.0059	0.006	0.2316	3	3	3	3	3	15	100
13002	21	1.0112	0.78	1.0116	0.0051	0.0052	-1.0305	3	3	3	3	3	15	100
13003	21	1.0026	0.475	1.0027	0.0067	0.007	-1.0519	3	3	3	3	3	15	100
13016	21	0.9786	0.8919	0.9792	0.006	0.0056	1.7606	3	3	3	3	3	15	100
13017	21	1.0027	0.5994	1.003	0.0138	0.0142	1.2268	3	3	3	3	3	15	100
13026	21	1.0061	0.3815	1.0062	0.0063	0.0069	-1.3675	3	3	3	3	3	15	100
13053	21	1.0148	0.4285	1.015	0.0045	0.0042	-1.1455	3	3	3	3	3	15	100
13061	21	0.9941	0.067	0.9941	0.0014	0.0015	0.7717	3	3	3	3	3	15	100
13064	21	0.9881	0.5605	0.9883	0.0076	0.0076	0.5538	3	3	3	3	3	15	100
13074	21	1.0226	0.4336	1.0228	0.0102	0.0098	-1.3756	3	3	3	3	3	15	100
13084	21	1.0103	0.3019	1.0104	0.0029	0.0027	-0.8146	3	3	3	3	3	15	100
13103	21	0.9875	0.491	0.9876	0.0076	0.0075	0.6084	3	3	3	3	3	15	100
13145	21	1.0069	0.4922	1.007	0.0049	0.0053	-1.3403	3	3	3	3	3	15	100
14001	21	0.9828	0.497	0.983	0.0218	0.022	-0.4835	3	3	3	1	1	11	73.3
14003	21	1.0075	0.3899	1.0076	0.0026	0.0024	-0.5625	3	3	3	3	3	15	100
14010	21	1.0196	0.6613	1.0199	0.0109	0.0105	-0.992	3	3	3	3	3	15	100
14025	21	0.9862	0.5073	0.9863	0.0057	0.0056	0.9472	3	3	3	3	3	15	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	21	0.9968	0.446	0.9969	0.01	0.0102	-0.743	3	3	3	3	3	15	100
14046	21	1.0095	0.4173	1.0096	0.0051	0.0058	-1.5833	3	3	3	3	3	15	100
15001	21	1.018	0.4825	1.0181	0.0041	0.0044	-1.8857	3	3	3	3	3	15	100
15006	21	1.0083	0.443	1.0084	0.0026	0.0031	-0.9548	3	3	3	3	3	15	100
15011	21	0.9835	0.3607	0.9836	0.0198	0.02	-0.36	3	3	3	1	1	11	73.3
15012	21	1.0205	0.7881	1.021	0.0105	0.0116	-3.3602	3	3	3	3	3	15	100
16002	21	0.9782	0.3044	0.9782	0.0124	0.012	1.0169	3	3	3	3	3	15	100
16006	21	0.9955	0.0663	0.9955	0.018	0.0186	-1.4612	3	3	3	2	2	13	86.7
17001	21	0.9947	0.0927	0.9947	0.0014	0.0016	0.6818	3	3	3	3	3	15	100
18001	21	0.9884	0.5708	0.9887	0.0051	0.0051	0.7967	3	3	3	3	3	15	100
21002	21	1.0177	0.1888	1.0178	0.0032	0.004	-2.2618	3	3	3	3	3	15	100
21005	21	0.9941	0.067	0.9941	0.0102	0.0107	1.7717	3	3	3	3	3	15	100
21006	21	1.0084	0.3478	1.0084	0.0125	0.0128	0.4397	3	3	3	3	3	15	100
22002	21	0.9947	0.0927	0.9947	0.0014	0.0016	0.6818	3	3	3	3	3	15	100
22003	21	0.9434	0.2798	0.9434	0.0234	0.0222	3.6102	0	3	0	0	1	4	26.7
22004	21	0.9828	0.3487	0.9829	0.0032	0.0041	2.1171	3	3	3	3	3	15	100
22006	21	0.9956	0.0847	0.9956	0.0084	0.0086	-0.4188	3	3	3	3	3	15	100
22012	21	0.9743	0.3559	0.9744	0.005	0.0045	2.4154	3	3	3	3	3	15	100
22017	21	1.0081	0.6538	1.0083	0.0039	0.0038	-0.7923	3	3	3	3	3	15	100
22028	21	1.0041	0.5263	1.0043	0.0068	0.007	0.2829	3	3	3	3	3	15	100
23003	21	1.0017	0.4682	1.0019	0.0084	0.0086	0.7304	3	3	3	3	3	15	100
23008	21	1.0241	0.493	1.0243	0.0056	0.0056	-2.3686	2	3	2	3	3	13	86.7
23011	21	0.9813	0.3871	0.9815	0.0029	0.0035	2.3677	3	3	3	3	3	15	100
23015	21	1.0154	0.2003	1.0154	0.0056	0.0053	-1.1082	3	3	3	3	3	15	100
23016	21	0.9899	0.5614	0.9901	0.0059	0.0064	1.7938	3	3	3	3	3	15	100
23017	21	1.0083	0.443	1.0084	0.0183	0.0186	1.0452	3	3	3	2	2	13	86.7
23019	21	1.0028	0.5675	1.003	0.0044	0.0043	0.1411	3	3	3	3	3	15	100
23024	21	0.9813	0.3871	0.9815	0.0154	0.0153	0.3677	3	3	3	2	2	13	86.7
23029	21	1.0324	0.7762	1.0328	0.0083	0.0079	-3.0488	2	3	2	3	3	13	86.7
23067	21	0.9828	0.497	0.983	0.0042	0.004	1.5165	3	3	3	3	3	15	100
24012	21	0.9835	0.3607	0.9836	0.0106	0.0104	0.64	3	3	3	3	3	15	100
25003	21	1.0068	0.429	1.0069	0.0026	0.0024	-0.5343	3	3	3	3	3	15	100
26001	21	0.997	0.457	0.9972	0.0098	0.0099	-0.7483	3	3	3	3	3	15	100
26003	21	1.0068	0.4082	1.0069	0.0022	0.0027	-0.9357	3	3	3	3	3	15	100
26006	21	0.9947	0.0927	0.9947	0.0081	0.0083	-0.3182	3	3	3	3	3	15	100
27014	21	0.9892	0.5658	0.9894	0.0039	0.0038	0.8387	3	3	3	3	3	15	100
27020	21	0.9956	0.0847	0.9956	0.0084	0.0086	-0.4188	3	3	3	3	3	15	100
27044	21	1.0035	0.43	1.0036	0.0078	0.0081	0.4691	3	3	3	3	3	15	100
27046	21	0.9894	0.5327	0.9896	0.0154	0.0157	-0.5286	3	3	3	2	2	13	86.7
28002	21	1.017	0.2184	1.017	0.0047	0.0044	-1.3507	3	3	3	3	3	15	100
28003	21	0.9842	0.3866	0.9843	0.0076	0.0073	0.968	3	3	3	3	3	15	100
28011	21	1.0153	0.3405	1.0154	0.0041	0.0038	-1.3022	3	3	3	3	3	15	100
28016	21	1.0377	0.4062	1.0378	0.0098	0.0088	-3.0313	1	3	1	3	3	11	73.3
28017	21	0.9948	0.0905	0.9948	0.0011	0.0012	0.624	3	3	3	3	3	15	100
28031	21	0.9743	0.3559	0.9744	0.0218	0.0217	0.4154	3	3	3	1	1	11	73.3
28034	21	0.9962	0.8901	0.9966	0.0057	0.0064	0.7258	3	3	3	3	3	15	100
30004	21	1.0126	0.6848	1.0129	0.0106	0.0106	-0.2038	3	3	3	3	3	15	100
30005	21	1.031	0.4115	1.0311	0.0208	0.0205	-1.1014	2	3	2	1	1	9	60
30006	21	0.9754	0.3394	0.9755	0.0069	0.0082	3.4143	3	3	3	3	3	15	100
31005	21	0.9895	0.6294	0.9897	0.0058	0.0058	0.5912	3	3	3	3	3	15	100
32001	21	0.9912	0.5682	0.9915	0.007	0.007	0.2918	3	3	3	3	3	15	100

[2] 中性脂肪　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	21	1.0007	0.6302	1.0009	0.0053	0.0058	-0.5779	3	3	3	3	3	15	100
33001	21	0.9862	0.6023	0.9865	0.0047	0.0054	1.9549	3	3	3	3	3	15	100
33005	11	0.9378	2.1347	0.9414	0.0297	0.0291	3.5814	0	0	0	0	0	0	0
33008	21	1.0061	0.3815	1.0062	0.0063	0.0069	-1.3675	3	3	3	3	3	15	100
33009	21	0.9955	0.0663	0.9955	0.001	0.0012	0.5388	3	3	3	3	3	15	100
34004	21	1.0141	0.1573	1.0141	0.0136	0.0136	-0.0508	3	3	3	3	3	15	100
34009	21	1.0041	0.4676	1.0042	0.0066	0.0071	-1.1116	3	3	3	3	3	15	100
34010	21	0.9719	0.3417	0.972	0.0418	0.0423	-1.4903	3	3	3	0	0	9	60
34011	21	0.9875	0.491	0.9876	0.0076	0.0075	0.6084	3	3	3	3	3	15	100
34012	21	1.0075	0.3899	1.0076	0.0161	0.0172	-2.5625	3	3	3	2	2	13	86.7
34015	21	1.0141	0.1573	1.0141	0.0046	0.0041	-1.0508	3	3	3	3	3	15	100
35001	21	0.9948	0.0905	0.9948	0.0011	0.0012	0.624	3	3	3	3	3	15	100
39001	21	1.0027	0.5994	1.003	0.0047	0.0048	0.2268	3	3	3	3	3	15	100
39002	21	0.9722	0.4036	0.9723	0.0094	0.0087	2.0693	3	3	3	3	3	15	100
39003	21	0.9748	0.3563	0.9749	0.0063	0.0074	3.3935	3	3	3	3	3	15	100
39004	21	0.9941	0.067	0.9941	0.0014	0.0015	0.7717	3	3	3	3	3	15	100
40007	21	0.9871	0.4758	0.9872	0.0087	0.0096	2.2739	3	3	3	3	3	15	100
40009	21	0.9948	0.6313	0.9951	0.004	0.0042	0.2108	3	3	3	3	3	15	100
40027	21	1.0028	0.4306	1.0029	0.0063	0.0068	-1.0015	3	3	3	3	3	15	100
43001	21	0.9743	0.6209	0.9745	0.0275	0.0277	-0.1852	3	3	3	0	0	9	60
43003	21	0.9715	0.3689	0.9715	0.0088	0.0081	2.2492	3	3	3	3	3	15	100
45002	21	1.0114	0.6128	1.0116	0.0039	0.0039	-1.1572	3	3	3	3	3	15	100
46004	21	0.9808	0.4921	0.9809	0.006	0.0057	1.6247	3	3	3	3	3	15	100
47001	21	1.0026	0.4101	1.0027	0.0074	0.0076	0.5435	3	3	3	3	3	15	100
47004	21	1.0268	0.1967	1.0268	0.017	0.0166	-1.0615	2	3	2	2	2	11	73.3
47005	21	1.0153	0.5696	1.0156	0.0091	0.009	-0.7068	3	3	3	3	3	15	100
47006	21	1.0119	0.9242	1.0126	0.0069	0.0075	-2.0293	3	2	3	3	3	14	93.3

[3] 尿酸　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	31	0.997	0.0399	0.9977	0.0047	0.0046	-0.0108	3	3	3	3	3	15	100
01013	31	0.9953	0.039	0.9957	0.005	0.005	-0.0015	3	3	3	3	3	15	100
01018	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0136	0.0136	0.0015	3	3	3	2	2	13	86.7
01025	31	0.9923	0.042	0.993	0.0039	0.0039	0.0246	3	3	3	3	3	15	100
01040	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
02004	31	0.9531	0.0509	0.954	0.016	0.0155	0.204	2	3	2	2	2	11	73.3
03001	31	0.9982	0.0424	0.9988	0.0055	0.0054	-0.0186	3	3	3	3	3	15	100
03006	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
04004	31	0.9979	0.0616	0.9993	0.0093	0.0096	0.063	3	3	3	3	3	15	100
04008	31	0.9882	0.0402	0.9888	0.0042	0.0047	0.0833	3	3	3	3	3	15	100
04009	31	0.9859	0.0385	0.9863	0.0037	0.0044	0.0989	3	3	3	3	3	15	100
04012	31	0.9882	0.0402	0.9888	0.0055	0.0053	0.0433	3	3	3	3	3	15	100
04015	31	0.9463	0.0572	0.9477	0.0198	0.0191	0.2157	1	3	1	1	1	7	46.7
08001	31	0.9873	0.0442	0.9879	0.0056	0.0054	0.0497	3	3	3	3	3	15	100
08003	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0171	0.0175	-0.1869	3	3	3	2	1	12	80
08006	31	0.985	0.0459	0.9856	0.005	0.0048	0.0677	3	3	3	3	3	15	100
08009	31	0.9662	0.0234	0.9665	0.0104	0.0099	0.1489	2	3	2	3	3	13	86.7
08010	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
09001	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0019	0.0022	-0.0883	3	3	3	3	3	15	100
09005	31	1.0309	0.0517	1.0319	0.0045	0.0044	-0.1903	3	3	3	3	3	15	100
09012	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
09013	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
09016	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
10005	31	0.988	0.06	0.9893	0.0087	0.0085	0.0248	3	3	3	3	3	15	100
10007	31	0.9823	0.0456	0.983	0.0112	0.0117	0.1912	3	3	3	3	3	15	100
11006	31	0.9815	0.0332	0.982	0.0035	0.004	0.1317	3	3	3	3	3	15	100
11010	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
11020	31	1.0341	0.0515	1.0353	0.0053	0.0059	-0.2433	3	3	3	3	3	15	100
11023	31	0.9882	0.0526	0.9893	0.0059	0.0063	0.1062	3	3	3	3	3	15	100
11033	31	1.0505	0.0945	1.0537	0.0124	0.0126	-0.2993	2	1	2	3	3	11	73.3
12001	31	0.9868	0.0355	0.9871	0.0031	0.0038	0.0962	3	3	3	3	3	15	100
12002	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
12008	31	1.0006	0.0427	1.0011	0.0044	0.0045	-0.0318	3	3	3	3	3	15	100
12016	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
12019	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0019	0.0022	-0.0883	3	3	3	3	3	15	100
13002	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
13003	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
13016	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
13017	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
13026	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0136	0.0136	0.0015	3	3	3	2	2	13	86.7
13053	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0148	0.0147	-0.0261	3	3	3	2	2	13	86.7
13061	31	1.0492	0.0261	1.0494	0.0053	0.0049	-0.3071	2	3	2	3	3	13	86.7
13064	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
13074	31	1.0119	0.0097	1.012	0.014	0.014	0.0131	3	3	3	2	2	13	86.7
13084	31	1.0183	0.0565	1.0196	0.0053	0.0056	-0.1478	3	3	3	3	3	15	100
13103	31	0.9913	0.0574	0.9922	0.0063	0.0068	0.0877	3	3	3	3	3	15	100
13145	31	0.9923	0.042	0.993	0.0039	0.0039	0.0246	3	3	3	3	3	15	100
14001	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
14003	31	0.9868	0.0355	0.9871	0.0031	0.0038	0.0962	3	3	3	3	3	15	100
14010	31	0.963	0.0303	0.9633	0.007	0.0064	0.1986	2	3	2	3	3	13	86.7
14025	31	0.9805	0.0513	0.9813	0.0082	0.0089	0.1763	3	3	3	3	3	15	100

[3] 尿酸　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	31	0.9873	0.0442	0.9879	0.0105	0.0111	0.1497	3	3	3	3	3	15	100
14046	31	1.0384	0.0441	1.039	0.005	0.0062	-0.2728	3	3	2	3	3	14	93.3
15001	31	0.9859	0.0385	0.9863	0.0037	0.0044	0.0989	3	3	3	3	3	15	100
15006	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
15011	31	1.0081	0.0488	1.0088	0.005	0.0052	-0.0798	3	3	3	3	3	15	100
15012	31	1.0123	0.0503	1.0134	0.0053	0.0055	-0.1045	3	3	3	3	3	15	100
16002	31	1.0171	0.0553	1.018	0.0176	0.0175	0.0032	3	3	3	1	1	11	73.3
16006	31	0.9868	0.0355	0.9871	0.0031	0.0038	0.0962	3	3	3	3	3	15	100
17001	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0025	0.0028	-0.0985	3	3	3	3	3	15	100
18001	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0171	0.0175	-0.1869	3	3	3	2	1	12	80
21002	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
21005	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
21006	31	1.0372	0.0441	1.038	0.0061	0.0068	-0.2612	3	3	3	3	3	15	100
22002	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0174	0.0182	-0.1985	3	3	3	1	1	11	73.3
22003	31	1.0036	0.0465	1.0045	0.0041	0.0045	-0.0089	3	3	3	3	3	15	100
22004	31	0.9982	0.0424	0.9988	0.0055	0.0054	-0.0186	3	3	3	3	3	15	100
22006	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
22012	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
22017	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0174	0.0182	-0.1985	3	3	3	1	1	11	73.3
22028	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
23003	31	0.997	0.0399	0.9977	0.0047	0.0046	-0.0108	3	3	3	3	3	15	100
23008	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0144	0.0145	0.0117	3	3	3	2	2	13	86.7
23011	31	0.963	0.0303	0.9633	0.007	0.0064	0.1986	2	3	2	3	3	13	86.7
23015	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
23016	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
23017	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
23019	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0019	0.0022	-0.0883	3	3	3	3	3	15	100
23024	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
23029	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
23067	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
24012	31	1.0006	0.0427	1.0011	0.0044	0.0045	-0.0318	3	3	3	3	3	15	100
25003	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
26001	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
26003	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
26006	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0025	0.0028	-0.0985	3	3	3	3	3	15	100
27014	31	1.0322	0.0577	1.0336	0.0072	0.0072	-0.1712	3	3	3	3	3	15	100
27020	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
27044	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0144	0.0145	0.0117	3	3	3	2	2	13	86.7
27046	31	0.9692	0.0214	0.9693	0.0081	0.0075	0.1467	2	3	2	3	3	13	86.7
28002	31	0.9598	0.0177	0.9599	0.0078	0.0072	0.2094	2	3	2	3	3	13	86.7
28003	31	0.9943	0.0466	0.9949	0.0038	0.0044	0.0482	3	3	3	3	3	15	100
28011	31	1.0116	0.0075	1.0117	0.0015	0.0017	-0.0828	3	3	3	3	3	15	100
28016	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0167	0.0173	-0.2261	3	3	3	2	1	12	80
28017	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
28031	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0145	0.0144	-0.0191	3	3	3	2	2	13	86.7
28034	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0025	0.0028	-0.0985	3	3	3	3	3	15	100
30004	31	0.9882	0.0402	0.9888	0.0042	0.0047	0.0833	3	3	3	3	3	15	100
30005	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0022	0.0024	-0.1261	3	3	3	3	3	15	100
30006	31	0.9737	0.0379	0.9741	0.0112	0.0107	0.0977	3	3	3	3	3	15	100
31005	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.017	0.0178	-0.1883	3	3	3	2	1	12	80
32001	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100

[3] 尿酸　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	ｙ切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0025	0.0028	-0.0985	3	3	3	3	3	15	100
33001	31	0.9728	0.0377	0.9734	0.0072	0.0069	0.1273	3	3	3	3	3	15	100
33005	31	0.9661	0.0393	0.9668	0.0059	0.0066	0.2485	2	3	2	3	3	13	86.7
33008	31	0.9692	0.0214	0.9693	0.0081	0.0075	0.1467	2	3	2	3	3	13	86.7
33009	31	1.0051	0.0795	1.0069	0.0302	0.0308	0.1596	3	2	3	0	0	8	53.3
34004	31	1.0315	0.0527	1.0323	0.0056	0.0055	-0.1955	3	3	3	3	3	15	100
34009	31	0.9685	0.0338	0.969	0.0061	0.0069	0.2254	2	3	2	3	3	13	86.7
34010	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0324	0.0333	-0.3261	3	3	3	0	0	9	60
34011	31	0.9868	0.0355	0.9871	0.0031	0.0038	0.0962	3	3	3	3	3	15	100
34012	31	1.0384	0.0441	1.039	0.0132	0.0129	-0.1728	3	3	2	3	3	14	93.3
34015	31	0.9692	0.0214	0.9693	0.0074	0.0084	0.2467	2	3	2	3	3	13	86.7
35001	31	0.9815	0.0332	0.982	0.0135	0.0134	0.0317	3	3	3	2	3	14	93.3
39001	31	1.0119	0.0097	1.012	0.0022	0.0024	-0.0869	3	3	3	3	3	15	100
39002	31	0.9685	0.0194	0.9686	0.005	0.006	0.2327	2	3	2	3	3	13	86.7
39003	31	0.9815	0.0332	0.982	0.0035	0.004	0.1317	3	3	3	3	3	15	100
39004	31	1.0119	0.0097	1.012	0.014	0.014	0.0131	3	3	3	2	2	13	86.7
40007	31	1.0176	0.0073	1.0176	0.0029	0.0031	-0.1191	3	3	3	3	3	15	100
40009	31	0.9685	0.0194	0.9686	0.0107	0.0101	0.1327	2	3	2	3	3	13	86.7
40027	31	0.9372	0.0538	0.9381	0.0112	0.011	0.393	1	3	1	3	3	11	73.3
43001	31	0.9688	0.0223	0.969	0.0081	0.0076	0.1438	2	3	2	3	3	13	86.7
43003	31	0.9953	0.039	0.9957	0.005	0.005	-0.0015	3	3	3	3	3	15	100
45002	31	1.004	0.0678	1.0054	0.0068	0.0071	0.0019	3	3	3	3	3	15	100
46004	31	1.0134	0.0071	1.0134	0.0025	0.0028	-0.0985	3	3	3	3	3	15	100
47001	31	0.9923	0.042	0.993	0.0112	0.0116	0.1246	3	3	3	3	3	15	100
47004	31	1.0126	0.0092	1.0126	0.0019	0.0022	-0.0883	3	3	3	3	3	15	100
47005	31	1.0408	0.0398	1.0414	0.0124	0.0121	-0.1956	2	3	2	3	3	13	86.7
47006	31	1.0189	0.0039	1.0189	0.0148	0.0147	-0.0261	3	3	3	2	2	13	86.7

[4] クレアチニン　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	21	0.9929	0.0081	0.993	0.0043	0.0048	0.0117	3	3	3	3	3	15	100
01013	21	0.9904	0.0184	0.9905	0.0172	0.0372	0.0747	3	3	3	3	0	12	80
01018	21	1.0142	0.0151	1.0142	0.0079	0.0139	-0.0377	3	3	3	3	3	15	100
01025	21	0.9929	0.0156	0.9929	0.0092	0.0141	0.0497	3	3	3	3	3	15	100
01040	21	1.0021	0.0126	1.0021	0.009	0.0122	0.0184	3	3	3	3	3	15	100
02004	21	1.0083	0.0358	1.0085	0.0197	0.0233	0.0347	3	2	3	2	3	13	86.7
03001	21	0.9874	0.0197	0.9875	0.0083	0.0067	0.0183	3	3	3	3	3	15	100
03006	21	1.0156	0.0063	1.0156	0.0065	0.008	-0.0414	3	3	3	3	3	15	100
04004	21	0.9988	0.0046	0.9988	0.0008	0.0005	0.0009	3	3	3	3	3	15	100
04008	21	1.0173	0.012	1.0174	0.01	0.0149	-0.0337	3	3	3	3	3	15	100
04009	21	1.0079	0.0048	1.0079	0.005	0.0123	-0.0279	3	3	3	3	3	15	100
04012	21	1.0185	0.0079	1.0185	0.0108	0.0217	-0.0424	3	3	3	3	3	15	100
04015	21	1.0203	0.0101	1.0203	0.0255	0.0292	0.0139	3	3	3	1	2	12	80
08001	21	0.9716	0.0137	0.9716	0.0172	0.0155	0.0353	2	3	2	3	3	13	86.7
08003	21	0.9915	0.0084	0.9915	0.0057	0.0102	0.0398	3	3	3	3	3	15	100
08006	21	1.012	0.0062	1.012	0.0075	0.0086	-0.0161	3	3	3	3	3	15	100
08009	21	0.9699	0.0093	0.9699	0.0225	0.0175	0.0202	2	3	2	2	3	12	80
08010	21	1.0176	0.0125	1.0176	0.0079	0.009	-0.047	3	3	3	3	3	15	100
09001	21	0.9912	0.0148	0.9913	0.0098	0.0083	-0.0026	3	3	3	3	3	15	100
09005	21	1.0279	0.0139	1.028	0.0131	0.0158	-0.0732	3	3	3	3	3	15	100
09012	21	1.0043	0.013	1.0043	0.0079	0.0084	0.0101	3	3	3	3	3	15	100
09013	21	1.0033	0.0055	1.0033	0.0075	0.0103	0.0111	3	3	3	3	3	15	100
09016	21	1.0013	0.0078	1.0013	0.0143	0.0179	0.0363	3	3	3	3	3	15	100
10005	21	1.0066	0.0043	1.0066	0.0067	0.0059	0.0003	3	3	3	3	3	15	100
10007	21	0.9964	0.0211	0.9965	0.0138	0.0175	-0.0311	3	3	3	3	3	15	100
11006	21	1.022	0.0298	1.0221	0.0128	0.0179	-0.0525	3	3	3	3	3	15	100
11010	21	1.0012	0.0059	1.0012	0.002	0.0027	0.0024	3	3	3	3	3	15	100
11020	21	0.9985	0.01	0.9986	0.0023	0.0055	0.0099	3	3	3	3	3	15	100
11023	21	1.0185	0.0113	1.0185	0.0086	0.0095	-0.0476	3	3	3	3	3	15	100
11033	21	1.0047	0.0401	1.005	0.0144	0.0185	0.0175	3	1	3	3	3	13	86.7
12001	21	0.9917	0.011	0.9917	0.006	0.0041	0.0062	3	3	3	3	3	15	100
12002	21	0.994	0.0022	0.994	0.0033	0.007	0.0144	3	3	3	3	3	15	100
12008	21	0.9899	0.0125	0.9899	0.0068	0.0107	0.0249	3	3	3	3	3	15	100
12016	21	1.0063	0.01	1.0063	0.0038	0.0069	-0.0188	3	3	3	3	3	15	100
12019	21	0.995	0.0157	0.9951	0.0083	0.0108	-0.0088	3	3	3	3	3	15	100
13002	21	0.9964	0.0069	0.9964	0.0092	0.0141	0.0389	3	3	3	3	3	15	100
13003	21	1.0131	0.0093	1.0131	0.0066	0.0094	-0.0439	3	3	3	3	3	15	100
13016	21	0.9911	0.0085	0.9911	0.0067	0.0059	0.0095	3	3	3	3	3	15	100
13017	21	1.0048	0.0099	1.0048	0.0057	0.0059	0.0026	3	3	3	3	3	15	100
13026	21	1.0026	0.0078	1.0026	0.0065	0.0124	0.0107	3	3	3	3	3	15	100
13053	21	0.9977	0.0185	0.9978	0.0045	0.0034	-0.0019	3	3	3	3	3	15	100
13061	21	0.982	0.0092	0.982	0.0086	0.0075	0.0301	3	3	3	3	3	15	100
13064	21	1.0044	0.0099	1.0044	0.0045	0.0067	0.0002	3	3	3	3	3	15	100
13074	21	1	4E-08	1	0.0036	0.0047	0.01	3	3	3	3	3	15	100
13084	21	0.9919	0.0051	0.9919	0.0086	0.0141	0.0466	3	3	3	3	3	15	100
13103	21	1.0157	0.0298	1.0158	0.0098	0.0136	-0.0399	3	3	3	3	3	15	100
13145	21	0.9756	0.0118	0.9756	0.0171	0.0143	0.0223	3	3	3	3	3	15	100
14001	21	0.9904	0.0056	0.9904	0.005	0.0066	0.015	3	3	3	3	3	15	100
14003	21	1.0093	0.0211	1.0093	0.0075	0.0112	-0.0287	3	3	3	3	3	15	100
14010	21	1.0815	0.0084	1.0815	0.0689	0.0649	-0.0383	0	3	0	0	0	3	20
14025	21	1.0222	0.0274	1.0223	0.0128	0.0143	-0.0373	3	3	3	3	3	15	100

[4] クレアチニン　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	21	0.9973	0.0025	0.9973	0.0022	0.0061	0.0136	3	3	3	3	3	15	100
14046	21	0.9854	0.0079	0.9854	0.0278	0.0403	-0.0352	3	3	3	1	0	10	66.7
15001	21	0.999	0.0174	0.999	0.0057	0.0091	-0.0132	3	3	3	3	3	15	100
15006	21	0.991	0.0201	0.9911	0.0108	0.0172	0.0036	3	3	3	3	3	15	100
15011	21	0.9963	0.0116	0.9963	0.0053	0.0099	0.02	3	3	3	3	3	15	100
15012	21	0.9995	0.0155	0.9995	0.006	0.0096	-0.0147	3	3	3	3	3	15	100
16002	21	0.9918	0.0195	0.9918	0.0105	0.0253	0.05	3	3	3	3	2	14	93.3
16006	21	1.0034	0.011	1.0034	0.009	0.0127	0.0151	3	3	3	3	3	15	100
17001	21	0.9947	0.0097	0.9947	0.0043	0.0085	0.0229	3	3	3	3	3	15	100
18001	21	0.9895	0.0038	0.9895	0.0072	0.0114	0.0453	3	3	3	3	3	15	100
21002	21	0.9912	0.0111	0.9912	0.0068	0.0092	0.0095	3	3	3	3	3	15	100
21005	21	0.993	0.0115	0.993	0.0043	0.005	0.0116	3	3	3	3	3	15	100
21006	21	0.9928	0.011	0.9928	0.0067	0.0162	0.0333	3	3	3	3	3	15	100
22002	21	1.0097	0.0217	1.0098	0.01	0.0118	-0.0031	3	3	3	3	3	15	100
22003	21	0.9806	0.0076	0.9806	0.0225	0.0259	-0.0083	3	3	3	2	2	13	86.7
22004	21	1.0084	0.0074	1.0084	0.0042	0.0061	-0.0141	3	3	3	3	3	15	100
22006	21	1.0095	0.0067	1.0096	0.01	0.0093	0.0011	3	3	3	3	3	15	100
22012	21	0.9958	0.0055	0.9958	0.0033	0.0086	0.0181	3	3	3	3	3	15	100
22017	21	0.9978	0.0092	0.9978	0.005	0.0052	-0.0078	3	3	3	3	3	15	100
22028	21	0.9922	0.0094	0.9922	0.005	0.0095	0.0227	3	3	3	3	3	15	100
23003	82	1	0	1	0	0	0	3	3	3	3	3	15	100
23008	21	0.9975	0.0234	0.9976	0.0068	0.0111	0.0125	3	3	3	3	3	15	100
23011	21	0.9744	0.0074	0.9744	0.0131	0.0113	0.0459	2	3	2	3	3	13	86.7
23015	21	1.0386	0.0186	1.0387	0.0597	0.066	0.0642	2	3	2	0	0	7	46.7
23016	21	0.9982	0.0172	0.9983	0.0039	0.0053	0.0014	3	3	3	3	3	15	100
23017	21	1.0149	0.0115	1.0149	0.0125	0.0107	-0.0059	3	3	3	3	3	15	100
23019	21	1.02	0.0116	1.02	0.0173	0.0142	-0.0073	3	3	3	3	3	15	100
23024	21	0.9768	0.012	0.9768	0.0203	0.0186	0.0087	3	3	3	2	3	14	93.3
23029	21	0.9929	0.0132	0.9929	0.0052	0.0073	0.0297	3	3	3	3	3	15	100
23067	21	0.9857	0.0161	0.9857	0.0208	0.0256	-0.0156	3	3	3	2	2	13	86.7
24012	21	0.9853	0.015	0.9853	0.0158	0.0137	-0.0027	3	3	3	3	3	15	100
25003	21	0.9994	0.0062	0.9994	0.0013	0.0023	0.0058	3	3	3	3	3	15	100
26001	21	0.9778	0.005	0.9778	0.0108	0.0102	0.0399	3	3	3	3	3	15	100
26003	21	1.0125	0.0119	1.0125	0.0052	0.0034	-0.0221	3	3	3	3	3	15	100
26006	21	0.997	0.0073	0.997	0.0115	0.0181	-0.0237	3	3	3	3	3	15	100
27014	21	1.0197	0.007	1.0197	0.018	0.0179	-0.0044	3	3	3	3	3	15	100
27020	21	0.9946	0.011	0.9946	0.0075	0.0167	0.031	3	3	3	3	3	15	100
27044	21	1.0146	0.0113	1.0146	0.0083	0.0202	-0.0449	3	3	3	3	3	15	100
27046	21	0.9824	0.0086	0.9825	0.0172	0.0175	0.001	3	3	3	3	3	15	100
28002	21	0.98	0.0154	0.98	0.0108	0.0143	0.0657	3	3	3	3	3	15	100
28003	21	1.018	0.0079	1.018	0.0105	0.0166	-0.0361	3	3	3	3	3	15	100
28011	21	0.9929	0.0074	0.9929	0.0118	0.0188	0.0577	3	3	3	3	3	15	100
28016	21	0.9977	0.0032	0.9977	0.0008	0.0042	0.008	3	3	3	3	3	15	100
28017	21	1.0084	0.0081	1.0084	0.0083	0.0072	-0.0004	3	3	3	3	3	15	100
28031	21	0.9887	0.0156	0.9887	0.0075	0.0086	0.0133	3	3	3	3	3	15	100
28034	21	0.9884	0.0095	0.9884	0.0158	0.0177	-0.0117	3	3	3	3	3	15	100
30004	21	0.997	0.0165	0.997	0.0067	0.0117	0.0233	3	3	3	3	3	15	100
30005	21	0.9958	0.0158	0.9959	0.0098	0.0176	0.0371	3	3	3	3	3	15	100
30006	21	1.0288	0.0246	1.0289	0.0172	0.0112	-0.0323	3	3	3	3	3	15	100
31005	21	1.0021	0.0272	1.0021	0.0105	0.0174	0.0225	3	3	3	3	3	15	100
32001	21	1.0246	0.0099	1.0247	0.0122	0.0168	-0.0787	3	3	3	3	3	15	100

[4] クレアチニン　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	21	1.0082	0.0158	1.0082	0.0065	0.0048	-0.0049	3	3	3	3	3	15	100
33001	21	1.0059	0.0139	1.0059	0.0068	0.0141	-0.0298	3	3	3	3	3	15	100
33005	21	0.9863	0.0261	0.9864	0.01	0.0113	0.0503	3	3	3	3	3	15	100
33008	21	0.9836	0.0129	0.9837	0.0108	0.0076	0.0156	3	3	3	3	3	15	100
33009	21	0.9996	0.0175	0.9996	0.0315	0.063	0.085	3	3	3	0	0	9	60
34004	21	1.0071	0.0161	1.0072	0.0093	0.0124	0.0021	3	3	3	3	3	15	100
34009	21	1.0167	0.006	1.0167	0.0183	0.019	0.0039	3	3	3	3	3	15	100
34010	21	0.9817	0.0037	0.9817	0.018	0.0183	0.0008	3	3	3	3	3	15	100
34011	21	1.0239	0.0144	1.0239	0.0165	0.011	-0.0197	3	3	3	3	3	15	100
34012	21	1.0195	0.0044	1.0195	0.012	0.0202	-0.036	3	3	3	3	3	15	100
34015	21	0.984	0.0113	0.984	0.0086	0.0096	0.0286	3	3	3	3	3	15	100
35001	21	0.9734	0.01	0.9734	0.0248	0.021	0.0049	2	3	2	1	3	11	73.3
39001	21	1.0087	0.0048	1.0087	0.005	0.008	-0.0341	3	3	3	3	3	15	100
39002	21	0.9933	0.0123	0.9933	0.0053	0.0098	0.0199	3	3	3	3	3	15	100
39003	21	0.9974	0.0123	0.9975	0.0038	0.0069	0.0008	3	3	3	3	3	15	100
39004	21	0.9786	0.0148	0.9786	0.01	0.0113	0.0437	3	3	3	3	3	15	100
40007	21	0.9994	0.0171	0.9994	0.0158	0.0277	0.0395	3	3	3	3	2	14	93.3
40009	21	0.9952	0.0142	0.9953	0.0053	0.0081	-0.0013	3	3	3	3	3	15	100
40027	21	1.0004	0.0063	1.0004	0.0086	0.0156	0.023	3	3	3	3	3	15	100
43001	21	1.0239	0.0074	1.0239	0.0133	0.0205	-0.0414	3	3	3	3	3	15	100
43003	21	0.9737	0.0139	0.9737	0.0201	0.0184	0.0173	2	3	2	2	3	12	80
45002	21	1.0081	0.0074	1.0081	0.0057	0.0132	-0.0307	3	3	3	3	3	15	100
46004	21	0.9743	0.0098	0.9743	0.0194	0.0187	0.0216	2	3	2	3	3	13	86.7
47001	21	0.9941	0.0129	0.9941	0.0052	0.006	0.0061	3	3	3	3	3	15	100
47004	21	0.9935	0.0157	0.9936	0.0045	0.0069	0.0212	3	3	3	3	3	15	100
47005	21	1.0071	0.0065	1.0071	0.0092	0.0102	0.0062	3	3	3	3	3	15	100
47006	21	0.991	0.0129	0.991	0.006	0.0087	0.0159	3	3	3	3	3	15	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	11	0.9934	0.0583	0.9934	0.0038	0.0031	0.2408	3	3	3	3	3	15	100
01013	11	0.9939	0.0681	0.9939	0.0042	0.0033	0.1637	3	3	3	3	3	15	100
01018	11	1.0055	0.4367	1.0055	0.0077	0.0076	0.1842	3	3	3	3	3	15	100
01025	11	0.9976	0.4733	0.9976	0.0037	0.0032	0.0332	3	3	3	3	3	15	100
01040	11	1.0223	0.5517	1.0223	0.0118	0.0087	-0.9136	3	3	3	3	3	15	100
02004	11	0.9806	1.1172	0.9808	0.0327	0.0382	-1.2155	3	2	3	1	1	10	66.7
03001	11	1.022	0.4899	1.022	0.0158	0.0118	-0.4648	3	3	3	3	3	15	100
03006	11	1.0077	0.3639	1.0077	0.0082	0.0081	0.0399	3	3	3	3	3	15	100
04004	11	1.0156	0.2352	1.0156	0.0103	0.0075	-0.3979	3	3	3	3	3	15	100
04008	11	0.9901	0.4487	0.9902	0.0062	0.0043	0.2696	3	3	3	3	3	15	100
04009	11	0.9882	0.4266	0.9882	0.0066	0.0046	0.4399	3	3	3	3	3	15	100
04012	11	1.0114	0.3131	1.0114	0.0076	0.0056	-0.2868	3	3	3	3	3	15	100
04015	11	0.9803	0.4116	0.9804	0.0164	0.0141	0.2626	3	3	3	3	3	15	100
08001	11	0.9975	0.5382	0.9976	0.0047	0.0125	0.455	3	3	3	3	3	15	100
08003	11	0.9948	0.4786	0.9949	0.0061	0.0058	-0.0799	3	3	3	3	3	15	100
08006	11	0.9844	0.2323	0.9844	0.0114	0.0083	0.3389	3	3	3	3	3	15	100
08009	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0044	0.0037	-0.2089	3	3	3	3	3	15	100
08010	11	0.9934	0.0583	0.9934	0.0038	0.0031	0.2408	3	3	3	3	3	15	100
09001	11	1.0213	0.4572	1.0213	0.0184	0.0163	-0.2345	3	3	3	3	3	15	100
09005	11	1.0167	0.8472	1.0168	0.0198	0.0207	0.2874	3	3	3	3	3	15	100
09012	11	0.9891	0.6462	0.9892	0.0085	0.0081	0.202	3	3	3	3	3	15	100
09013	11	0.9865	0.2987	0.9866	0.0263	0.0322	-1.0366	3	3	3	2	1	12	80
09016	11	1.0229	0.277	1.0229	0.0114	0.0089	-1.0401	3	3	3	3	3	15	100
10005	11	1.005	0.7965	1.0051	0.0085	0.0094	0.1806	3	3	3	3	3	15	100
10007	11	0.9933	0.5295	0.9934	0.0048	0.0041	0.4212	3	3	3	3	3	15	100
11006	11	0.9975	0.5988	0.9976	0.005	0.0053	0.2811	3	3	3	3	3	15	100
11010	11	1.0039	0.3008	1.0039	0.0031	0.003	-0.1487	3	3	3	3	3	15	100
11020	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0044	0.0037	-0.2089	3	3	3	3	3	15	100
11023	11	0.9881	0.5824	0.9882	0.0068	0.0072	1.0811	3	3	3	3	3	15	100
11033	11	0.9976	0.4733	0.9976	0.0089	0.0122	1.0332	3	3	3	3	3	15	100
12001	11	1.0037	0.2815	1.0037	0.0089	0.0188	-1.0144	3	3	3	3	3	15	100
12002	11	0.9944	0.066	0.9944	0.0035	0.0025	0.1586	3	3	3	3	3	15	100
12008	11	0.994	0.065	0.994	0.0084	0.0184	1.1623	3	3	3	3	3	15	100
12016	11	1.0084	0.7833	1.0086	0.0062	0.005	-0.4003	3	3	3	3	3	15	100
12019	11	0.9967	0.5361	0.9967	0.0043	0.0031	0.1484	3	3	3	3	3	15	100
13002	11	1.023	0.6362	1.0231	0.0155	0.0133	-0.6948	3	3	3	3	3	15	100
13003	11	1.0145	0.5829	1.0146	0.0198	0.0208	0.4816	3	3	3	3	3	15	100
13016	11	0.9731	0.6138	0.9732	0.0253	0.022	0.114	2	3	2	2	3	12	80
13017	11	1.0048	0.2784	1.0048	0.0028	0.0026	-0.3196	3	3	3	3	3	15	100
13026	11	0.951	0.9707	0.9511	0.0565	0.0575	-0.6269	1	2	1	0	0	4	26.7
13053	11	0.9689	0.2713	0.9689	0.0238	0.0196	0.5831	2	3	2	2	3	12	80
13061	11	0.9929	0.6388	0.993	0.0057	0.0057	0.6809	3	3	3	3	3	15	100
13064	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0044	0.0037	-0.2089	3	3	3	3	3	15	100
13074	11	1.0129	0.2792	1.0129	0.0153	0.0164	0.1996	3	3	3	3	3	15	100
13084	11	1.039	1.0622	1.0393	0.0272	0.0247	-1.0007	1	2	1	2	2	8	53.3
13103	11	0.988	0.4243	0.988	0.0065	0.0042	0.4448	3	3	3	3	3	15	100
13145	11	1.0103	0.3358	1.0103	0.0154	0.0171	0.4692	3	3	3	3	3	15	100
14001	11	0.9795	0.6646	0.9796	0.0143	0.0138	0.8481	3	3	3	3	3	15	100
14003	11	0.994	0.065	0.994	0.004	0.0029	0.1623	3	3	3	3	3	15	100
14010	11	0.9657	0.3118	0.9657	0.024	0.0204	0.9426	2	3	2	2	3	12	80
14025	11	0.987	0.5064	0.9871	0.0089	0.0064	0.3251	3	3	3	3	3	15	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	11	0.9949	0.4521	0.9949	0.0066	0.006	-0.121	3	3	3	3	3	15	100
14046	11	0.994	0.065	0.994	0.004	0.0029	0.1623	3	3	3	3	3	15	100
15001	11	1.0132	0.4433	1.0132	0.0172	0.0224	0.3396	3	3	3	3	3	15	100
15006	11	1.0114	0.4338	1.0114	0.0059	0.0039	-0.4874	3	3	3	3	3	15	100
15011	11	1.0123	0.3718	1.0123	0.0086	0.0061	-0.3108	3	3	3	3	3	15	100
15012	11	1.0204	0.2094	1.0204	0.0159	0.0133	-0.3599	3	3	3	3	3	15	100
16002	11	1.0166	0.5969	1.0167	0.0111	0.0079	-0.4599	3	3	3	3	3	15	100
16006	11	1.0253	0.3655	1.0253	0.016	0.0111	-0.7563	2	3	2	3	3	13	86.7
17001	11	0.9959	0.9644	0.996	0.0086	0.0176	0.5943	3	2	3	3	3	14	93.3
18001	11	0.9986	0.5731	0.9987	0.0085	0.0094	-0.5995	3	3	3	3	3	15	100
21002	11	1.0046	0.3827	1.0047	0.0037	0.0032	-0.294	3	3	3	3	3	15	100
21005	11	1.0115	0.3425	1.0115	0.0067	0.0057	-0.4798	3	3	3	3	3	15	100
21006	11	0.9986	0.6436	0.9987	0.0055	0.0044	0.2481	3	3	3	3	3	15	100
22002	11	1.0092	0.4071	1.0092	0.0047	0.0035	-0.5245	3	3	3	3	3	15	100
22003	11	0.9832	0.2588	0.9832	0.0134	0.0306	2.4321	3	3	3	3	2	14	93.3
22004	11	1.005	0.2495	1.005	0.0032	0.0024	-0.2199	3	3	3	3	3	15	100
22006	11	0.9965	0.7744	0.9966	0.0055	0.0039	0.0022	3	3	3	3	3	15	100
22012	11	1.0114	0.4338	1.0114	0.0059	0.0039	-0.4874	3	3	3	3	3	15	100
22017	11	1.0288	0.4428	1.0288	0.0196	0.0151	-0.7759	2	3	2	3	3	13	86.7
22028	11	1.005	0.3242	1.005	0.0049	0.0041	-0.0194	3	3	3	3	3	15	100
23003	11	0.9934	0.0583	0.9934	0.0038	0.0031	0.2408	3	3	3	3	3	15	100
23008	11	1.0469	0.8896	1.047	0.0407	0.0401	-0.4981	1	3	1	0	0	5	33.3
23011	11	1.0124	0.8259	1.0125	0.008	0.0102	-1.1249	3	3	3	3	3	15	100
23015	11	0.9339	0.4562	0.9339	0.0612	0.0597	0.4521	0	3	0	0	0	3	20
23016	11	0.9933	0.0212	0.9933	0.0043	0.0036	0.221	3	3	3	3	3	15	100
23017	11	0.988	0.4419	0.988	0.0198	0.0261	-0.574	3	3	3	3	2	14	93.3
23019	11	0.997	0.579	0.9971	0.0089	0.0105	-0.4792	3	3	3	3	3	15	100
23024	11	0.9806	0.7074	0.9807	0.013	0.0115	0.5853	3	3	3	3	3	15	100
23029	11	0.9933	0.0212	0.9933	0.0152	0.0177	-0.779	3	3	3	3	3	15	100
23067	11	0.9837	0.324	0.9838	0.0089	0.0059	0.5371	3	3	3	3	3	15	100
24012	11	1.0183	0.3254	1.0183	0.0233	0.0284	0.4066	3	3	3	2	2	13	86.7
25003	11	0.9997	0.5361	0.9997	0.0037	0.0034	0.0391	3	3	3	3	3	15	100
26001	11	1.0015	0.2704	1.0015	0.0105	0.0132	0.7599	3	3	3	3	3	15	100
26003	11	0.9763	0.3468	0.9764	0.0283	0.0294	-0.4271	3	3	3	1	2	12	80
26006	11	0.9922	0.7753	0.9923	0.0081	0.0084	0.3029	3	3	3	3	3	15	100
27014	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0044	0.0037	-0.2089	3	3	3	3	3	15	100
27020	11	0.9944	0.066	0.9944	0.0035	0.0025	0.1586	3	3	3	3	3	15	100
27044	11	0.9594	0.8081	0.9595	0.0487	0.0511	-0.6528	1	3	1	0	0	5	33.3
27046	11	0.9686	0.32	0.9686	0.0232	0.0184	0.6912	2	3	2	2	3	12	80
28002	11	1.0115	0.3425	1.0115	0.0067	0.0057	-0.4798	3	3	3	3	3	15	100
28003	11	0.9667	0.5136	0.9668	0.0512	0.0644	-1.441	2	3	2	0	0	7	46.7
28011	11	0.9827	0.5855	0.9828	0.0262	0.028	-0.8092	3	3	3	2	2	13	86.7
28016	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0159	0.022	0.7911	3	3	3	3	3	15	100
28017	11	1.0023	0.4775	1.0023	0.004	0.0035	-0.1026	3	3	3	3	3	15	100
28031	11	0.9519	0.6604	0.952	0.0472	0.0463	0.0709	1	3	1	0	0	5	33.3
28034	11	0.9845	0.8458	0.9846	0.0137	0.0181	0.1485	3	3	3	3	3	15	100
30004	11	0.9774	0.4353	0.9774	0.0362	0.0422	-0.9971	3	3	3	0	0	9	60
30005	11	1.0142	0.3455	1.0142	0.0069	0.0143	-1.0608	3	3	3	3	3	15	100
30006	11	1.0105	0.5291	1.0105	0.0196	0.0261	0.7635	3	3	3	3	2	14	93.3
31005	11	0.9687	0.3137	0.9687	0.0462	0.0576	-1.2018	2	3	2	0	0	7	46.7
32001	11	1.011	0.4072	1.011	0.0106	0.0099	-0.0397	3	3	3	3	3	15	100

[5] ＡＳＴ（ＧＯＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	11	1.0215	0.8659	1.0216	0.0118	0.0101	-1.3605	3	3	3	3	3	15	100
33001	11	1.0165	0.7491	1.0167	0.0135	0.0114	-0.2522	3	3	3	3	3	15	100
33005	11	1.0077	0.3639	1.0077	0.0049	0.0077	-0.9601	3	3	3	3	3	15	100
33008	11	0.9939	0.0681	0.9939	0.0077	0.0165	1.1637	3	3	3	3	3	15	100
33009	11	1.0183	0.3254	1.0183	0.0111	0.0075	-0.5934	3	3	3	3	3	15	100
34004	11	1.0025	0.4107	1.0025	0.0148	0.0222	1.0363	3	3	3	3	3	15	100
34009	11	1.0007	0.5399	1.0008	0.0045	0.0038	0.0917	3	3	3	3	3	15	100
34010	11	0.9946	0.0406	0.9946	0.0084	0.0164	1.1116	3	3	3	3	3	15	100
34011	11	1.0096	0.1521	1.0097	0.0061	0.0043	-0.297	3	3	3	3	3	15	100
34012	11	0.9208	0.6923	0.9209	0.0909	0.0964	-0.9458	0	3	0	0	0	3	20
34015	11	0.9939	0.0681	0.9939	0.0042	0.0033	0.1637	3	3	3	3	3	15	100
35001	11	1.0061	0.2727	1.0061	0.0044	0.0037	-0.2089	3	3	3	3	3	15	100
39001	11	1.021	0.5283	1.021	0.0176	0.0178	-0.2813	3	3	3	3	3	15	100
39002	11	1.0183	0.3254	1.0183	0.0111	0.0075	-0.5934	3	3	3	3	3	15	100
39003	11	1.0051	0.8336	1.0052	0.0093	0.0163	-0.9317	3	3	3	3	3	15	100
39004	11	1.0015	0.2704	1.0015	0.0025	0.0023	-0.2401	3	3	3	3	3	15	100
40007	11	1.0114	0.4338	1.0114	0.0059	0.0039	-0.4874	3	3	3	3	3	15	100
40009	11	0.9937	0.6944	0.9937	0.0089	0.0148	-0.2101	3	3	3	3	3	15	100
40027	11	1.0035	0.1965	1.0035	0.0125	0.0195	0.7516	3	3	3	3	3	15	100
43001	11	1.022	0.3823	1.022	0.0348	0.0406	0.9357	3	3	3	0	0	9	60
43003	11	0.9526	1.6609	0.953	0.0446	0.0379	0.2329	1	0	1	0	1	3	20
45002	11	1.0095	0.2472	1.0095	0.0101	0.0092	0.0483	3	3	3	3	3	15	100
46004	11	0.9939	0.0681	0.9939	0.0042	0.0033	0.1637	3	3	3	3	3	15	100
47001	11	0.9933	0.0212	0.9933	0.0152	0.0177	-0.779	3	3	3	3	3	15	100
47004	11	1	0.3179	1	0.0026	0.0021	-0.1203	3	3	3	3	3	15	100
47005	11	1.0167	0.6614	1.0167	0.0176	0.0185	0.0871	3	3	3	3	3	15	100
47006	11	1.018	0.6348	1.0181	0.0159	0.0135	-0.1672	3	3	3	3	3	15	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	11	0.9998	0.2557	0.9998	0.0039	0.0044	-0.2728	3	3	3	3	3	15	100
01013	11	1.0144	0.6025	1.0144	0.0202	0.0238	0.4338	3	3	3	3	3	15	100
01018	11	0.9832	1.079	0.9835	0.0146	0.0145	0.1579	3	2	3	3	3	14	93.3
01025	11	1.0078	0.3133	1.0078	0.0077	0.0073	-0.025	3	3	3	3	3	15	100
01040	11	0.9987	0.3205	0.9988	0.0067	0.012	0.5707	3	3	3	3	3	15	100
02004	11	1.0617	1.0612	1.062	0.025	0.0424	-5.9916	0	2	0	3	0	5	33.3
03001	11	0.9976	0.1649	0.9977	0.0042	0.0057	-0.1223	3	3	3	3	3	15	100
03006	11	0.9975	0.4249	0.9976	0.0051	0.0057	0.4946	3	3	3	3	3	15	100
04004	11	1.0099	0.5741	1.01	0.0086	0.0124	-0.9242	3	3	3	3	3	15	100
04008	11	0.9976	0.1649	0.9977	0.0042	0.0057	-0.1223	3	3	3	3	3	15	100
04009	11	0.9963	0.4946	0.9964	0.0061	0.0119	0.5812	3	3	3	3	3	15	100
04012	11	1.0197	0.673	1.0198	0.0175	0.0185	-0.1645	3	3	3	3	3	15	100
04015	11	0.9707	0.2311	0.9707	0.0168	0.0195	1.1774	3	3	3	3	3	15	100
08001	11	1.0082	0.4672	1.0083	0.0121	0.0162	0.2909	3	3	3	3	3	15	100
08003	11	1.0168	0.6295	1.0169	0.0084	0.0075	-0.9434	3	3	3	3	3	15	100
08006	11	0.9961	0.372	0.9962	0.0111	0.0145	-0.5152	3	3	3	3	3	15	100
08009	11	1.0048	0.3946	1.0048	0.0045	0.0068	-0.4622	3	3	3	3	3	15	100
08010	11	0.9998	0.2557	0.9998	0.0095	0.0123	0.7272	3	3	3	3	3	15	100
09001	11	1.0177	0.3895	1.0177	0.0103	0.0098	-0.6578	3	3	3	3	3	15	100
09005	11	1.0078	0.4897	1.0079	0.0043	0.0043	-0.6273	3	3	3	3	3	15	100
09012	11	0.9998	0.2557	0.9998	0.0095	0.0123	0.7272	3	3	3	3	3	15	100
09013	11	1.0119	0.2858	1.012	0.0056	0.0076	-0.7743	3	3	3	3	3	15	100
09016	11	1.0333	0.3162	1.0333	0.0178	0.0141	-1.1747	2	3	2	3	3	13	86.7
10005	11	1.0148	0.4191	1.0149	0.0085	0.0123	-1.0444	3	3	3	3	3	15	100
10007	11	1.0078	0.3133	1.0078	0.0077	0.0073	-0.025	3	3	3	3	3	15	100
11006	11	0.9778	0.3264	0.9779	0.014	0.0177	0.8653	3	3	3	3	3	15	100
11010	11	1.0005	0.2501	1.0005	0.01	0.0127	0.7695	3	3	3	3	3	15	100
11020	11	1.0037	0.5715	1.0038	0.0151	0.0203	0.8161	3	3	3	3	3	15	100
11023	11	0.9992	0.3969	0.9992	0.0037	0.0041	0.1709	3	3	3	3	3	15	100
11033	11	1.0323	0.2893	1.0324	0.0421	0.045	0.7887	2	3	2	0	0	7	46.7
12001	11	1.0042	0.4243	1.0042	0.0056	0.0106	-0.6938	3	3	3	3	3	15	100
12002	11	1.0099	0.286	1.0099	0.007	0.008	-0.3239	3	3	3	3	3	15	100
12008	11	0.9957	0.6483	0.9958	0.012	0.0192	1.1132	3	3	3	3	3	15	100
12016	11	1.0235	0.6678	1.0236	0.0223	0.0223	-0.1993	2	3	2	3	3	13	86.7
12019	11	0.9931	0.3662	0.9931	0.004	0.0093	0.5036	3	3	3	3	3	15	100
13002	11	0.9808	0.2354	0.9809	0.0122	0.0104	0.5594	3	3	3	3	3	15	100
13003	11	1.0005	0.2501	1.0005	0.0025	0.0031	-0.2305	3	3	3	3	3	15	100
13016	11	0.9706	0.2934	0.9706	0.0441	0.051	-0.9575	3	3	3	0	0	9	60
13017	11	1.0091	0.5293	1.0092	0.0146	0.0194	-1.7721	3	3	3	3	3	15	100
13026	11	1.0082	0.4672	1.0083	0.0059	0.0079	-0.7091	3	3	3	3	3	15	100
13053	11	0.9822	0.4156	0.9823	0.0213	0.0214	-0.2487	3	3	3	3	3	15	100
13061	11	0.9904	0.2244	0.9904	0.0066	0.0059	0.2265	3	3	3	3	3	15	100
13064	11	0.9932	0.4749	0.9933	0.0083	0.0137	0.9639	3	3	3	3	3	15	100
13074	11	0.9898	0.6232	0.9899	0.0063	0.0057	0.6702	3	3	3	3	3	15	100
13084	11	1.0036	0.3927	1.0036	0.0038	0.0043	-0.3584	3	3	3	3	3	15	100
13103	11	0.975	0.1658	0.975	0.015	0.0169	0.9971	3	3	3	3	3	15	100
13145	11	1.0127	0.3051	1.0128	0.0149	0.0161	0.1764	3	3	3	3	3	15	100
14001	11	1.0124	1.1266	1.0127	0.0156	0.02	0.1138	3	2	3	3	3	14	93.3
14003	11	0.9889	0.8195	0.989	0.0094	0.0138	0.4047	3	3	3	3	3	15	100
14010	11	0.976	0.2646	0.976	0.0147	0.0122	0.7557	3	3	3	3	3	15	100
14025	11	0.9739	0.5094	0.9739	0.0178	0.0194	0.8795	3	3	3	3	3	15	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	11	1.0017	0.1383	1.0017	0.0095	0.0147	0.5793	3	3	3	3	3	15	100
14046	11	1.023	1.0436	1.0232	0.0171	0.0177	-0.4414	2	2	2	3	3	12	80
15001	11	1.0017	0.1383	1.0017	0.0039	0.0067	-0.4207	3	3	3	3	3	15	100
15006	11	0.9976	0.1649	0.9977	0.0042	0.0057	-0.1223	3	3	3	3	3	15	100
15011	11	0.9992	0.7907	0.9993	0.0066	0.0113	0.466	3	3	3	3	3	15	100
15012	11	1.0048	0.3946	1.0048	0.0123	0.0166	0.5378	3	3	3	3	3	15	100
16002	11	1.0565	0.3803	1.0565	0.0436	0.0372	-1.0353	0	3	0	0	1	4	26.7
16006	11	0.9881	0.7359	0.9882	0.0166	0.0186	-0.3366	3	3	3	3	3	15	100
17001	11	1.0251	0.5443	1.0252	0.0309	0.0331	0.43	2	3	2	2	1	10	66.7
18001	11	0.9805	0.9049	0.9807	0.009	0.0072	1.1696	3	3	3	3	3	15	100
21002	11	1.0136	0.4773	1.0137	0.0084	0.01	-0.6931	3	3	3	3	3	15	100
21005	11	1.013	0.3153	1.013	0.0058	0.0054	-0.8578	3	3	3	3	3	15	100
21006	11	1.0296	0.342	1.0296	0.0162	0.0136	-1.0076	2	3	2	3	3	13	86.7
22002	11	1.0005	0.5735	1.0006	0.0053	0.0083	-0.1343	3	3	3	3	3	15	100
22003	11	0.9845	0.9593	0.9847	0.013	0.0128	0.1919	3	2	3	3	3	14	93.3
22004	11	0.9976	0.1649	0.9977	0.0042	0.0057	-0.1223	3	3	3	3	3	15	100
22006	11	0.9829	0.2897	0.9829	0.0195	0.0203	-0.159	3	3	3	3	3	15	100
22012	11	1.0271	0.6479	1.0272	0.0192	0.017	-0.6457	2	3	2	3	3	13	86.7
22017	11	1.0263	0.3136	1.0263	0.0164	0.015	-0.8564	2	3	2	3	3	13	86.7
22028	11	1.0345	0.3342	1.0345	0.0223	0.0188	-0.9275	2	3	2	3	3	13	86.7
23003	11	1.0036	0.3927	1.0036	0.0038	0.0043	-0.3584	3	3	3	3	3	15	100
23008	11	1.0096	0.1875	1.0096	0.0169	0.0219	0.5208	3	3	3	3	3	15	100
23011	11	0.9931	0.4325	0.9931	0.0172	0.0203	-0.8336	3	3	3	3	3	15	100
23015	11	0.9711	1.3594	0.9715	0.0567	0.0622	-2.2481	3	1	3	0	0	7	46.7
23016	11	1.0005	0.2501	1.0005	0.0025	0.0031	-0.2305	3	3	3	3	3	15	100
23017	11	0.9854	0.8334	0.9855	0.0102	0.014	0.8797	3	3	3	3	3	15	100
23019	11	1.0096	0.1875	1.0096	0.0047	0.0058	-0.4792	3	3	3	3	3	15	100
23024	11	0.9931	0.4325	0.9931	0.0081	0.0116	1.1664	3	3	3	3	3	15	100
23029	11	0.9906	1.3671	0.9911	0.0148	0.0177	-0.4329	3	1	3	3	3	13	86.7
23067	11	1.0026	0.3594	1.0026	0.0142	0.0201	0.7575	3	3	3	3	3	15	100
24012	11	1.0127	0.5461	1.0127	0.011	0.0238	-1.498	3	3	3	3	3	15	100
25003	11	1.0054	0.4505	1.0054	0.0035	0.0039	-0.4268	3	3	3	3	3	15	100
26001	11	1.0201	0.1357	1.0201	0.0256	0.0266	0.4103	3	3	3	2	3	14	93.3
26003	11	0.9686	0.3009	0.9686	0.0295	0.0294	0.1525	3	3	3	2	2	13	86.7
26006	11	0.9983	0.6164	0.9983	0.0069	0.0123	0.4365	3	3	3	3	3	15	100
27014	11	1.0037	0.5715	1.0038	0.0151	0.0203	0.8161	3	3	3	3	3	15	100
27020	11	1.0222	0.0693	1.0222	0.0131	0.0118	-0.7259	3	3	3	3	3	15	100
27044	11	1.0027	0.3028	1.0027	0.0139	0.0255	-1.183	3	3	3	3	3	15	100
27046	11	0.9871	0.5978	0.9872	0.0146	0.0149	-0.1316	3	3	3	3	3	15	100
28002	11	1.0201	0.1357	1.0201	0.0256	0.0266	0.4103	3	3	3	2	3	14	93.3
28003	11	0.96	0.5919	0.9601	0.0474	0.0528	-0.5281	2	3	2	0	0	7	46.7
28011	11	0.9808	0.5744	0.9809	0.0099	0.008	0.7595	3	3	3	3	3	15	100
28016	11	0.9707	0.2311	0.9707	0.0168	0.0195	1.1774	3	3	3	3	3	15	100
28017	11	1.0004	0.2559	1.0004	0.0046	0.0069	-0.3482	3	3	3	3	3	15	100
28031	11	0.9854	0.6357	0.9855	0.0349	0.0443	-1.3206	3	3	3	1	0	10	66.7
28034	11	0.9545	0.5641	0.9545	0.0548	0.059	-0.6941	1	3	1	0	0	5	33.3
30004	11	0.9903	0.6867	0.9904	0.0349	0.0453	-1.6412	3	3	3	1	0	10	66.7
30005	11	1.0086	0.8632	1.0088	0.0111	0.0135	0.0644	3	3	3	3	3	15	100
30006	11	0.9971	0.5177	0.9971	0.0083	0.0139	0.7229	3	3	3	3	3	15	100
31005	11	0.9915	0.2921	0.9915	0.0222	0.0316	-0.9856	3	3	3	3	2	14	93.3
32001	11	1.0031	0.659	1.0032	0.0071	0.0069	0.0809	3	3	3	3	3	15	100

[6] ＡＬＴ（ＧＰＴ）　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	11	0.9983	0.6164	0.9983	0.0093	0.0116	-0.5635	3	3	3	3	3	15	100
33001	11	1.0004	0.2559	1.0004	0.0046	0.0069	-0.3482	3	3	3	3	3	15	100
33005	11	0.9673	0.7879	0.9674	0.0226	0.0216	0.7545	2	3	2	3	3	13	86.7
33008	11	1.0117	0.8884	1.0118	0.0175	0.0218	0.4327	3	3	3	3	3	15	100
33009	11	0.9516	0.9392	0.9517	0.0586	0.0619	-0.7257	1	3	1	0	0	5	33.3
34004	11	0.9906	0.2686	0.9906	0.0063	0.0128	1.0112	3	3	3	3	3	15	100
34009	11	0.978	0.3252	0.978	0.0226	0.0224	-0.0389	3	3	3	3	3	15	100
34010	11	0.9822	0.9443	0.9824	0.0139	0.0196	1.7523	3	3	3	3	3	15	100
34011	11	1.0096	0.1875	1.0096	0.0169	0.0219	0.5208	3	3	3	3	3	15	100
34012	11	0.9181	0.4675	0.9182	0.0977	0.1056	-1.1318	0	3	0	0	0	3	20
34015	11	1.0144	0.6025	1.0144	0.0202	0.0238	0.4338	3	3	3	3	3	15	100
35001	11	1.0048	0.3946	1.0048	0.0123	0.0166	0.5378	3	3	3	3	3	15	100
39001	11	1.0025	0.6328	1.0026	0.0065	0.0101	-0.4753	3	3	3	3	3	15	100
39002	11	0.9896	0.5896	0.9897	0.0093	0.0172	1.1508	3	3	3	3	3	15	100
39003	11	1.0125	0.5691	1.0126	0.0083	0.0095	-0.4119	3	3	3	3	3	15	100
39004	11	1.0179	0.5433	1.018	0.0083	0.0068	-0.8277	3	3	3	3	3	15	100
40007	11	1.0099	0.2399	1.0099	0.0054	0.0064	-0.5243	3	3	3	3	3	15	100
40009	11	1.0077	0.6962	1.0078	0.0077	0.0084	-0.3428	3	3	3	3	3	15	100
40027	11	0.9921	0.5125	0.9921	0.0065	0.0081	0.2977	3	3	3	3	3	15	100
43001	11	1.0099	0.5741	1.01	0.0113	0.0144	0.0758	3	3	3	3	3	15	100
43003	11	0.9145	0.4705	0.9146	0.0869	0.0854	-0.1109	0	3	0	0	0	3	20
45002	11	0.9971	0.5177	0.9971	0.0066	0.0085	-0.2771	3	3	3	3	3	15	100
46004	11	1.0017	0.1383	1.0017	0.0095	0.0147	0.5793	3	3	3	3	3	15	100
47001	11	1.003	0.9043	1.0031	0.0114	0.0135	0.569	3	3	3	3	3	15	100
47004	11	1.0277	0.2761	1.0277	0.0159	0.0135	-0.9728	2	3	2	3	3	13	86.7
47005	11	1.0201	0.1074	1.0201	0.0126	0.0107	-0.6181	3	3	3	3	3	15	100
47006	11	1.0103	0.7158	1.0104	0.0263	0.031	1.1456	3	3	3	2	2	13	86.7

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	11	0.9924	0.0837	0.9924	0.0047	0.0041	0.2768	3	3	3	3	3	15	100
01013	11	1.0045	0.4085	1.0045	0.0048	0.0089	-0.843	3	3	3	3	3	15	100
01018	11	1.0268	0.3122	1.0268	0.0293	0.0302	0.2374	2	3	2	2	2	11	73.3
01025	11	0.9822	0.2771	0.9822	0.0084	0.0066	0.9676	3	3	3	3	3	15	100
01040	11	0.9929	0.0769	0.9929	0.0042	0.0035	0.2733	3	3	3	3	3	15	100
02004	11	1.0204	0.2584	1.0204	0.017	0.0166	-0.3452	3	3	3	3	3	15	100
03001	11	0.9956	0.6274	0.9957	0.0058	0.0067	0.6047	3	3	3	3	3	15	100
03006	11	1.0219	0.1595	1.0219	0.0184	0.0178	-0.3307	3	3	3	3	3	15	100
04004	11	0.9998	0.5559	0.9999	0.0048	0.0059	0.2468	3	3	3	3	3	15	100
04008	11	1.0189	0.62	1.019	0.0217	0.0231	0.234	3	3	3	3	3	15	100
04009	11	1.0238	0.3946	1.0238	0.0251	0.0263	0.1225	3	3	3	2	3	14	93.3
04012	11	0.9998	0.6926	0.9999	0.007	0.0104	-0.3547	3	3	3	3	3	15	100
04015	11	0.9787	0.312	0.9787	0.0151	0.013	0.5787	3	3	3	3	3	15	100
08001	11	1.0241	0.5102	1.0241	0.0209	0.0184	-0.3086	3	3	3	3	3	15	100
08003	11	1.0119	0.3447	1.0119	0.0121	0.0125	0.0209	3	3	3	3	3	15	100
08006	11	1.0014	0.349	1.0014	0.0024	0.0024	-0.1553	3	3	3	3	3	15	100
08009	11	1.001	0.3573	1.001	0.0047	0.005	0.3334	3	3	3	3	3	15	100
08010	11	0.9648	0.5663	0.9649	0.0236	0.0221	1.102	1	3	1	3	3	11	73.3
09001	11	1.007	0.4202	1.0071	0.0084	0.0085	0.127	3	3	3	3	3	15	100
09005	11	0.9928	0.0809	0.9928	0.0142	0.0158	-0.719	3	3	3	3	3	15	100
09012	11	1.0005	0.3419	1.0005	0.0131	0.0153	-1.2926	3	3	3	3	3	15	100
09013	11	0.9815	0.3309	0.9815	0.0216	0.0229	-0.2809	3	3	3	3	3	15	100
09016	11	1.0147	0.6202	1.0148	0.0184	0.0192	0.35	3	3	3	3	3	15	100
10005	11	0.9998	0.4528	0.9999	0.0038	0.0034	-0.1528	3	3	3	3	3	15	100
10007	11	0.997	0.5161	0.9971	0.0123	0.0143	-0.9528	3	3	3	3	3	15	100
11006	11	1.0191	0.5487	1.0191	0.0178	0.0161	-0.1212	3	3	3	3	3	15	100
11010	11	0.9928	0.5007	0.9929	0.0045	0.004	0.4806	3	3	3	3	3	15	100
11020	11	1.0143	0.3611	1.0144	0.0071	0.0119	-1.6871	3	3	3	3	3	15	100
11023	11	1.02	0.6009	1.02	0.0247	0.0263	0.4515	3	3	3	3	3	15	100
11033	11	1.0204	1.2027	1.0206	0.015	0.0146	-0.7444	3	1	3	3	3	13	86.7
12001	11	0.9868	0.3688	0.9868	0.008	0.0132	1.5842	3	3	3	3	3	15	100
12002	11	1.0041	0.2347	1.0041	0.0091	0.0142	-1.1122	3	3	3	3	3	15	100
12008	11	0.9984	0.3788	0.9984	0.0069	0.0102	-0.4814	3	3	3	3	3	15	100
12016	11	0.9929	0.0769	0.9929	0.0068	0.0116	1.2733	3	3	3	3	3	15	100
12019	11	0.9911	0.8221	0.9912	0.0156	0.0189	-0.6113	3	3	3	3	3	15	100
13002	11	1.0246	0.8254	1.0248	0.0141	0.0118	-1.1799	3	3	3	3	3	15	100
13003	11	0.9928	0.5007	0.9929	0.0045	0.004	0.4806	3	3	3	3	3	15	100
13016	11	0.9659	0.2591	0.9659	0.0304	0.0297	0.3114	2	3	2	2	2	11	73.3
13017	11	0.9896	0.5927	0.9896	0.0056	0.0067	0.9477	3	3	3	3	3	15	100
13026	11	0.9995	0.7438	0.9996	0.0254	0.0339	-2.3677	3	3	3	2	1	12	80
13053	11	0.9829	0.4019	0.983	0.0194	0.021	-0.212	3	3	3	3	3	15	100
13061	11	0.9896	0.5927	0.9896	0.011	0.0108	-0.0523	3	3	3	3	3	15	100
13064	11	1.0044	0.1986	1.0044	0.0085	0.0128	-1.1724	3	3	3	3	3	15	100
13074	11	0.981	0.2725	0.981	0.0089	0.0071	0.9632	3	3	3	3	3	15	100
13084	11	1.0038	0.2788	1.0038	0.01	0.0113	0.5903	3	3	3	3	3	15	100
13103	11	1.0117	0.9811	1.0118	0.015	0.014	0.301	3	2	3	3	3	14	93.3
13145	11	1.048	0.0854	1.048	0.0444	0.0435	-0.37	1	3	1	0	0	5	33.3
14001	11	1.0211	0.256	1.0211	0.0288	0.0311	0.655	3	3	3	2	2	13	86.7
14003	11	1.019	0.7626	1.0191	0.0237	0.0252	0.4315	3	3	3	3	3	15	100
14010	11	0.9843	0.6929	0.9844	0.024	0.026	-0.8493	3	3	3	3	3	15	100
14025	11	1.0207	0.4845	1.0207	0.0237	0.0249	0.2791	3	3	3	3	3	15	100

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	11	1.0181	0.3757	1.0181	0.023	0.0251	0.4607	3	3	3	3	3	15	100
14046	11	1.0054	0.5987	1.0054	0.0052	0.0092	-0.7205	3	3	3	3	3	15	100
15001	11	1.0181	0.3757	1.0181	0.023	0.0251	0.4607	3	3	3	3	3	15	100
15006	11	0.9935	0.6129	0.9935	0.0055	0.0064	0.5833	3	3	3	3	3	15	100
15011	11	1.0253	0.6264	1.0254	0.0303	0.032	0.4526	3	3	3	2	2	13	86.7
15012	11	1.0148	0.698	1.0149	0.0221	0.0245	0.6695	3	3	3	3	3	15	100
16002	11	0.9997	0.485	0.9998	0.0106	0.0154	0.9971	3	3	3	3	3	15	100
16006	11	1.008	0.4626	1.0081	0.0106	0.0104	0.2359	3	3	3	3	3	15	100
17001	11	1.0085	0.2968	1.0085	0.0083	0.0076	-0.022	3	3	3	3	3	15	100
18001	11	1.0005	0.3419	1.0005	0.0079	0.0096	0.7074	3	3	3	3	3	15	100
21002	11	0.9967	0.4343	0.9968	0.0036	0.003	0.1241	3	3	3	3	3	15	100
21005	11	1.0119	0.3447	1.0119	0.0045	0.0039	-0.9791	3	3	3	3	3	15	100
21006	11	0.9913	0.5854	0.9914	0.0092	0.0094	-0.0379	3	3	3	3	3	15	100
22002	11	1.0138	0.7983	1.0139	0.0111	0.0156	-1.9292	3	3	3	3	3	15	100
22003	11	1.011	0.3485	1.011	0.009	0.0081	-0.1813	3	3	3	3	3	15	100
22004	11	0.9977	0.4685	0.9977	0.0057	0.0098	0.6256	3	3	3	3	3	15	100
22006	11	1.0041	0.3214	1.0041	0.0031	0.0029	-0.3114	3	3	3	3	3	15	100
22012	11	0.9871	0.3281	0.9871	0.0069	0.0052	0.5203	3	3	3	3	3	15	100
22017	11	0.9998	0.5615	0.9999	0.0038	0.0046	0.2013	3	3	3	3	3	15	100
22028	11	1.0147	0.2141	1.0147	0.0193	0.0215	0.3927	3	3	3	3	3	15	100
23003	11	0.9938	0.565	0.9939	0.0068	0.0065	-0.0581	3	3	3	3	3	15	100
23008	11	1.0177	0.6396	1.0177	0.0172	0.0153	-0.0469	3	3	3	3	3	15	100
23011	11	0.9716	0.2481	0.9716	0.024	0.0231	0.4546	2	3	2	3	3	13	86.7
23015	11	1.0034	0.2697	1.0034	0.0023	0.0025	-0.2059	3	3	3	3	3	15	100
23016	11	0.9971	0.4066	0.9971	0.0064	0.0069	-0.3547	3	3	3	3	3	15	100
23017	11	0.9935	0.5726	0.9935	0.0091	0.0115	-0.2174	3	3	3	3	3	15	100
23019	11	0.9937	0.5239	0.9938	0.0048	0.004	0.3451	3	3	3	3	3	15	100
23024	11	0.978	0.5301	0.978	0.022	0.0219	0.0019	3	3	3	3	3	15	100
23029	11	0.9928	0.0809	0.9928	0.0142	0.0158	-0.719	3	3	3	3	3	15	100
23067	11	0.9998	0.3573	0.9999	0.0051	0.0062	0.446	3	3	3	3	3	15	100
24012	11	1.0084	0.2271	1.0084	0.015	0.0184	0.6055	3	3	3	3	3	15	100
25003	11	0.9928	0.0809	0.9928	0.0045	0.0039	0.281	3	3	3	3	3	15	100
26001	11	0.9924	0.0837	0.9924	0.0152	0.0166	-0.7232	3	3	3	3	3	15	100
26003	11	1.0098	0.5322	1.0098	0.0043	0.0067	-1.0572	3	3	3	3	3	15	100
26006	11	0.9919	0.4515	0.9919	0.0128	0.0157	-0.4414	3	3	3	3	3	15	100
27014	11	1.0158	0.4584	1.0158	0.0072	0.0119	-1.6182	3	3	3	3	3	15	100
27020	11	0.9935	0.0689	0.9935	0.0045	0.0038	0.1838	3	3	3	3	3	15	100
27044	11	0.9997	0.485	0.9998	0.0031	0.0029	-0.0029	3	3	3	3	3	15	100
27046	11	0.9746	0.3993	0.9746	0.0359	0.0406	-0.9949	2	3	2	1	0	8	53.3
28002	11	0.9924	0.0837	0.9924	0.0047	0.0041	0.2768	3	3	3	3	3	15	100
28003	11	0.9987	0.371	0.9987	0.0031	0.0029	-0.1117	3	3	3	3	3	15	100
28011	11	0.997	0.6141	0.9971	0.0039	0.0035	0.2467	3	3	3	3	3	15	100
28016	11	1.0044	0.1986	1.0044	0.0029	0.0026	-0.1724	3	3	3	3	3	15	100
28017	11	0.9967	0.4343	0.9968	0.0036	0.003	0.1241	3	3	3	3	3	15	100
28031	11	0.9998	0.3573	0.9999	0.0067	0.0101	-0.554	3	3	3	3	3	15	100
28034	11	0.9959	0.5977	0.9959	0.0041	0.0035	0.3796	3	3	3	3	3	15	100
30004	11	1.0147	0.601	1.0147	0.0078	0.006	-0.8066	3	3	3	3	3	15	100
30005	11	0.9929	0.0769	0.9929	0.0259	0.0326	-1.7267	3	3	3	2	2	13	86.7
30006	11	1.0324	0.1522	1.0324	0.0314	0.0314	-0.1008	2	3	2	2	2	11	73.3
31005	11	0.9811	0.426	0.9811	0.0265	0.0295	-0.6981	3	3	3	2	2	13	86.7
32001	11	1.0038	0.2788	1.0038	0.01	0.0113	0.5903	3	3	3	3	3	15	100

[7] γ－ＧＴ　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	11	1.0025	0.2997	1.0025	0.0022	0.0022	-0.2527	3	3	3	3	3	15	100
33001	11	1.0143	0.3611	1.0144	0.0073	0.0057	-0.6871	3	3	3	3	3	15	100
33005	11	0.9943	0.5827	0.9944	0.0043	0.0039	0.4946	3	3	3	3	3	15	100
33008	11	0.9962	0.8452	0.9963	0.0149	0.0217	-1.0508	3	3	3	3	3	15	100
33009	11	1.0021	0.7841	1.0021	0.0193	0.0248	1.5838	3	3	3	3	3	15	100
34004	11	0.9899	0.586	0.9899	0.0062	0.0102	1.1489	3	3	3	3	3	15	100
34009	11	1.0211	0.4979	1.0211	0.0146	0.0124	-0.5443	3	3	3	3	3	15	100
34010	11	1.0167	0.7815	1.0168	0.01	0.0138	-1.9033	3	3	3	3	3	15	100
34011	11	1.0094	0.5883	1.0094	0.0068	0.0057	-0.2857	3	3	3	3	3	15	100
34012	11	1.0044	0.4103	1.0044	0.0062	0.0068	0.1707	3	3	3	3	3	15	100
34015	11	0.9832	0.2315	0.9832	0.0087	0.0064	0.7818	3	3	3	3	3	15	100
35001	11	0.9829	0.4019	0.983	0.0086	0.0066	0.788	3	3	3	3	3	15	100
39001	11	1.0171	0.8146	1.0173	0.0184	0.0182	0.1217	3	3	3	3	3	15	100
39002	11	1.014	0.2937	1.014	0.0346	0.0431	1.8879	3	3	3	1	0	10	66.7
39003	11	0.9901	0.54	0.9902	0.0086	0.008	0.1329	3	3	3	3	3	15	100
39004	11	0.9796	0.7314	0.9797	0.0278	0.0286	-0.7007	3	3	3	2	2	13	86.7
40007	11	1.0105	0.4392	1.0105	0.0122	0.0117	0.1501	3	3	3	3	3	15	100
40009	11	0.9964	0.5959	0.9965	0.0042	0.0035	0.3014	3	3	3	3	3	15	100
40027	11	1.0015	0.2949	1.0015	0.0024	0.0025	0.0413	3	3	3	3	3	15	100
43001	11	1.0083	0.573	1.0084	0.0105	0.0129	0.1304	3	3	3	3	3	15	100
43003	11	0.9763	0.4896	0.9763	0.0254	0.0265	-0.1548	2	3	2	2	3	12	80
45002	11	0.9919	0.4515	0.9919	0.0047	0.0039	0.5586	3	3	3	3	3	15	100
46004	11	1.0108	0.7021	1.0109	0.0209	0.0273	0.9551	3	3	3	3	2	14	93.3
47001	11	0.9928	0.0809	0.9928	0.0142	0.0158	-0.719	3	3	3	3	3	15	100
47004	11	1.0014	0.349	1.0014	0.0024	0.0024	-0.1553	3	3	3	3	3	15	100
47005	11	1.0056	0.7199	1.0056	0.0112	0.0124	0.5753	3	3	3	3	3	15	100
47006	11	0.9929	0.0769	0.9929	0.0068	0.0116	1.2733	3	3	3	3	3	15	100

[8] 血糖　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
01001	21	0.9843	0.5925	0.9843	0.008	0.0076	1.1729	2	3	2	3	3	13	86.7
01013	12	1.0027	0.3315	1.0027	0.0057	0.0069	−1.181	3	3	3	3	3	15	100
01018	21	0.9973	0.1135	0.9973	0.0009	0.001	0.3745	3	3	3	3	3	15	100
01025	21	0.9764	0.2621	0.9764	0.0137	0.0127	1.4735	1	3	1	2	3	10	66.7
01040	21	0.9834	0.2194	0.9834	0.0149	0.0147	0.2296	2	3	2	2	2	11	73.3
02004	21	0.9703	0.3579	0.9704	0.0245	0.024	0.7664	0	3	0	0	0	3	20
03001	21	0.9832	0.7697	0.9833	0.0056	0.0045	1.5462	2	2	2	3	3	12	80
03006	21	1.0032	0.4064	1.0033	0.002	0.0018	−0.291	3	3	3	3	3	15	100
04004	21	1.0074	0.2723	1.0075	0.0045	0.004	−0.383	3	3	3	3	3	15	100
04008	12	0.9873	0.7717	0.9874	0.0068	0.0066	0.8216	3	2	3	3	3	14	93.3
04009	12	1.0027	0.3315	1.0027	0.0016	0.0015	−0.181	3	3	3	3	3	15	100
04012	21	1.0337	0.3744	1.0337	0.0215	0.02	−1.569	0	3	0	0	1	4	26.7
04015	12	1.0173	0.3293	1.0173	0.007	0.0059	−1.405	2	3	2	3	3	13	86.7
08001	21	1.003	0.4534	1.0031	0.0128	0.014	1.3763	3	3	3	3	2	14	93.3
08003	21	0.9897	0.3936	0.9897	0.0131	0.0132	−0.39	3	3	3	3	3	15	100
08006	21	0.9909	0.3035	0.9909	0.0029	0.0024	0.9447	3	3	3	3	3	15	100
08009	21	0.9969	0.1735	0.9969	0.0012	0.0013	0.3787	3	3	3	3	3	15	100
08010	21	0.9956	0.1162	0.9956	0.0013	0.0013	0.5863	3	3	3	3	3	15	100
09001	21	0.9966	0.0883	0.9966	0.0014	0.0014	0.3682	3	3	3	3	3	15	100
09005	12	1.0026	0.3858	1.0026	0.0056	0.0063	−1.209	3	3	3	3	3	15	100
09012	21	0.9942	0.5097	0.9942	0.006	0.0061	−0.024	3	3	3	3	3	15	100
09013	21	1.0019	0.4311	1.002	0.0028	0.0027	0.0945	3	3	3	3	3	15	100
09016	21	1.0244	0.9549	1.0246	0.0097	0.0086	−2.069	2	1	2	3	3	11	73.3
10005	12	1.0034	0.4323	1.0034	0.006	0.0062	0.3388	3	3	3	3	3	15	100
10007	12	0.9925	0.5534	0.9925	0.0062	0.0062	0.2864	3	3	3	3	3	15	100
11006	21	1.0078	0.1365	1.0078	0.0041	0.0037	−0.507	3	3	3	3	3	15	100
11010	21	0.9905	0.432	0.9905	0.0025	0.0022	1.1837	3	3	3	3	3	15	100
11020	21	0.9956	0.601	0.9956	0.0091	0.0095	−0.634	3	3	3	3	3	15	100
11023	12	1.0128	1.11	1.013	0.0066	0.0072	−2.03	3	0	3	3	3	12	80
11033	21	1.0167	0.565	1.0168	0.0242	0.025	1.0979	3	3	3	0	0	9	60
12001	21	0.9976	0.4907	0.9976	0.0023	0.0023	0.4381	3	3	3	3	3	15	100
12002	12	0.9974	0.126	0.9974	0.0009	0.001	0.3199	3	3	3	3	3	15	100
12008	21	0.9842	1.6505	0.9846	0.0128	0.0121	0.4572	2	0	2	3	3	10	66.7
12016	21	1.0114	0.4343	1.0115	0.0056	0.0049	−0.804	3	3	3	3	3	15	100
12019	21	0.9991	0.4342	0.9992	0.0066	0.0076	−0.778	3	3	3	3	3	15	100
13002	12	1.0107	0.5831	1.0107	0.0052	0.0046	−0.802	3	3	3	3	3	15	100
13003	21	0.9966	0.6127	0.9966	0.0046	0.0047	−0.114	3	3	3	3	3	15	100
13016	21	0.9974	0.9331	0.9975	0.0092	0.0109	1.5183	3	1	3	3	3	13	86.7
13017	21	1.0032	0.4064	1.0033	0.002	0.0018	−0.291	3	3	3	3	3	15	100
13026	12	0.9936	0.4193	0.9936	0.0085	0.0089	−0.294	3	3	3	3	3	15	100
13053	12	1.0078	0.1365	1.0078	0.0032	0.0046	−1.507	3	3	3	3	3	15	100
13061	21	0.9892	0.5153	0.9893	0.0047	0.0058	2.0735	3	3	3	3	3	15	100
13064	21	0.9897	0.5086	0.9897	0.0042	0.0037	0.967	3	3	3	3	3	15	100
13074	21	1.0032	0.4064	1.0033	0.0083	0.0088	0.7091	3	3	3	3	3	15	100
13084	12	1.0263	0.6071	1.0263	0.0197	0.0191	−0.926	1	3	1	1	1	7	46.7
13103	21	1.0004	0.4036	1.0004	0.0025	0.003	−0.351	3	3	3	3	3	15	100
13145	21	1.0066	0.208	1.0066	0.0174	0.0184	1.5931	3	3	3	1	1	11	73.3
14001	21	1.0135	0.3452	1.0135	0.0091	0.0085	−0.564	3	3	3	3	3	15	100
14003	12	1.0115	0.263	1.0115	0.0044	0.0057	−1.862	3	3	3	3	3	15	100
14010	21	0.9945	0.59	0.9946	0.0106	0.0122	2.3847	3	3	3	3	3	15	100
14025	21	0.9976	0.4907	0.9976	0.0023	0.0023	0.4381	3	3	3	3	3	15	100

[8] 血糖　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
14030	21	1.004	0.566	1.004	0.0043	0.0043	0.0436	3	3	3	3	3	15	100
14046	21	1.0263	0.4726	1.0263	0.0183	0.0172	−1.092	1	3	1	1	2	8	53.3
15001	21	1.0011	0.5177	1.0012	0.0086	0.0096	1.0425	3	3	3	3	3	15	100
15006	21	1.0014	0.346	1.0014	0.0016	0.0015	−0.003	3	3	3	3	3	15	100
15011	21	0.9909	0.3035	0.9909	0.0029	0.0024	0.9447	3	3	3	3	3	15	100
15012	21	1.0001	0.387	1.0002	0.0056	0.0064	0.7431	3	3	3	3	3	15	100
16002	21	0.9928	0.5196	0.9928	0.007	0.0072	0.0874	3	3	3	3	3	15	100
16006	21	0.9938	0.5472	0.9938	0.0124	0.0133	−0.844	3	3	3	3	3	15	100
17001	12	0.9964	0.4978	0.9964	0.0023	0.0025	0.7072	3	3	3	3	3	15	100
18001	21	0.9892	0.5153	0.9893	0.0041	0.0038	1.0735	3	3	3	3	3	15	100
21002	12	0.9969	0.1735	0.9969	0.0012	0.0013	0.3787	3	3	3	3	3	15	100
21005	21	0.9956	0.1162	0.9956	0.0013	0.0013	0.5863	3	3	3	3	3	15	100
21006	21	0.9974	0.126	0.9974	0.0009	0.001	0.3199	3	3	3	3	3	15	100
22002	21	0.9787	0.5053	0.9787	0.0171	0.0164	0.5922	2	3	2	1	2	10	66.7
22003	21	0.9969	0.1735	0.9969	0.0012	0.0013	0.3787	3	3	3	3	3	15	100
22004	21	1.0115	0.4325	1.0115	0.006	0.0052	−0.706	3	3	3	3	3	15	100
22006	21	0.9913	0.2925	0.9913	0.0025	0.0021	0.8997	3	3	3	3	3	15	100
22012	21	1.0074	0.2571	1.0075	0.003	0.0025	−0.583	3	3	3	3	3	15	100
22017	21	1.0119	0.4103	1.0119	0.0043	0.0034	−1.069	3	3	3	3	3	15	100
22028	21	0.9954	0.5298	0.9954	0.0036	0.0037	0.1779	3	3	3	3	3	15	100
23003	21	0.9865	0.7141	0.9866	0.0078	0.0073	0.8565	3	3	3	3	3	15	100
23008	21	1.0149	0.4246	1.015	0.0081	0.0068	−0.938	3	3	3	3	3	15	100
23011	21	0.9965	0.1287	0.9965	0.0069	0.0073	−0.513	3	3	3	3	3	15	100
23015	12	0.9885	0.6946	0.9886	0.0204	0.0214	−1.318	3	3	3	1	1	11	73.3
23016	21	0.9966	0.4238	0.9966	0.0056	0.0059	−0.315	3	3	3	3	3	15	100
23017	21	0.9974	0.126	0.9974	0.0009	0.001	0.3199	3	3	3	3	3	15	100
23019	21	0.9966	0.0883	0.9966	0.0014	0.0014	0.3682	3	3	3	3	3	15	100
23024	21	1.0127	0.239	1.0127	0.012	0.012	−0.103	3	3	3	3	3	15	100
23029	21	0.9865	0.2126	0.9865	0.0164	0.0167	−0.421	3	3	3	2	2	13	86.7
23067	21	0.9913	0.3843	0.9913	0.0067	0.0064	0.301	3	3	3	3	3	15	100
24012	21	1.0058	0.1793	1.0058	0.0037	0.0033	−0.285	3	3	3	3	3	15	100
25003	21	0.9965	0.1287	0.9965	0.0069	0.0073	−0.513	3	3	3	3	3	15	100
26001	21	1.0032	0.4064	1.0033	0.0083	0.0088	0.7091	3	3	3	3	3	15	100
26003	21	1.0087	0.6918	1.0087	0.004	0.0036	−0.708	3	3	3	3	3	15	100
26006	21	1.0154	1.4681	1.0157	0.0087	0.0077	−0.959	3	0	3	3	3	12	80
27014	21	0.9969	0.1735	0.9969	0.0012	0.0013	0.3787	3	3	3	3	3	15	100
27020	21	0.9974	0.126	0.9974	0.0009	0.001	0.3199	3	3	3	3	3	15	100
27044	31	0.9966	0.0883	0.9966	0.008	0.0087	−0.632	3	3	3	3	3	15	100
27046	12	1.0119	0.4103	1.0119	0.0114	0.0116	−0.069	3	3	3	3	3	15	100
28002	12	1.01	0.4876	1.0101	0.0034	0.0033	−1.247	3	3	3	3	3	15	100
28003	12	0.9966	0.0883	0.9966	0.0014	0.0014	0.3682	3	3	3	3	3	15	100
28011	21	0.9844	0.4672	0.9845	0.0137	0.0134	0.279	2	3	2	2	3	12	80
28016	21	1.0019	0.4311	1.002	0.0028	0.0027	0.0945	3	3	3	3	3	15	100
28017	21	0.9893	0.3034	0.9893	0.0064	0.006	0.6284	3	3	3	3	3	15	100
28031	12	1.0115	0.8844	1.0116	0.0246	0.0262	1.6923	3	2	3	0	0	8	53.3
28034	21	1.0068	0.6488	1.0069	0.0143	0.0151	1.0444	3	3	3	2	2	13	86.7
30004	21	1.0135	0.3452	1.0135	0.0042	0.0047	−1.564	3	3	3	3	3	15	100
30005	21	1.0114	0.4343	1.0115	0.0038	0.0051	−1.804	3	3	3	3	3	15	100
30006	12	0.9973	0.1135	0.9973	0.0009	0.001	0.3745	3	3	3	3	3	15	100
31005	21	0.9887	0.6835	0.9888	0.0153	0.0157	−0.551	3	3	3	2	2	13	86.7
32001	21	1.0064	0.2106	1.0064	0.0026	0.0023	−0.537	3	3	3	3	3	15	100

[8] 血糖　自施設測定施設解析値結果一覧

施設コード	測定法	解析値						評価点					解析値合計点	解析値評価点
		回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２	y切片	回収率	再現性	tanθ	ＰＩ１	ＰＩ２		
32002	21	0.9977	1.2285	0.9979	0.0116	0.0139	1.9259	3	0	3	3	2	11	73.3
33001	12	1.0078	0.1365	1.0078	0.0041	0.0037	−0.507	3	3	3	3	3	15	100
33005	12	0.9974	0.5482	0.9974	0.0117	0.0126	−1.27	3	3	3	3	3	15	100
33008	21	1.011	0.3373	1.011	0.0057	0.0049	−0.736	3	3	3	3	3	15	100
33009	21	1.026	0.3571	1.026	0.0373	0.039	1.5511	1	3	1	0	0	5	33.3
34004	21	0.9936	0.4193	0.9936	0.0023	0.0021	0.7064	3	3	3	3	3	15	100
34009	12	1.0337	0.4568	1.0337	0.0115	0.0129	−3.97	0	3	0	3	3	9	60
34010	21	1.0064	0.4084	1.0065	0.0032	0.0028	−0.52	3	3	3	3	3	15	100
34011	21	1.0032	0.5033	1.0033	0.0031	0.0028	−0.139	3	3	3	3	3	15	100
34012	21	1.0058	0.1793	1.0058	0.0036	0.0052	−1.285	3	3	3	3	3	15	100
34015	21	0.9917	0.3065	0.9917	0.006	0.0056	0.3726	3	3	3	3	3	15	100
35001	21	1.0019	0.4311	1.002	0.0047	0.0056	−0.905	3	3	3	3	3	15	100
39001	21	0.9956	0.1162	0.9956	0.0013	0.0013	0.5863	3	3	3	3	3	15	100
39002	21	0.9976	0.4907	0.9976	0.0081	0.0096	1.4381	3	3	3	3	3	15	100
39003	21	1.0019	0.4311	1.002	0.0028	0.0027	0.0945	3	3	3	3	3	15	100
39004	21	0.9852	0.6908	0.9853	0.0064	0.0058	1.2411	2	3	2	3	3	13	86.7
40007	21	0.9913	0.7025	0.9914	0.004	0.0036	1.0998	3	3	3	3	3	15	100
40009	12	1.0067	0.6794	1.0068	0.0095	0.0124	−2.215	3	3	3	3	3	15	100
40027	21	0.9882	0.2869	0.9882	0.0037	0.003	1.2621	3	3	3	3	3	15	100
43001	21	1.0014	0.4365	1.0014	0.002	0.0026	−0.402	3	3	3	3	3	15	100
43003	21	0.992	0.4653	0.992	0.0085	0.0088	−0.07	3	3	3	3	3	15	100
45002	21	1.0056	0.8902	1.0057	0.0114	0.0123	0.8199	3	2	3	3	3	14	93.3
46004	21	0.9803	1.4276	0.9805	0.0171	0.0174	0.3742	2	0	2	1	2	7	46.7
47001	21	0.9966	0.4238	0.9966	0.0079	0.0089	1.685	3	3	3	3	3	15	100
47004	12	1.0004	0.4036	1.0004	0.0095	0.011	−1.351	3	3	3	3	3	15	100
47005	21	0.9703	0.3093	0.9703	0.0191	0.0179	1.5688	0	3	0	1	1	5	33.3
47006	21	1.0091	0.866	1.0092	0.0061	0.0057	−0.485	3	2	3	3	3	14	93.3

Ⅲ．各論的考察

◆ 【臨床化学検査】

◆ 【血液学検査】

◆ 【尿検査】

【臨床化学検査】


日常行われる臨床検査は、対外診断薬メーカー（以下、製造販売元）が提供する標準物質を用い、分析系を校正（キャリブレーション）することで、被験者検体の検査結果の保証が行われる。

生化学８項目（総コレステロール、中性脂肪、尿酸、クレアチニン、AST、ALT、γ-GT および血糖）については、日本赤十字社による献血血液を基とした試料に、リコンビナント酵素や標準物質の添加により８段階の濃度試料を調製している。配布前に試料の融解後の安定性を確認したところ、AST、ALT でそれぞれ-融解後冷蔵保存で徐々に測定値が低下する傾向が見られたが、融解後 48 時間で－2～4%程度であり、また、本調査における試料取り扱いに関して“融解後１時間以内に測定する“としていることから、今期使用した試料に問題はないと判断した。

今回（第 32 回）調査においても、例年通り各調査項目について検量用試料（キャリブレータ）の種類（ただし、酵素項目は検量法、HbA1c については標準液および検量方法の種類）およびトレーサビリティの確認に利用した標準品（HbA1c を除く）の調査を行った。

図１は酵素を除く７項目のキャリブレータの使用比率を前々回（第 30 回）から今回（第 32 回）までの３年間について積み上げグラフで示した。

図Ⅲ−1　検量用(キャリブレータ)の種類

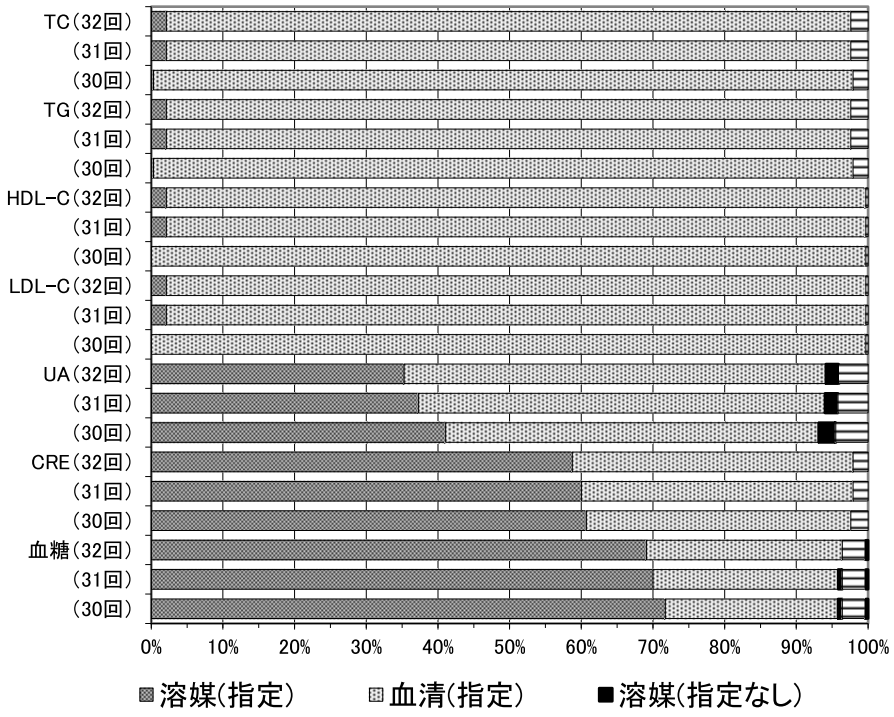

図Ⅲ-1 から、総コレステロール（TC）、中性脂肪（TG）、HDL コレステロール（HDL-C）および LDL コレステロール（LDL-C）については、ほとんどの施設においてキャリブ


レータは製造販売元指定の標準品が使用されている。尿酸（UA)、クレアチニン（CRE）についてはキャリブレータが製造販売元指定の標準品ではあるものの、血清ベースではない溶媒ベースのものが、それぞれ、35.9%、58.8%と高い。

血糖におけるキャリブレータに関しても、昨年度に引き続き製造販売元の推奨品（溶媒ベースおよび血清ベースのキャリブレータ）を使用している施設が 96.4%を占めているが、溶媒ベースのキャリブレータの使用が 69.1%になっている。

AST、ALT、γ-GT については、すべての施設が製造販売元の標準品のキャリブレータを使用している。

図Ⅲ-2 は、酵素を含む 10 項目のトレーサビリティの確認における標準品使用比率の推移を同様に過去 3 年間について積み上げグラフで示した。

図Ⅲ-2 トレーサビリティの確認における標準品の使用比率の推移

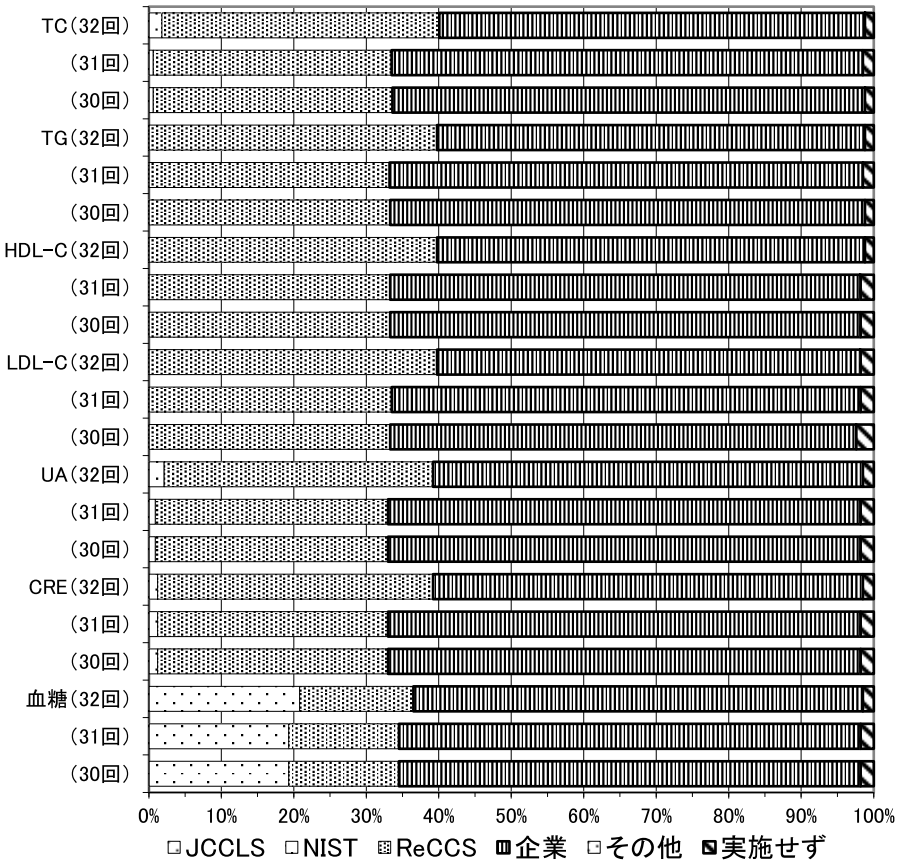


すべての施設は NIST、ReCCS または製造販売元のキャリブレータを使用しているが、トレーサビリティの確認をしていないと回答した施設が AST、ALT、γGT、総コレステロール（TC）および中性脂肪（TG）でそれぞれ 4 施設といずれも前回より 1 施設減少し、HDL コレステロールでは 4 施設で 2 施設減少したが、尿酸、クレアチニンおよび血糖で 5 施設、また LDL コレステロールでは 6 施設ある。これら施設では必ずトレーサビリテ

ィの確認を実施することを推奨する。

図Ⅲ-3 は、HbA1c 測定に用いられている測定法の推移を示したものである。第 28 回までは免疫学的測定法、酵素法、HPLC 法の順に採用している測定法が多かったが、第 29 回からは酵素法の使用頻度が増加し、今回は全体の半数近い 45.8%の施設が酵素法を採用している。HPLC 法の採用施設数が前回より 2 施設増加した。

図Ⅲ-3　HbA1c 測定法の推移

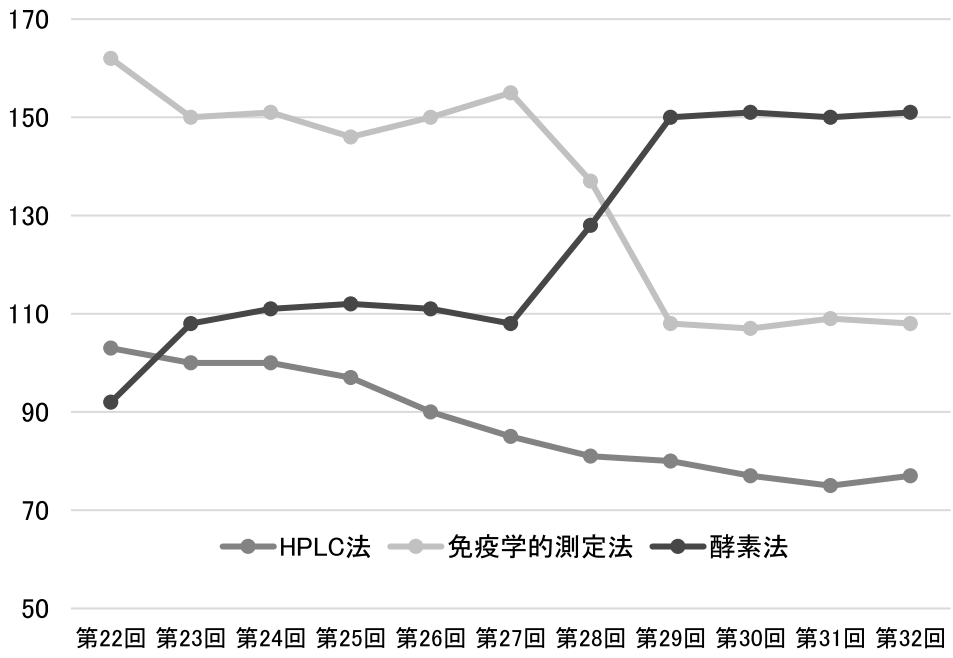

なお、すべての施設は製造販売元の指定検量方法、標準液を使用していた。

結果の詳細については各項目の各論においてそれぞれ述べることにする。

１）総コレステロール

総コレステロールの測定には 338 施設が参加した。前回より自施設測定 1 施設、外部施設測定 1 施設が増加したが、例年の平均的な参加施設数であった。参加施設の内訳は自施設測定数が 129 件（38.3 %）、外部施設測定数が 208 件（61.7 %）であった。

測定方法の分類はコレステロール酸化酵素法が自施設測定で 129 施設（38.3%）、外部施設測定で 208 施設（61.7%）、今回はコレステロール脱水素酵素法およびドライケミストリー法での参加施設は無かった。本精度管理調査のコレステロール測定法はコレステロール酸化酵素法に統一された。

測定値の濃度範囲は試料 1 が平均値で 148.88 mg/dL、試料 8 では 230.62 mg/dL で前回の濃度範囲（151.00 mg/dL～232.81 mg/dL）に比べ、低濃度域が昨年より 2.12 mg/dL、高濃度域が 2.19 mg/dL ほど低い値になった。総コレステロールの共用基準範囲（142～248 mg/dL）を考慮すると、低濃度は共用基準範囲の低域をカバーされている低い値で、また、高濃度についてはもっと高い値でカバーできる試料が求められた。

各試料の平均測定値は、低濃度域から 11～12 mg/dL の間隔で測定値が分布して、細かく測定の直線性が確認できた。

試料 1～8 の標準偏差は 0.91～1.45 mg/dL（前回：1.50～2.16 mg/dL）で、その変動係数は 0.57～0.73 %（前回 : 0.73～1.11 %）であった。標準偏差、変動係数とも前回と比べ、ややバラツキが小さくなった。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は製造販売元指定の血清ベースを使用しているのが 329 施設（97.6 %）で、血清ベースが最も多く使用されていた。しかし、溶媒ベースを使用しているのが 7 施設（2.1%）あり、自施設測定で 1 施設、外部施設測定で 6 施設にみられた。また、製造販売元指定以外の血清ベースを使用しているのが 8 施設（2.4%）で、前回と同様であった。すべての施設において測定試薬と最適な関係にある製造販売元指定の血清ベースの検量用試料を使用することが望まれる。

トレーサビリティの確認は NIST の標準品を用いている施設が 6 施設（1.8 %）、ReCCS の標準品が 129 施設（38.0 %）、企業の標準品が 198 施設（58.7 %）、実施していない施設が 4 施設（1.2 %）であった。前回と比べ、NIST の標準品を用いている施設が 3 施設（自施設測定）増え、ReCCS の標準品を用いている施設が 1 施設（自施設測定）増え、また、企業の標準品が 1 施設減り、実施していない施設が 1 施設減少した。このように NIST および ReCCs の上位の標準品を用いてトレーサビリティを確認している施設が増え、また、未実施の施設が減少して、良い傾向と思われる。なお、トレーサビリティの確認作業と総合評価点の関係については、NIST の標準品を用いてトレーサビリティの確認作業を実施している 6 施設（自施設測定：5、外部施設測定：1）の総合評価点は 100 点が 4 施設で、93.3 点が 1 施設、80.0 点が 1 施設であった。一方、実施していない 4 施設（自施設測定：3、外部施設設測定：1）の総合評価点は 100 点が 3 施設で、93.3 点が 1 施設であった。ま

た、60 点未満の 2 施設においても、企業の標準品を用いてトレーサビリティの確認作業は実施していた。トレーサビリティの確認作業は、これまでの関連学会の指導や精度管理調査報告会での説明によって現在では多くの施設の精度管理業務として実施されてきている。これまでと同様な説明であるが、すべての施設において、年間に 1 から 2 回程度、“企業の標準品”以上で確認するべきである。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は、90 点以上が 306 施設（構成比：90.8%、前回 94.3%、前々回 90.2%）、80 点以上～90 点未満が 25 施設（構成比：7.4 %、前回 2.4 %、前々回 7.7 %）、70 点以上～80 点未満は 2 施設（構成比：0.6 %、前回 2.1 %、前々回 1.8 %）、60 点以上～70 点未満は 2 施設（構成比：0.6 %、前回 0.3 %、前々回 0.0 %）、60 点未満が 2 施設（構成比：0.6 %、前回年 0.9 %、前々回 0.3 %、）であった。

参加数が 2 施設増加したが、前回と比較して、90 点以上の評価点を得た施設数が 10 施設減少し構成比も下降した。また、80 点以上～90 点未満の施設数が 17 施設増加し構成比も上昇した。70 点以上～80 点未満の施設が 5 施設減少、60 点以上～70 点未満は 1 施設増加、60 点未満の施設数は 1 施設減少した。このように、前回より 90 点以上の施設が減少し、80 点以上～90 点未満の施設が増加し、それ以下の点数の施設数に大きな変化がみられなかった。したがって、上位の成績の施設数が減少していて、全体としては成績の下降がみられ、残念に思われる。

日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き成績が維持されるように努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられた施設には改善と一層の努力が求められる。

２）中性脂肪

中性脂肪の測定には総コレステロールと同様に 337 施設の参加で、前回より自施設測定 2 施設が増加した。参加施設数の内訳は自施設測定が 129 施設（38.3 %）、外部施設測定が 208 施設（61.7%）であった。

測定方法の分類は酵素 UV 法（グリセロールを消去する方法）が自施設測定で 1 施設（0.3%）、外部施設測定では 1 施設（0.3 %）で、酵素比色法（グリセロールを消去する方法）は自施設測定で 128 施設（38.0%）、外部施設測定では 207 施設（61.4%）で、ドライケミストリー法による参加は無かった。

今回も酵素比色法（グリセロールを消去する方法）が全体の 99.4 %を占め、総コレステロールと同様に本精度管理調査の中性脂肪測定法は酵素比色法（グリセロールを消去する方法）に、ほぼ統一されたように思われた。なお、ここでは酵素 UV 法と酵素比色法の両測定法を総じた成績について報告する。

測定値の濃度範囲は試料 1 が平均値で 77.82 mg/dL、試料 8 では 141.08 mg/dL で前回の濃度範囲（80.64～135.80 mg/dL）に比べ、低濃度域が前回より 2.82 mg/dL ほど低い値になり、高濃度域は 5.28 mg/dL ほど高い値になった。中性脂肪の共用基準範囲（M:40～234 F:30～117 mg/dL）を考慮すると、低濃度はもっと低い値で、高濃度はもっと高い値で、広くカバーできる試料が求められる。

試料は低濃度域から約 9 mg/dL の間隔で測定値が分布して、やや細かく測定の直線性が確認できた。

試料 1～8 の標準偏差は 0.77～1.22 mg/dL（前回：1.32～2.26　mg/dL）で、その変動係数は 0.71～1.03 %（前回：1.42～1.77 %）であり、標準偏差、変動係数とも前回と比べて小さく、施設間のバラツキがやや小さくなったと思われた。

検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は総コレステロールと同様であった。血清ベースを使用しているのが 329 施設（97.6 %）で、血清ベースが最も多く使用されていた。しかし、溶媒ベースを使用しているのが 7 施設（2.1%）あり、自施設測定で 1 施設、外部施設測定で 6 施設にみられた。また、製造販売元指定以外の血清ベースを使用しているのが 8 施設（2.4%）で、前回と同様であった。すべての施設において測定試薬と最適な関係にある製造販売元指定の血清ベースの検量用試料を使用することが望まれる。

トレーサビリティの確認は NIST の標準品を用いているのが 0 施設（0.0 %）、ReCCS の標準品が 134 施設（39.8 %）、企業の標準品は 199 施設（59.0 %）、実施していない施設・不明な施設が 4 施設（1.2 %）であった。前回と比べ、ReCCS の標準品を用いている施設が 4 施設（自施設測定：3、外部施設測定：1）増え、企業の標準品を用いている施設が 1 施設減り、実施していない施設が 1 施設減った。ReCCs の上位の標準品を用いてトレーサビリティを確認している施設が増え、また、実施していない施設が減り、良い傾向と思われた。尚、トレーサビリティの確認作業と総合評価点の関係については、実施して

いない 4 施設（自施設測定：3、外部施設測定：1）の総合評価点は、3 施設が 100 点で、1 施設が 96.7 点であった。また、60 点以下の 1 施設においても、企業の標準品を用いてトレーサビリティの確認作業は実施していた。

今回の調査結果の総合評価点ランク別施設数は 90 点以上が 317 施設（構成比：94.1％、前回 97.0 ％、前々回 97.0 ％）、80 点以上～90 点未満が 15 施設（構成比：4.5 ％、前回 2.4％、前々回 2.4％）、70 点以上～80 点未満が 2 施設（構成比：0. 6%、前回 0.3％、前々回 0.0％）、60 点以上～70 点未満が 2 施設（構成比：0.6％、前回 0.0％、前々回 0.3％）、60 点未満が 1 施設（構成比：0.3%、前回 0.3 ％、前々回 0.3 ％）であった。

参加数が 2 施設増加したが前回と比較して、90 点以上の評価点を得た施設数は 7 施設減少し、構成比も下降した。80 点以上～90 点未満の施設数が 7 施設増加し構成比も上昇した。70 点以上～80 点未満の施設数が 1 施設増加し構成比も上昇した。60 点以上～70 点未満の施設数が 2 施設増加し構成比も上昇した。また、60 点未満の施設数が同様に 1 施設存在し、変化は無かった。このように、前回より 90 点以上の施設が減少し、80 点以上～90 点未満の施設が増加し、それ以下の点数の施設数に大きな変化がみられなかった。したがって、総コレステロールと同様に上位の成績の施設数が減少していて、全体としては成績の下降がみられ、残念に思われる。

日常業務で精度管理が正しく実施・維持されて、高い評価点を得た施設は引き続き成績が維持されるように努力していただき、評価点が低く、是正する内容がみられた施設には改善と一層の努力が求められる。

3）尿酸

尿酸測定の参加施設数は 337 施設で、前回に比べ 2 施設増加した。内訳は自施設測定が 129 施設（38.3%、前回より 1 施設増）、外部施設測定が 208 施設（61.7%、前回より 1 施設増）であった。

測定法別の分類は、337 施設、全施設でウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法であった。ウリカーゼ・ペルオキシダーゼ法による試料 1 から 8 までの濃度範囲は、測定値の平均で 5.03～7.80 mg/dL であり、平均 0.40 mg/ dL の濃度勾配を有する直線性が確認された。

各試料の標準偏差は、0.04～0.06mg/dL の範囲であり、全濃度域の変動係数は 0.62～0.92%で、前回（0.62～0.86%）と比べても良好な結果であった。

各施設が用いる検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定の血清ベース試料が 59.9%（202 施設）と最も多く、製造販売元指定の溶媒ベース試料が 35.9%（121 施設）、製造販売元指定以外の血清ベース試料が 4.2%（14 施設）であった。前回は製造販売元指定以外の溶媒ベース試料を使用している施設があったが、今回はなかった。

キャリブレータ使用比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品が 95.8%（323 施設）であり、前回の 94.0%（315 施設）より上昇していた。製造販売元指定の血清ベースの検量用試料使用施設は昨年度の 190 施設（56.7%）より 12 施設と大幅に増加しており、血清ベースにシフトしており望ましい傾向である。

トレーサビリティの確認は、企業の標準品を用いた施設が 59.3%（200 施設）で最多であり、次に ReCCS の標準品が 37.1%（125 施設）、NIST の標準品が 2.1%（7 施設）の順であった。その他の標準品を使用している施設はなかった。

参加施設の 98.5%（332 施設）がトレーサビリティの確認を実施しており、前回から微増で NIST の標準品の使用が増加した。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが浸透してきた結果と考えられる。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、90 点以上が 314 施設（93.2%、前回 91.6%）、60 点以上 90 点未満は 23 施設（6.8 %、前回 7.8%）、60 点未満の施設はなかった。

尿酸測定の調査試料の濃度範囲は適切と考えられた。今回の「総合評価点」は、全体でも 90 点以上を獲得した施設が 93.2%と、前回の 91.6%から軽度増加の結果であった。それ以上に 60 点未満の施設がなかったことは好ましい結果であった。また、トレーサビリティの確認は 332 施設（98.5%）が実施しているが、未だに未実施の施設が 5 施設（1.5%）あり、早急にトレーサビリティの確認を実施していただきたい。測定体系のトレーサビリティを確認し、日常検査においては適正なキャリブレーションを実行することが、検査精度を維持・向上させるために重要である

４）クレアチニン

クレアチニン測定の参加施設数は 337 施設で、前回に比べ 2 施設増加した。内訳は自施設測定が 129 施設（38.3%、前回より 1 施設増）、外部施設測定が 208 施設（61.7%、前回より 1 施設増）であった。

測定法別の分類は、336 施設が酵素法を 1 施設がドライケミストリ法を用いていた。

酵素法による試料 1 から 8 までの濃度範囲は測定値の平均で 0.48～4.99mg/dL であり、平均 0.64mg/dL の濃度勾配を有する直線性が確認された。

各試料の標準偏差は、0.01～0.05mg/dL の範囲であり、調査項目の中でも低値をとる項目である。また、全濃度域の CV は 1.00～2.84%であり、前回（1.05～2.36%）と大きな変化はなく、良好な結果であった。

各施設で用いた検量用試料（キャリブレータ）の使用比率は、製造販売元指定溶媒ベース試料が 58.8%（198 施設）と最も多く、製造販売元指定の血清ベース試料が 39.1%（132 施設）、製造販売元指定以外の血清ベース試料が 2.1%（7 施設）、製造販売元指定以外の溶媒ベース試料を利用している施設は今回なかった。

キャリブレータの使用比率は、製造販売元指定の溶媒または血清ベースの製品の比率が 97.9%（330 施設）で、前回の 97.9%（328 施設）と同等であった。製造販売元指定の血清ベースの検量用試料使用施設は昨年度の 127 施設から増加しており、望ましい傾向と言える。更なる増加が望まれる。

トレーサビリティの確認を実施している施設は 98.5%（332 施設）で、その内訳は企業の標準品を用いた施設が 59.3%（200 施設）であり、次に ReCCS の標準品が 38.0%（128 施設）、NIST の標準品が 1.2%（4 施設）の順であった。その他の標準品を使用している施設はなかった。なお、トレーサビリティを確認している施設数は、平成 18 年度（37.8%）から着実に増加してきた。平成 24 年度は一時的に 81.5%まで減少したが、平成 25 年度以降は再び増加し，今回も前回と同様の 98.5%で実施されていた。各施設で日常検査時のトレーサビリティの意義がよく理解され、精度保証の確立に向けて取り組みが一層浸透した結果と考えられる。

調査結果の全施設の平均値、標準偏差から集計した「平均値評価」と「解析値評価」から求めた「総合評価点ランク別施設数」は、90 点以上の施設が 321 施設（95.5%、前回 91.0%）、60 点以上 90 点未満は 5 施設（1.5%、前回 6.0%）、60 点未満は 10 施設（3.0%、前回 3.0%）であった。

90 点以上の施設の割合が前回より増加した、60 点未満の施設の割合は前回と同様であった。

60 点未満の施設は 10 施設のうち 8 施設は外部機関に委託していた。多く見られた傾向は、ばらつきには問題はないが高値の試料ほど大きくなる傾向がみられ回収率の低下が見られた。検量線の直線性には問題はないようだが、傾きにズレが生じていると考えられる。

標準液の問題が疑われる。

1 施設は 1 試料の結果に誤記入が疑われた。1 試料を除いた結果の精度には問題は見られなかった。測定だけでなく報告間違いも精度管理上を大きな問題となるため十分注意して対応していただきたい。

クレアチニン測定の試料については、各試料間の濃度勾配が一定に保たれており、調査試料の濃度範囲も適切であった。

今回の「総合評価点」は、90 点以上を獲得した施設は全体では 95.5%であり、前回の 91.0%より増加している結果であった。外部委託先の精度不良の影響は多くの施設に影響するため今回、誤差がみうけられた施設は、原因を究明し、改善を図っていただきたい。また委託している施設も適切な精度管理が行われているかを確認する必要がある。トレーサビリティの確認を 332 施設（98.5%）で実施しており、未実施施設 5 施設（1.5%）と前回から 1 施設減少していた。残りの施設も早急にトレーサビリティを確認するようにしていただきたい。

５）AST・ALT

参加施設337施設において、AST、ALTともにJSCC標準化対応法を使用している施設は全施設であった。

今回の試料活性はAST（19 ~146 U/L）、ALT（18 ~ 128 U/L）で、ASTは前回とほぼ同じ、ALTは前回と比較して低活性試料はほぼ同じ、高活性試料活性値がやや低くなっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を比較すると、ASTは低活性試料ではほぼ同等、高活性試料はやや収束し、ALTは前回と比較し収束した。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、AST、ALTともに企業の酵素キャリブレータを用いている施設が100%と高い利用率が保たれていた。

トレーサビリティの確認については全337施設中、JCCLSの標準品によるものが123施設（36.5%）、企業の標準品によるものが210施設（62.3%）、未実施4施設（1.2%）であった。その内訳は自施設測定129施設中、JCCLSの標準品によるものが16施設（12.4%）、企業の標準品によるものが110施設（85.3%）、未実施3施設（2.3%）であった。外部施設測定208施設中JCCLSの標準品によるものが107施設（51.4%）、企業の標準品によるものが100施設（48.1%）、未実施1施設（0.5%）であった。

今回のASTの総合評価の結果で90点以上の施設は311施設（92.3%）、80点以上90点未満の施設が11施設（3.3%）と、80点以上の施設が322施設95.6%であり、前回の95.5%とほぼ同等であった。60点未満の施設は4施設（1.2%）で、その内訳は自施設測定4施設（前回3施設）、外部施設測定0施設（前回1施設）であった。今回の総合点がASTで60点未満だった施設の詳細を確認すると、自施設測定、外部施設測定施設ともに、解析値評価点が非常に低かったため総合評価点が60点未満となっていた。今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

ALTの総合評価の結果で90点以上の施設は319施設（94.7%）、80点以上90点未満の施設が5施設（1.5%）と、80点以上の施設が324施設96.2%であり、前回の96.4%と比較してほぼ同等であった。60点未満の施設は3施設（0.9%）でその内訳は自施設測定2施設（前回1施設）、外部施設測定1施設（前回1施設）であった。ALT で60点未満だった施設の詳細を確認すると、測定値評価点はいずれも60点以上を超えていたが、解析値評価点が非常に低かったため総合評価点が60点未満となっていた。

次に解析値評価点に対しての結果では、今回ASTが60点未満だったのは自施設測定で10施設（前回9施設）、外部施設測定で4施設（前回4施設）あり、自施設測定では前回より悪化した。今回60点未満の施設については、全ての施設で回収率の結果が不良で、そのうち1施設については再現性も問題があった。解析値評価点

が60点未満となる要因は、比例系統誤差によるものが多く占められているが、今回は偶発誤差が発生していた施設もみられる。比例系統誤差がみられる要因は概してキャリブレーションの問題だが、偶発誤差はメンテナンス不良が主な要因となる。全ての施設でトレーサビリティの確認が行われていたが、各施設の測定値を検討し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回ASTの解析値評価点が60点未満の13施設のうち、今回80点以上だった施設が8施設あり改善された施設もあったが、一方で今回60点未満の施設が4施設あり、引き続き改善の努力をお願いしたい。

ALTの解析値評価点が60点未満だったのは自施設測定で9施設（前回9施設）、外部施設測定で3施設（前回2施設）あり、自施設測定で同等、外部施設測定では増加した。自施設測定の9施設について詳細な解析をすると、11施設で回収率の成績が不良で、1施設は再現性が不良であった。全ての施設でトレーサビリティの確認が行われていたが、各施設の測定値を検討し、今回どのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回ALTの解析値評価点が60点未満の11施設のうち、今回80点以上だった施設が6施設と改善された。しかし60点未満の施設が4施設であったため、引き続き改善の努力をお願いしたい。

以上全体的にみると本調査に参加した施設のASTとALT測定の技術水準は高いといえるが、今回はAST、ALTともに総合評価点が80点以上の施設が95％以上と一定の水準を満たしていると思われる。AST、ALTの解析値評価点が60点未満だった施設がASTは14施設（前回13施設）ALTは12施設（前回11施設）と前回と比較して微増している。今回新たに60点未満となった施設は、信頼性の高いデータが得られるよう改善していただきたい。

6）γ-GT

今回参加した337施設のうち全てがJSCC標準化対応法を使用していた。

今回の試料活性は30~157U/Lで前回と比較して低活性試料はほぼ同等、高活性試料でやや高値となっている。JSCC標準化対応法における同程度の活性試料の標準偏差を前回と比較すると、やや収束していた。

測定値の正確さに影響を与える各施設の検量法は、企業の酵素キャリブレータを用いている施設が100.0%と高い利用率が保たれていた。

トレーサビリティの確認については全337施設中、JCCLSの標準品によるものが123施設（36.5%）、企業の標準品によるものが210施設（62.3%）、未実施が4施設（1.2%）であった。その内訳は自施設測定129施設中、JCCLSの標準品によるものが16施設（12.4%）、企業の標準品によるものが110施設（85.3%）、未実施が3施設（2.3%）であった。外部施設測定208施設中JCCLSの標準品によるものが107施設（51.4%）、企業の標準品によるものが100施設（48.1%）、未実施が1施設（0.5%）であった。

今回総合点で90点以上の施設は324施設（96.1%）、80点以上90点未満の施設が10施設（3.0%）と80点以上の施設が334施設99.1%と前回の98.2%を上回る結果となった。80点以上の施設は自施設測定で129施設中126施設の97.7%（前回96.1%）、外部施設測定で208施設中全施設の100%（前回99.5%）と、自施設測定、外部施設測定ともに良好な結果だった。一方、総合点が60点未満だった施設は全337施設中、0施設であった。

解析値評価点に対しての解析では、今回60点未満だったのは自施設測定で2施設（前回5施設）、外部施設測定は0施設（前回0施設）であり、自施設測定で改善され、外部施設測定では前回に引き続き0施設であった。自施設測定の2施設について詳細な解析をすると、今回はいずれも回収率が低かったため、解析評価点が低くなっていた。前回に引き続き解析値評価点が低かった施設はどのような問題があったかその原因の究明を行って改善を図っていただきたい。

前回解析値評価点の低かった5施設については、今回全ての施設が100点と改善された。引き続き維持するよう努力されたい。

以上から、全体的にみると本調査に参加した施設のγ-GT測定の技術水準は高いと言えるが、総合評価点成績が良くても解析値評価点が低い施設はさらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

７）血糖

血糖測定の参加施設数は 337 施設（前回 335 施設）で、内訳は自施設測定が 129 施設（前回 128 施設)、外部施設測定が 209 施設（前年 207 施設）であり前回とほぼ同様であった。

測定法別分類は、表Ⅲ-4 のように自施設測定ではヘキソキナーゼ(HK)･UV 法が 78.3%、ブドウ糖酸化酵素(GOD)電極法が 20.9%であり、1 施設がブドウ糖脱水素酵素法(GDH 法)で測定していた。外部施設測定では HK･UV 法が 98.6%と大部分を占めており、この傾向は前回と同様であった。また測定機器は、日本電子 62.3%（前回 60.3%)、日立ハイテク 18.1%（前回 18.8%)、エイアンドティー4.7%（前回 5.1%)、キヤノンメディカルシステムズ 4.5%（前回 4.8%)、アークレイ 4.2%（前回 4.5%)、ベックマン・コールター3.0%（前回 3.3%)、ミナリスメディカル 2.7%（前年 3.0%)、その他 0.6%（前年 0.3%）でありこの傾向は前回と同様であった。

表Ⅲ-4　測定法別分類

測定法コード	測定法	自施設数	割合（%）	外部施設数	割合（%）
21	HK・UV 法	101	78.3	205	98.6
12	GOD 電極法	27	20.9	3	1.4
31	GDH 法	1	0.8	0	0
	合計	129	100.0	208	100.0

1 試料につき測定施設数が 5 施設以下の測定法（または測定試薬）については計算値の統計学的意義が乏しいことから「評価対象外」とした。「評価対象外」を除き、極端値（平均値±3SD）棄却後の試料 1~8 の平均濃度は 71.90～205.25mg/dL であり、前回の平均濃度とほぼ同じ範囲であった。また測定値標準偏差も前回とほぼ同じであった。特定健康診査・特定保健指導の階層化判定基準の 100mg/dL に近い試料 2 では平均値 90.86mg/dL、標準偏差 0.89mg/dL であり、試料 3 では平均値 109.78mg/dL、標準偏差 0.89mg/dL であった。糖尿病診断基準の 126 mg/dL に近い試料 4 では平均値 129.01mg/dL、標準偏差 0.96mg/dL であった。それぞれの平均値±2SD の範囲は、試料 2 で 89.97～91.75mg/dL、試料 3 で 108.89～110.67mg/dL、試料 4 で 128.05～129.97mg/dL であり測定方法、試薬、機器等による差は小さく、測定値は収束していることが伺われる結果であった。

各施設が採用している測定値の正確さに影響を与える検量用試料(キャリブレータ)の種類は、製造販売元指定の溶媒ベースが 69.1%（前回 70.4%）と最も多く、次いで製造販売元指定の血清ベースが 27.3%（前回 26.0%)、製造販売元指定以外の血清ベースが 3.3%（前回 3.3%)、その他が 0.3%（前回 0.3%）であった。トレーサビリティの確認については、企業の標準品を用いているのが 62.0%（前回 59.1%)、NIST の標準品が 20.8%（前

回 19.4%)、ReCCS の標準品が 15.7%（前回 19.7%）であった。トレーサビリティの確認を実施していない施設は 5 施設（1.5%）であり、全ての施設で適切なトレーサビリティの確認を実施していただきたい。

血糖測定値の評価は、同一測定法群の極端値（平均値±3SD）棄却後の平均値による測定値評価点と解析値による解析値評価点の平均値を総合評価点とした。測定値評価点は、測定値の正確さの評価を目的とする“望ましい性能” 2.2%を評価規準とし、平均値±0～2.2%を A、±2.3～4.4%を B、±4.5～6.6%を C、±6.7%～を D 評価とした。自施設では、総合評価点 100 点が 72.9%（前回 70.9%）、80 点以上 100 点未満が 19.4%（前回 20.5%）、60 点以上 80 点未満が 5.4%（前回 5.5%）、60 点未満は 2.3%（前回 3.1%）であり、100 点の施設は前回より増加していた。また外部施設では総合評価点 100 点が 83.2%（前回 88.9%）、80 点以上 100 点未満が 16.3%（前回 8.2%）、60 点以上 80 点未満が 0.5%（前回 1.0%）、60 点未満が 0%（前回 1.9%）と 80 点以上の施設は前年より増加していた。総合評価点が低下した施設は、分析装置のメンテナンス、試薬・校正物質・精度管理物質等の内部精度管理状況を確認し、さらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

今回、総合評価点 60 点未満の施設は 3 施設（全て自施設測定）であり、これらの施設は今後機器のメンテナンス、試薬や標準液管理等を確認していただきたい。前回総合評価点が 60 点未満であった 8 施設のうち 7 施設は改善がみられていたが、1 施設については前回とほぼ点数が変わっておらず、機器のメンテナンス、試薬や標準液管理等を再度確認し、確実に改善していただきたい。

以上、全体的にみると本調査参加施設の血糖測定の技術水準は高く、概ね良好であると考えられる。

８）HDL コレステロール

HDL コレステロールは、生活習慣病の検査として重要な脂質項目の一つであり、高い精密度・正確度の測定値が求められている。

HDL コレステロール項目への全参加施設数は前回と比較して 2 施設増加し、337 施設であった。今回の精度管理調査施設内訳としては、自施設測定での測定が 129 施設（38.3%)、外部機関への委託測定が 208 施設（61.7%）であった。外部委託比率に著変はない。

採用試薬はそれぞれ、コレステスト N-HDL、クオリジェント HDL(積水メディカル)が 177 施設（52.5%, うち外部委託 120 施設)、メタボリード HDL-C, AU リエージェント HDL-C（ミナリスメディカル)が 156 施設（46.3%, うち外部委託 87 施設)、L タイプ HDL-C M（富士フィルム和光純薬)が 4 施設（1.2%, うち外部委託 1 施設）であった。前回まで１施設採用していたドライケミストリー法ビトロス（オーソクリニカルダイアグノスティックス)を使用した施設はなかった。なお、採用施設数が 10 施設以下の試薬については評価対象外とした。

本調査における HDL コレステロールの評価は、試薬別平均値に差が存在することから、試薬別平均値を基準濃度として、それに個人の生理的変動を基本とした評価基準を用いてきた経緯があり、今回も同様な評価法とした。HDL における、全施設で 91 点以上の評価点取得施設比率を年度毎に比較したところ今回、前回、前々回はそれぞれ、91.1%, 93.7%, 89.6%であった。60 点未満、70 点未満の施設がわずかに認められたが、全体としては収束した結果が得られていると思われる。自施設で測定した結果（129 施設）のうち、90 点以上の成績だった割合を年度毎に比較したところ、今回、前回、前々回でそれぞれ 88.4%, 92.2%, 92.2%であった。一方で、外部施設で測定した結果（208 施設）のうち、90 点以上の成績だった割合を年度毎に比較したところ、今回、前回、前々回でそれぞれ 92.8%, 94.7%, 87.9%であった。今回の結果からは、外部施設の成績は維持されているものの、内部施設の成績が若干低下していると考えられる。参加施設数が少ないため評価対象外となっている施設は全体の測定値から自己評価を行って頂きたい。

5 施設以上で使用されている試薬別の変動係数（CV%)は、メタボリード HDL-C, AU リエージェント HDL-C（ミナリスメディカル)が 1.2%～1.9%、コレステスト N-HDL、クオリジェント HDL(積水メディカル)が 1.0%～1.3%であり、ほぼ同等のバラツキであると考えられる。また、試薬間差を確認するため、5 施設以上で使用されている試薬について測定値の平均値を比較すると、ミナリスメディカル < 積水メディカル < 富士フィルム和光純薬の傾向を示した。この結果から、非常に収束した結果が得られていると考えられる。

参加各施設で使用している検量用試料（キャリブレーター）をみると、全施設において血清・溶媒ベースキャリブレーターが使用されており、1 施設以外は試薬製造販売元指定のキャリブレーターであった。また、HDL コレステロールのトレーサビリティの確認において、ReCCS の標準品を利用する施設は、134 施設（39.8%)、企業の標準品を利用する施設

は、199 施設（59.1%）、その他の標準品を利用する施設は無く、企業の標準品を利用するを利用する施設が最も多かった。実施なしの施設は、4 施設（1.2%)であった。トレーサビリティの確認を実施していない 4 施設の内訳は、自施設測定が 3 施設であり、外部委託測定が 1 施設であった。トレーサビリティの確認は、患者検体の測定値の根拠に戻って測定するための重要な方法である。外部精度管理で正確性の確認がしづらい本項目などは定期的・積極的に標準物質等による正確性の確認を強く推奨する。

測定試料における反応性を検証した。ミナリスメディカル（メタボリード HDL-C, AU リエージェント HDL-C）と積水メディカル（コレステスト N-HDL、クオリジェント HDL）の平均値を比較すると、凍結乾燥品それぞれの 2 社データ平均値に対する平均値差（絶対値）の比率（%)はそれぞれ、10.0%, 13.8%, 14.0%でった。一方で、生血清での比率はそれぞれ、4.5%, 2.6%であった。このことから、HDL の凍結乾燥試料におけるメーカー間差は今回も確認することができ、ヒト血清以外の試料による正確性の確認が困難であることを示している。このため今回のサーベイの結果解析においても、変動の小さい測定試薬別評価を実施している。なお、評価対象試料で、5 施設以上で使用されている試薬別の変動係数（CV%)は、メタボリード HDL-C, AU リエージェント HDL-C（ミナリスメディカル)が 1.2%～1.9%、コレステスト N-HDL、クオリジェント HDL（積水メディカル)が 1.0%～1.3%であり、ほぼ同等のバラツキであると考えられる。また、試薬間差を確認するため、5 施設以上で使用されている試薬について測定値の平均値を比較すると、ミナリスメディカル < 積水メディカルの傾向を示した。

本項目の評価総評として HDL コレステロールの総合評価において、60 点未満となった施設数はそれぞれ、自施設測定（1 施設), 外部委託測定（1 施設)であった。点数が低かった施設は、他項目の結果も参考に管理方法を検討していただきたい。また、今回評価の高かった施設については、引き続き丁寧な検査値の管理をお願いしたい。

９）LDL コレステロール

LDL コレステロールは、特定健診・特定保健指導に重要な役割を担う項目であり、その精確さの管理は非常に重要である。本精度管理調査では、2008 年度の第 17 回の調査から評価に組み入れられている。

LDL コレステロール項目への全参加施設数は前回と比較して 2 施設増加し、337 施設であった。今回の精度管理調査施設内訳としては、自施設での測定が 129 施設（38.3%)、外部機関への委託測定が 208 施設（61.7%）であった。外部委託比率に著変はない。

採用試薬はそれぞれ、コレステスト LDL、クオリジェント LDL(積水メディカル)が 174 施設（51.6%, うち外部委託 120 施設)、メタボリード LDL-C, AU リエージェント LDL-C (ミナリスメディカル)が 157 施設（46.6%, うち外部委託 87 施設)、L タイプ LDL-C M (富士フィルム和光純薬)が 6 施設（1.8%, うち外部委託 1 施設)であった。前回まで 1 施設採用していた Friedewald の式（F 式）により算出した施設はなかった。なお、採用施設数が 10 施設以下の試薬については評価対象外とした。

LDL における、評価対象外を含む全施設の評価点を年度毎に比較したところ、91 点以上だった割合は今回、前回、前々回でそれぞれ、98.2%, 99.1%, 98.2%であった。特筆すべき変化はない。このまま収束した状態が維持されることが望ましい。LDL の成績分布は過去 2 年と比較して大きな変化は見られない。問題のなかった施設は現在の管理方法の継続を期待している。60 点未満の施設がわずかに存在した。該当施設においては管理方法を見直していただきたい。全体としては、良好に管理されていると考えられる。また、参加施設数が少ないため評価対象外となっている施設は全体の測定値から自己評価を行って頂きたい。

試薬間差を確認するため、5 施設以上で使用されている試薬について測定値の平均値を比較すると、ミナリスメディカル < 積水メディカル < 富士フィルム和光純薬の傾向を示した。この傾向は例年通りであり、変化はない。また、5 施設以上で使用されている試薬別の変動係数（CV%)は、メタボリード LDL-C, AU リエージェント LDL-C (ミナリスメディカル)が 0.9%～1.4%、コレステスト LDL、クオリジェント LDL (積水メディカル)が 1.1%～1.3%であり、ほぼ同等のバラツキであると考えられる。この結果から、非常に収束した結果が得られていると考えられる。

参加各施設で使用している検量用試料（キャリブレーター）をみると、全施設において血清・溶媒ベースキャリブレーターが使用されており、1 施設以外は試薬製造販売元指定のキャリブレーターであった。また、その他のキャリブレーターを指定した施設が施設あった。また、LDL コレステロールのトレーサビリティの確認において、ReCCS の標準品を利用する施設は、134 施設（39.8%)、企業の標準品を利用する施設は、197 施設（58.5%)、その他の標準品を利用する施設は、0 施設（0.0%)、であり、企業の標準品を利用するを利用する施設が最も多かった。実施なしの施設は、4 施設（1.2%)であった。トレーサビリテ

ィの確認を実施していない 6 施設の内訳は、自施設測定が 5 施設であり、外部委託測定が 1 施設であった。トレーサビリティの確認は、患者検体の測定値の根拠に戻って測定するための重要な方法である。外部精度管理で正確性の確認がしづらい本項目などは定期的・積極的に標準物質等による正確性の確認を強く推奨する。

測定試料における反応性を検証した。ミナリスメディカル（メタボリード LDL-C, AU リエージェント LDL-C）と積水メディカル（コレステスト LDL、クオリジェント LDL）の平均値を比較すると、凍結乾燥品それぞれの 2 社データ平均値に対する平均値差（絶対値）の比率（%)はそれぞれ、7.8%, 8.6%, 6.5%でった。一方で、生血清での比率はそれぞれ、4.3%, 4.2%であった。このことから、LDL の凍結乾燥試料におけるメーカー間差は今回も確認することができヒト血清以外の試料による正確性の確認が困難であることを示している。このため今回のサーベイの結果解析においても、変動の小さい測定試薬別評価を実施している。生血清でのメーカー間差は小さく、由来サンプルによる測定値の差を示している。しかし、生血清サンプルであってもサンプル中の成分（リポプロテイン（a）など）によりメーカー間差が生じることを過去のサーベイで確認している。生血清での乖離頻度は低いものの、検体の種類、病態によっては発生することがあるため、注意が必要である。なお、平成 20 年から開始された厚生労働省の特定健診・特定保健指導では、一律の基準で保健指導対象者の選定・階層化を行うため、試薬間差のない LDL コレステロール測定値を目指す必要があるが、現状では試薬間差の解消には至っていない。なお、評価対象試料で、試薬間差を確認するため、5 施設以上で使用されている試薬について測定値の平均値を比較すると、ミナリスメディカル < 積水メディカルの傾向を示した。5 施設以上で使用されている試薬別の変動係数（CV%)は、メタボリード LDL-C, AU リエージェント LDL-C（ミナリスメディカル)が 0.9%～1.4%、コレステスト LDL、クオリジェント LDL（積水メディカル)が 1.1%～1.3%であり、ほぼ同等のバラツキであると考えられる。

本項目の評価総評として LDL コレステロールの総合評価において、60 点未満となった施設数はそれぞれ、自施設測定（1 施設), 外部委託測定（2 施設)であった。点数が低かった施設は、他項目の結果も参考に管理方法を検討していただきたい。また、今回評価の高かった施設については、引き続き丁寧な検査値の管理をお願いしたい。

１０）HbA1c

HbA1c 測定の参加施設数は 336 施設（前年 334 施設）であり、内訳は自施設測定が 127 施設（前回 126 施設）、外部施設測定が 209 施設（前回 208 施設）となり前回とほぼ同様であった。全施設では酵素法が 44.9%（前回 44.9%）、免疫学的方法が 32.1%（前回 32.6%）、HPLC 法が 22.9%（前回 22.5%）であった。自施設、外部施設別にみると、自施設では HPLC 法が 52.8%（前回 51.6%）、酵素法が 33.9%（前回 34.9%）、免疫学的方法が 13.4%（前回 13.5%）であった。外部施設では酵素法が 51.7%（前回 51.0%）、免疫学的方法が 43.5%（前回 44.2%）、HPLC 法が 4.8%（前回 4.8%）であり、前回とほぼ同様であった。

1試料につき測定施設数が5施設以下の測定法（または測定試薬）については計算値の統計学的意義が乏しいことから「評価対象外」とした。「評価対象外」を除き、極端値（平均値±3SD）棄却後の測定方法別平均値を表Ⅲ-5に示した。

表Ⅲ-5 測定方法別平均値

方法	試薬メーカー	試料１	試料２	試料３	試料４	試料５
HPLC 法	アークレイ	5.48	6.36	7.29	6.54	5.25
	東ソー	5.60	6.48	7.46	6.46	5.09
免疫学的方法	ミナリスメディカル（汎用）	5.74	6.76	7.76	6.44	5.13
酵素法	ミナリスメディカル	5.58	6.41	7.40	6.31	5.15

試料1、2、3は凍結乾燥品であり、試料4、5は生血液試料である。測定法の違いによるHbA1c平均値の分布は、試料1で5.48～5.74%、試料2で6.36～6.76%、試料3は7.29～7.76%、試料4で6.31～6.54%、試料5で5.09～5.25%となり、最大値と最小値の差は試料1で0.26%（前回0.22%）、試料2で0.40%（前回0.43%）、試料3で0.47%（前回0.51%）、試料4で0.23%（前回0.09%）、試料5で0.16%（前回0.15%）であった。

各測定法の平均値評価規準は試料1が0.15～0.16%、試料2が0.17～0.18%、試料3が0.20～0.21%であり、同一測定法内におけるHbA1c値は収束していることは前回と同様であった。

標準液（キャリブレータ）及び検量方法の種類は、全て製造販売元指定の標準液の表示値をそのまま使用していた。

HbA1cの評価規準は、許容総誤差%の基本的な評価規準である“望ましい性能”を評価規準とし、各測定法の平均値±0～2.7%をA、±2.8～5.4%をB、±5.5～8.1%をC、±8.2%～をD評価とした。HbA1cは解析値評価を行わず、測定値評価のみで

総合評価点を計算した。全施設において総合評価点が100点の施設は95.7%（前回96.4%）であった。自施設測定で100点は95.2%であり、外部施設測定で100点は96.0%であった。総合評価点が低下した施設は、分析装置のメンテナンス、試薬・校正物質・精度管理物質等の内部精度管理状況を確認し、さらに信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。また、本年の総合評価点が60点未満の施設は1施設あり外部施設であった。

また前年、総合評価点が60点未満であった2施設については今年度は100点であり改善がみられた。今後も引き続き信頼性の高いデータが得られるよう努力していただきたい。

以上、全体的にみると本調査参加施設の HbA1c 測定の技術水準は高く、概ね良好であると考えられる。

【血液学検査】

血液学検査の精度管理調査は、本調査としてヘモグロビン濃度、赤血球数、白血球数、ヘマトクリット値、血小板数、また参考調査（仮評価）として平均赤血球容積、白血球分類について実施した。

参加施設数は 336 施設（前回 334 施設）であり、前回よりも 2 施設増加した。336 施設の内訳は自施設測定 127 施設(37.8%)で前回と同数。外部施設測定は 209 施設(62.3%)であり、それらの測定受託施設数は 60 施設であった。

１）血液学検査評価方法

血液学検査の評価方法は、平成 12 年度（第 9 回）調査から、SD 評価を測定値にもとづく％評価（渡辺清明 他，臨床病理 42:764～766,1994）に変更し、第 15 回からは個体の生理的変動を基本とした評価規準に変更した。この評価規準の概要および従来の評価規準との比較は第 16 回報告書の表 2-2、表 2-3 に示した。なお、今回送付した試料に関する具体的な平均値および平均値評価規準は本報告書Ⅱ.調査試料測定結果（1）の調査項目の測定方法別試料ごとの平均値および平均値評価規準一覧に示した。

２）測定試料

調査用測定試料として、精度管理用に調製された濃度の異なる 3 種類の加工血試料（以下「加工血液」）から 2 試料をランダムに組み合わせたもの、および健常成人ボランティア二人から採取した新鮮抗凝固血液（以下「新鮮血液」）2 試料の合計 4 試料を各施設に送付した。

全衛連臨床検査精度管理調査では平成 17 年度（第 14 回）までは血球計数全項目の調査試料に加工血液を使用していた。加工血液は、血球の固定剤、安定化剤などを種々濃度で含むため、新鮮血液に比べて保存安定性は優れているが、血球固定時の細胞変性や添加薬剤などの影響により、調査試料に起因する機種間差が生じることが知られている。そこで第 15 回調査からは新鮮血液を用いた参考調査を実施している。

調査に用いた新鮮血液は、輸血用保存液 CPD（citrate phosphate dextrose）入り採血バッグに静脈血を採取し、さらに EDTA-2K を終濃度 1.5mg/ml になるように添加して調製した。平成 30 年度（第 26 回）、令和元年度（第 27 回）の参考調査結果では、調査項目のうち、経日的に白血球数は減少傾向、ヘマトクリット値はわずかに上昇傾向、を示したものの、採血 3 日後までは全ての項目で報告値は平均値±3SD の範囲内に分布した。特に赤血球数、ヘモグロビン濃度は、加工血液報告値を用いた機種別評価結果と新鮮血液報告値を用いた全施設評価結果間、および加工血液と新鮮血液それぞれの全報告値における変動係数間に顕著な差はみられなかった。

これらのことから、臨床検査専門委員会で検討した結果、令和２年度（第 28 回）からヘマトクリット、白血球、血小板はこれまでと同様に加工血液試料による機種別評価を行

い、赤血球数、ヘモグロビン濃度については機種別評価を廃し、新鮮血液試料を用いた全施設評価を行うこととした。ただし、搬送時の異常（強溶血）など、何らかの異常による評価に関わる測定値への影響が示唆される場合は加工血液試料の測定値で評価することとしている。

以上により、今回も新鮮血液試料での評価が困難な場合は、加工血液試料での機種別評価結果を適用することとした。また、測定は、試料到着後速やかに測定を実施することとした。

各施設における新鮮血液試料測定時間は、試料作製後 24 時間以内 4.1%、24~36 時間 23.9%、36~48 時間 15.5%、48~60 時間 9.6%、60 時間以上 9.6%、未記入 0.6%であった。

今回の新鮮血試料（試料 18,19）について、それぞれ分注順に試料 30 本につき 1 本を抜きとり、本調査項目の精密度を検証したところ、各試料の変動係数は赤血球数 1.14%、1.00%、ヘモグロビン 1.14%、0.69%、ヘマトクリット 1.10%、1.04%、白血球数 1.37%、1.93%、血小板 1.93%、1.83%であった。

配布試料の溶血などへの対応については、試料到着後、全衛連に溶血に関する連絡があった施設には個別に対応した。加工血液試料（試料 16・17）では、2 施設から凍結などによる強度溶血を認めたとの連絡があり、当該施設には試料を再送した。試料 16・17 にフィブリン析出、血小板に関するメッセージを認めたなどのコメントを記入した施設はなかった。

新鮮血液試料（試料 18・19）に関しては、寒冷凝集（1 施設）、血小板凝集（2 施設）、フィブリン析出（1 施設）、白血球崩壊像（4 施設）があった。これらのうち、フィブリンの析出については、例年、数施設からコメント記載されていることがあるが、毎回、本調査項目（赤血球数、ヘモグロビン濃度）の測定結果に影響がないことを確認している。また、自動血球分析装置による測定時のメッセージが表示されたなどの記述はなかった。これらのことより、委員会で評価方法について検討した結果、例年通り、赤血球数、ヘモグロビン濃度ついては新鮮血液試料の報告値で評価した。

３）調査項目

(1) ヘモグロビン濃度

各施設からの自己申告結果から、ヘモグロビン濃度の測定方法は、①シアンメトヘモグロビン法 8 施設（前回 7 施設）、②非シアン界面活性剤法 301 施設（前回 321 施設）、③その他 25 施設（前回 6 施設)であった。なお、③その他 27 施設の測定装置のうち、JAB517（24 施設）は SLS-ヘモグロビン法、JAJ012（3 施設）はオキシヘモグロビン変法であった。SLS（sodium lauryl sulfate ; ラウリル硫酸ナトリウム）は陰イオン系界面活性剤の一つであるため、参加施設の 96.7%が②非シアン界面活性剤法を用いているといえる。

過去の調査結果から、ヘモグロビン濃度の平均値を測定法別に比較したところ、非シア

ン界面活性剤法とシアンメトヘモグロビン法との間に統計学的に有意な差は認められなかった。さらに、ヘモグロビン測定値の変動係数は、非シアン界面活性剤法、シアンメトヘモグロビン法ともに 1～2%と良好だったことから、臨床検査専門委員会で検討した結果、第 12 回からは測定法別ではなく全施設をまとめて評価することとした。

また、オキシヘモグロビン法の機種では、試料を長期保存した場合にヘモグロビンのメト化による負誤差が生じることが知られており、過去の調査結果において一部のオキシヘモグロビン法機種で経年的に負誤差傾向を認めたことから、臨床検査専門委員会で検討した結果､第 28 回からはヘモグロビンの調査試料として新鮮血液試料を用いることとした。

今回の評価点ランク別の構成比をみると､全施設（336 施設）において 80 点以上が 99.7%(前回：99.1%)、60 点以上が 100%（前回：99.7%）であった。また、60 点未満の低い評価を受けた施設は皆無（前回：0.3%）であった。

⑵赤血球数

今回の評価対象は 336 施設であった。評価点ランク別の構成比は、80 点以上が 90.2%(前回：100%)であった。60 点以 上が 96.4%（前回：100%）また、60 点未満の低い評価を受けた施設は 3.6%（前回：皆無）であった。

⑶白血球数

施設数 n＜5 の機種を除く今回の評価対象は 312 施設であった。評価点ランク別構成比は、80 点以上が 99.7%（前回：99.4%)であった。60 点未満の低い評価を受けた施設は 0.3%（前回：0.6%）であった。

⑷ヘマトクリット値

施設数 n＜5 の機種を除く今回の評価対象は 312 施設であった。評価点ランク別構成比は、80 点以上が 99.7%（前回：99.7%）であった。60 点未満の低い評価を受けた施設は 0.3%（前回：皆無）であった。

第 20 回から、ヘマトクリット値の評価基準は、以前に採用されていた臨床的許容限界に基づく評価規準との整合性、および自動血球分析装置の測定原理上、ヘマトクリット値は赤血球数の影響を受けることから、評価規準を「生理的変動（総誤差%）最適」から「生理的変動（総誤差%）望ましい」に変更した。

⑸血小板数

施設数 n＜5 の機種を除く今回の評価対象は 312 施設であった。評価点ランク別構成比は、80 点以上が 99.0%(前回：100%)、60 点以上が 99.4%（前回：100%）であった。60 点未満の低い評価を受けた施設は 0.6%（前回：皆無）であった。

(6) MCV（参考調査）

施設数 n＜5 の機種を除く今回の評価対象は 311 施設であった。評価点ランク別構成比は、80 点以上が 97.7%（前回：99.1%）、60 点以上が 99.0%（前回：99.7%）であった。60 点未満の低い評価を受けた施設は 1.0%（前回：0.3%）であった。

４）まとめ

本調査対象項目で 60 点未満の施設数は、ヘモグロビン濃度皆無、赤血球数 12 施設、白血球数 1 施設、ヘマトクリット 1 施設、血小板数 2 施設であった。赤血球数 60 点未満は、自施設測定で 1 施設、外部施設測定で 11 施設であった。これらのうち外部施設測定の受託機関は、2 施設であった（①JAB517；8 施設、②JAR408；2 施設）。①の外部受託機関利用 8 施設の結果は、試料 18（報告値 343~347×$10^4/\mu L$；平均値 372×$10^4/\mu L$）であり、評価点は 57.1 点であった。当該外部受託機関で測定をおこなったすべての施設（14 施設）の結果は、試料 18（報告値 343~349×$10^4/\mu L$；変動係数 0.49%）で平均と比べて低値傾向であった。②の外部受託機関利用 2 施設の結果は、試料 18（報告値 352×$10^4/\mu L$；報告値 354×$10^4/\mu L$）、試料 19（報告値 352×$10^4/\mu L$；報告値 349×$10^4/\mu L$；平均値 363×$10^4/\mu L$）で評価点はそれぞれ、57.1 点と 50 点であった。①の受託機関では、測定した試料 18 が低値傾向　②の受託機関では、試料 18、19 で低値傾向を示していることから、装置の校正にずれが生じていることが推測される。当該施設に置かれては、装置の再校正を検討いただきたい。

血小板数 60 点未満の 1 施設（自施設測定；JAB517）は試料 16（報告値 0.2×$10^4/\mu L$；平均値 13.4×$10^4/\mu L$）、試料 17（報告値 0.7×$10^4/\mu L$；平均値 32.5×$10^4/\mu L$）であり、評価点は 0 点であった。誤記入の可能性も否定はできないが、試料 18、19（評価対象外）の測定値がそれぞれ（報告値；35.5×$10^4/\mu L$、平均値 35.0×$10^4/\mu L$）、（報告値；18.5×$10^4/\mu L$、平均値 18.1×$10^4/\mu L$）と良好であったことから、試料 16、17 の報告値は、蛍光染色を用いた測定モードでの測定値である可能性が高いと推測される。蛍光染色を用いた血小板測定法は、新鮮血液試料の測定は可能だが、加工血液試料（固定血）は測定できない。また、装置では、電気抵抗法による血小板算定を同時に行っているので、報告前にデータを十分に確認したうえで報告いただきたい。

白血球数、ヘマトクリット値、血小板数の 3 項目で 60 点未満の 1 施設（外部施設）は、試料 16・17 の報告値の記載が反転していた。検体の測定時および結果の記入に際しては、検体番号や記入欄をよく確認し、記入後は複数スタッフによるチェックをしていただきたい。

なお、調査試料に溶血を認めた場合は、試料到着時にミクロヘマトクリット管を用いて遠心分離後、または十分に静置後、上清に強度の溶血がないかを確認するなどの対応が求められる。もしも強溶血を認めた場合は、コメント欄に記入するだけでなく、試料の再送が必要なこともあるため、全衛連に連絡していただきたい。なお、過去（第 28 回調査）に

加工血液試料の再送後においても凍結による強溶血を認めて不参加となった施設があったことから、臨床検査専門委員会で検討した結果、第 29 回からは溶血強度 4 の場合は連絡時に試料の状態の写真を提出していただくこととした。なお、写真は、試料の試験管を静置後、血球層が沈殿して上清の色別ができる状態で撮影し、もしも試験管静置後も肉眼では試料の上清と血球層の区別がつかないような場合は、その旨を写真送付時に付記していただきたい。

【尿検査】

第 32 回尿精度管理調査参加施設数は、338 施設であった。

表Ⅲ-6 は、調査開始以来の尿検査の外部委託状況をまとめたものである。

令和５年度・第 32 回の尿検査の実施状況を眺めると、338 施設中 65 施設（19.2%）は、外部委託をしている。しかも、その委託先の 65 検査所は、27（41.5%）の再委託先の検査所に検体を送り検査を実施している。尿検査は、いかに早く検査するかが最重要課題であるにもかかわらず外部委託しての検査は決して望ましい検査環境ではない。加えて「再委託されている検査」は、採尿から検査までさらに時間が経過していることが予想される。

日常の健診時の尿検査も、こうした方法で検査されているとしたら問題である。加えて「保冷搬送・保存」がどの程度厳守されているのか非常に気になることである。

尿検体は、「採尿後速やかに検査する」ことが原理・原則である。

表Ⅲ-6　尿検査の「外部委託検査」

回数	年　度	対象施設数	外部委託施設数(%)		受託検査機関数
1	平成４年	213	37	17.4	—
2	平成５年	218	48	22.0	—
3	平成６年	257	不明	—	—
4	平成７年	273	40	14.7	—
5	平成８年	283	20	7.1	16
6	平成９年	296	14	4.7	12
7	平成１０年	296	16	5.4	14
8	平成１１年	316	14	4.4	14
9	平成１２年	318	19	6.0	14
10	平成１３年	325	8	2.5	8
11	平成１４年	337	7	2.1	4
12	平成１５年	335	13	3.9	10
13	平成１６年	333	—	—	—
14	平成１７年	337	—	—	—
15	平成１８年	334	—	—	—
16	平成１９年	361	—	—	—
17	平成２０年	358	—	—	—
18	平成２１年	355	—	—	—
19	平成２２年	361	—	—	—
20	平成２３年	359	16	4.5	14
21	平成２４年	365	22	6.0	17
22	平成２５年	357	20	5.6	14
23	平成２６年	359	24	6.7	17
24	平成２７年	363	22	6.1	15
25	平成２８年	355	23	6.5	17
26	平成２９年	352	31	8.8	20
27	平成３０年	350	45	12.9	25
28	令和元年	348	49	14.1	26
29	令和２年	338	51	15.1	25
30	令和３年	335	58	17.3	27
31	令和４年	336	59	17.6	26
32	令和５年	338	65	19.2	27

注）　—は、調査項目が無かったため未確認

１）評価方法

尿検査の評価は、例年のごとく各試料の半定量値について下記のように評点している。

半定量値と一致したものを ［A］：５点

１ランク異なったものを　［B］：４点

２ランク以上離れたものを ［Z］：０点

各項目とも配布した 5 試料が全てA評価の場合、合計 25 点になる。得られた点数を機械的に４倍し 100 点満点に換算したものが評価点となる。

２）結果及び考察

（１）尿検査の方法

検査項目別・測定法別の結果を 表Ⅲ-7 に示す。

表Ⅲ-7　項目別・測定法別検査の方法

	尿　糖　検　査		尿　蛋　白　検　査		尿　潜　血　検　査	
試験紙・目視判定法	116	34.3%	116	34.3%	116	34.3%
〃　・機器判定法	222	65.7%	222	65.7%	222	65.7%
合 計	338	100.0%	338	100.0%	338	100.0%

尿糖・蛋白・潜血検査とも、全ての施設で試験紙法を採用している。巡回健診現場での検査の簡便さから 34.3%の施設では「目視判定法」で検査している。

「目視判定法」の場合、検査台上の照度が 800～1000LUX 程度確保されていなくてはならないが、「巡回健診会場」での照度確保には苦慮されていることも多いと思われる。

補助照明の使用も解決策の一つではあるが、簡易な標準試料を用いて、その健診現場で「検査者の目合わせ」を行なうことも有効な手段である。参考までに、その標準試料の作成法を下記に示す。

『健康診断機関の閑散期を利用して、スクリーニング基準になる（１＋）濃度の「同一人工標準試料」を作成する。これを５mL 程度ずつ分注した小試験管を多数作成し、Deep Freezing しておく。健診の都度、その一本を持参し、それぞれの健診会場で試験紙を浸漬し（１＋）の発色状況を視認してから検査する。様々な健診会場での異なる検査条件の中で「検査者の目合わせ」をすることである。

この方法を取り入れることにより、新入職員の教育的目合わせや、検査会場での異なる照度条件下でも安定した判定結果を出すことに有効であり、筆者の施設では 30 年以上前から実施している。』

（２）項目別・測定法別検査結果

表Ⅲ-8 は、検査項目別・測定法別検査結果である。

「90 点以上」の良好な施設は、尿糖検査では目視判定で 69.8%、機器判定では 85.1%、同様に尿蛋白検査では 91.4%：98.6%、尿潜血検査では 87.9%：97.3%であり、何れも機器判定の方が良好な結果を示した。

一方、「60 点未満」の低得点施設は、尿糖検査で１施設（目視判定：1、機器判定：0)、尿蛋白検査では２施設（目視判定：0、機器判定：2)、尿潜血検査では２施設（目視判定：2、機器判定：0）であった。

従来、機器判定法での判定結果は、目視法に比べて安定した結果を出しているが、今回は 60 点未満の施設が、機器判定で多い一面が見られた。

表Ⅲ-8　項目別・測定法別得検査結果（得点別施設数及びその比率）

項目	測　定　法	90点以上	80～89点	70～79点	60～69点	60点未満	合計
尿糖	試験紙・目視判定法	81	29	5	0	1	116
		69.8%	25.0%	4.3%	0.0%	0.9%	100.0%
	〃　・機器判定法	189	32	1	0	0	222
		85.1%	14.4%	0.5%	0.0%	0.0%	100.0%
	合　計	270	61	6	0	1	338
		79.9%	18.0%	1.8%	0.0%	0.3%	100.0%
尿蛋白	試験紙・目視判定法	106	9	1	0	0	116
		91.4%	7.8%	0.9%	0.0%	0.0%	100.0%
	〃　・機器判定法	219	1	0	0	2	222
		98.6%	0.5%	0.0%	0.0%	0.9%	100.0%
	合　計	325	10	1	0	2	338
		96.2%	3.0%	0.3%	0.0%	0.6%	100.0%
尿潜血	試験紙・目視判定法	102	8	3	1	2	116
		87.9%	6.9%	2.6%	0.9%	1.7%	100.0%
	〃　・機器判定法	216	3	0	3	0	222
		97.3%	1.4%	0.0%	1.4%	0.0%	100.0%
	合　計	318	11	3	4	2	338
		94.1%	3.3%	0.9%	1.2%	0.6%	100.0%

目視判定の場合、直射日光が当たる明るすぎる検査台では陽性率が著しく減少し、逆に暗すぎると陽性率が増加する。廊下やトイレの片隅などは 200～300 LUX 程度であり、通常の事務室でも 300～400 LUX 程度しか得られないことが多い。従って、巡回健診のように不特定な検査条件下で目視判定する場合は、補助照明の携行使用や、前項で述べたカットオッフ値の（１＋）程度の標準試料 を使用しての「目合わせ」の励行が強く望まれる。目視判定で常に良好な検査結果を得るためには、適正な検査条件の確保は必須である。

（３）メーカー別にみた尿半定量値

日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の「尿試験紙検討委員会」が中心となって、学会・関係団体・メーカーで試験紙の判定表示値の統一化を進めてきた合意点は、下記の通りである。

① 尿蛋白・尿ブドウ糖試験部分は半定量値（mg/dL）で表示する。
定性値（－，±，１＋…)を付記するか否かは各メーカーの判断に委ねる。ただし、付記する場合、蛋白は 30 mg/dL、ブドウ糖は 100 mg/dL を（１＋）とする。

② 尿潜血試験部分は原則として比色表に定性値（－，±，１＋…)のみを表示し、添付文書に定性値とヘモグロビン濃度（mg/dL)、または赤血球数（個/μL）の関係を記載する。

（１＋）に相当するヘモグロビン濃度は、0.06 mg/dL とし、赤血球数に換算すると約 20 個/μL となる。

これを受けて各メーカーの試験紙は、表Ⅲ-9 に示したように（１＋）レベルでの判定基準が全て揃った。健診の場合、多くは（１＋）以上を「要精検・要２次検査」と判定するので、試験紙の相違によるスクリーニング結果に判定誤差が生じることは無くなった。従って、評点結果が悪かったのは、「判定の不確かさ」、或いは「検体のとり違い」・「転記ミス」等に起因しているとみてよい。

今回、メーカー・試験紙名、表示値等の記載に従来の表と整合性が取れない部分も見受けられたので、2024.4 に再調査したので、ここにはその修正版を掲載した。

表Ⅲ-9　尿試験紙メーカー別定量値

	製造 販売元名(販売元)名	試験紙名	判定時間	±	1＋	2＋	3＋	4＋	5＋
尿糖	栄　研　化　学	ウロペーパーⅢ栄研	60秒	50	**100**	250	500	2000	—
	ロッシュ・D	Comburテスト	60秒	50	**100**	300	1000	—	—
	富士フィルム和光純薬	プレテスト	30秒	50	**100**	250	500	2000	—
	アークレイファクトリー	オーションステックス7 EA	60秒	50	**100**	200	500	1000	—
	テ　ル　モ	ウリエース	30秒	50	**100**	500	2000	—	—
	東洋濾紙（ミナリスメディカル）	ウロピース S	30秒	50	**100**	250	500	1000	—
	東洋濾紙（三和化学）	U-テストビジュアル	30秒	50	**100**	250	500	1000	—
	シーメンスヘルスケア・D	エームス尿検査試験紙	30秒	—	**100**	250	500	1000	2000
尿蛋白	栄　研　化　学	ウロペーパーⅢ栄研	直後	15	**30**	100	300	1000	—
	ロッシュ・D	Comburテスト	60秒	15	**30**	100	500	—	—
	富士フィルム和光純薬	プレテスト	30秒	10～20	**30**	100	300	1000	—
	アークレイファクトリー	オーションステックス	60秒	15	**30**	100	300	1000	—
	テ　ル　モ	ウリエース	10秒	15	**30**	100	250	1000	—
	東洋濾紙（ミナリスメディカル）	ウロピース S	30秒	15	**30**	100	300	1000	—
	東洋濾紙（三和化学）	U-テストビジュアル	30秒	15	**30**	100	300	1000	—
	シーメンスヘルスケア・D	エームス尿検査試験紙	60秒	15	**30**	100	300	1000	—
尿潜血	栄　研　化　学	ウロペーパーⅢ栄研	30秒	0.03	**0.06**	0.15	0.75	—	—
	ロッシュ・D	Comburテスト	60秒	0.03	**0.06**	0.15	0.70	—	—
	富士フィルム和光純薬	プレテスト	30～60秒	—	**0.06**	0.15	0.75	—	—
	アークレイファクトリー	オーションステックス	60秒	0.03	**0.06**	0.2	1.0	—	—
	テ　ル　モ	ウリエース	20秒	—	**0.06**	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙（ミナリスメディカル）	ウロピース S	30秒	0.03	**0.06**	0.15	0.75	—	—
	東洋濾紙（三和化学）	U-テストビジュアル	45秒	0.03	**0.06**	0.2	1.0	—	—
	シーメンスヘルスケア・D	エームス尿検査試験紙	60秒	0.015	**0.06**	0.135	0.405	—	—

注〕D はダイアグノスティックの略　　（2024.4 調査）

（４）項目別・試験紙メーカー別・測定法別評点結果

各項目について試験紙メーカー別・測定方法別にみた評点結果を、85 点以上、70～84 点、60～69 点、60 点未満の４群に分けて集計した結果が、表Ⅲ-10 である。

尿糖検査の「84 点未満」は、目視判定で 17 施設「栄研化学：９、シーメンス HCD：４、テルモ：１、東洋濾紙：２(60 点未満：１)」であり、機器判定では 16 施設「栄研化学：13、シーメンス HCD：２、アークレイ：１」であった。

尿蛋白検査の「84 点未満」は、目視判定では４施設「栄研化学：2、富士フィルム：1、東洋濾紙：1」であり、機器判定では２施設「栄研化学：1、アークレイ：1（何れも 60 点未満)」ゼロであった。

尿潜血検査の「84 点未満」は、目視法では 6 施設「富士フィルム和光：1，テルモ：1、東洋濾紙：4（60 点未満：2)」であり、機器判定では 3 施設「栄研化学：2、アークレイ：1」であった。

表Ⅲ-10　項目別・試験紙メーカー別・判定法別評価結果

	試験紙メーカー	試験紙・目視判定法					試験紙・機器判定法				
		実施数	85点以上	70～84点	60～69点	60点未満	実施数	85点以上	70～84点	60～69点	60点未満
尿糖	02 栄研化学	61	52	9	0	0	174	161	13	0	0
	22 ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンスＨＣＤ	16	12	4	0	0	18	16	2	0	0
	32 富士フイルム和光純薬	11	10	1	0	0	1	1	0	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	29	28	1	0	0
	60 テルモ	3	2	1	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ)	24	22	1	0	1	-	-	-	-	-
	合　計　(338施設)	116	99	16	0	1	222	206	16	0	0
			85.3%	13.8%	0.0%	0.9%		92.8%	7.2%	0.0%	0.0%
尿蛋白	02 栄研化学	61	59	2	0	0	174	173	0	0	1
	22 ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンスＨＣＤ	16	15	1	0	0	18	18	0	0	0
	32 富士フイルム和光純薬	11	11	0	0	0	1	1	0	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	29	28	0	0	1
	60 テルモ	3	3	0	0	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ)	24	23	1	0	0	-	-	-	-	-
	合　計　(338施設)	116	112	4	0	0	222	220	0	0	2
			96.6%	3.4%	0.0%	0.0%		99.1%	0%	0.0%	0.9%
尿潜血	02 栄研化学	61	61	0	0	0	174	172	0	2	0
	22 ﾛｼｭ･ﾀﾞｲｱｸﾞﾉｽﾃｨｯｸｽ	1	1	0	0	0	-	-	-	-	-
	29 シーメンスＨＣＤ	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0
	32 富士フイルム和光純薬	11	10	1	0	0	1	1	0	0	0
	38 アークレイ	-	-	-	-	-	29	28	0	1	0
	60 テルモ	3	2	0	1	0	-	-	-	-	-
	61 東洋濾紙(販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ)	22	18	2	0	2	-	-	-	-	-
	合　計　(338施設)	116	110	3	1	2	222	219	0	3	0
			94.8%	2.6%	0.9%	1.7%		98.6%	0.0%	1.4%	0.0%

（５）項目別・評価点ランク別に見た経年比（28 回～32 回）

表Ⅲ-11 は、第 28 回から 32 回までの項目別にみた５段階別の評点結果である。
今回(32 回)と前回までの 90 点以上の変化を眺めると、尿糖検査では全体に 80%前後でやや低い傾向がみられたが、尿蛋白検査と尿潜血検査では 95%前後の施設が高得点を維持していることが確認された。

表Ⅲ-11　尿検査の項目別・評価点別最近５年間の推移（全施設）

項　目	得点	90点以上		80～89点		70～79点		60～69点		60点未満		合　計	
	回数	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比	施設数	構成比
尿　糖	32回	270	79.9%	61	18.0%	6	1.8%	0	0.0%	1	0.3%	338	100.0%
	31回	268	79.8%	61	18.2%	4	1.2%	1	0.3%	2	0.6%	336	100.0%
	30回	280	83.1%	52	15.4%	2	0.6%	1	0.3%	2	0.6%	337	100.0%
	29回	266	78.7%	64	18.9%	2	0.6%	1	0.3%	5	1.5%	338	100.0%
	28回	285	81.9%	57	16.4%	3	0.9%	1	0.3%	2	0.6%	348	100.0%
尿蛋白	32回	325	96.2%	10	3.0%	1	0.3%	0	0.0%	2	0.6%	338	100.0%
	31回	327	97.3%	7	2.1%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%
	30回	330	97.9%	6	1.8%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	337	100.0%
	29回	325	96.2%	9	2.7%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	338	100.0%
	28回	332	95.4%	12	3.4%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	348	100.0%
尿潜血	32回	318	94.1%	11	3.3%	3	0.9%	4	1.2%	2	0.6%	338	100.0%
	31回	313	93.2%	20	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	336	100.0%
	30回	323	95.8%	10	3.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.6%	337	100.0%
	29回	326	96.7%	11	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	337	100.0%
	28回	322	92.5%	24	6.9%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	348	100.0%

（６）ゼロ評価のある健診施設

表Ⅲ-12 は、配布した 5 試料中にゼロ点評価［Z］が、１試料以上あった健診機関の一覧である。

尿糖検査で濃く網掛けした「12012 施設」の評価点は 36 点であり、「Z 評価」が 5 試料中 3 試料に見られた。また、尿潜血検査でも同様に網掛けした同施設は 56 点であり、「Z 評価」は、2 試料に見られた。

尿蛋白検査で中程度に濃い網掛けをした「09008 施設」は 40 点であり、「Z 評価」が 3 試料に見られ、尿潜血検査でも同様に「Z 評価」が 2 試料に見られた。

同じく尿蛋白検査で網掛けした「37004 施設」は 40 点であり、「Z 評価」が 5 試料中 3 試料に見られ、尿潜血検査でも 2 試料に「Z 評価」が認められた。

更に「12012 施設」は、前 31 回の調査時にも、尿糖検査・尿蛋白検査で評点こそ 72 点であったが、「Z 評価」が認められた経緯がある。さらにそれ以前にも当施設は、同様に低得点を取っていたことを考慮すると、何か本質的な欠陥があるのかもしれない。

表Ⅲ-12 ゼロ点評価のある施設一覧（尿糖・尿蛋白、尿潜血）

項目	施設ｺｰﾄﾞ	測 定 方 法	機器ｺｰﾄﾞ	試 験 紙 メーカー	評価点	評 価 内 容				
尿糖	**12012**	**試験紙法 目視判定**	**AAZ999**	**東洋濾紙（販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ）**	**36.0**	**A**	**Z**	**Z**	**Z**	**B**
	13080	試験紙法 目視判定	AAZ999	テルモ	72.0	A	Z	A	B	B
	16008	〃	AAZ999	シーメンスＨＣＤ	72.0	A	B	Z	B	A
	23009	〃	AAZ999	東洋濾紙(販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ)	72.0	A	B	Z	B	A
	28007	〃	AAZ999	栄研化学	72.0	A	Z	B	B	A
	37006	試験紙法 機器測定	LBJ806	シーメンスＨＣＤ	72.0	A	B	B	Z	A
	40029	試験紙法 目視判定	AAZ999	栄研化学	72.0	A	B	Z	B	A
尿蛋白	**09008**	**試験紙法 機器測定**	**LAU301**	〃	**40.0**	**A**	**Z**	**Z**	**A**	**Z**
	16008	試験紙法 目視判定	AAZ999	シーメンスＨＣＤ	76.0	A	Z	B	A	A
	37004	試験紙法 機器測定	LBA707	アークレイ	40.0	A	A	Z	Z	Z
尿潜血	**09008**	**試験紙法 機器測定**	**LAU301**	**栄研化学**	**60.0**	**A**	**Z**	**A**	**A**	**Z**
	12012	**試験紙法 目視判定**	**AAZ999**	**東洋濾紙（販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ）**	**56.0**	**A**	**B**	**A**	**Z**	**Z**
	13039	〃	AAZ999	〃	40.0	A	Z	A	Z	Z
	13080	〃	AAZ999	テルモ	60.0	A	A	Z	Z	A
	22004	〃	AAZ999	富士フイルム和光純薬	72.0	A	B	A	B	Z
	23009	〃	AAZ999	東洋濾紙(販社:ｼﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ)	72.0	A	A	Z	B	B
	27007	〃	AAZ999	〃	72.0	A	B	A	B	Z
	37004	**試験紙法 機器測定**	**LBA707**	**アークレイ**	**60.0**	**A**	**A**	**Z**	**Z**	**A**
	38009	試験紙法 機器測定	LBM201	栄研化学	68.0	Z	A	B	B	B

〔注〕D はダイアグノスティックの略

施設コード　12012、09008、37004 は、60 点以下が２校項目ある施設

４）まとめ

毎回述べていることであるが、尿検査は、他の臨床化学検査や血液検査・生理機能検査等と比較して、簡単に取り扱われる傾向は否定できず、初心者が取組む検査というイメージが強い。それにもかかわらず、外部委託検査をしている施設が多い事はコストを優先し、健診施設の採算性を考慮した結果ではなかろうかと思うのは飛躍しすぎだろうか。

しかし、尿検査といえども、そのスクリーニング検査結果を誤って false　negative（偽陰性）と判定されれば、「要再検査」「要２次健診」としてフォローアップされることは無く、その結果で糖尿病や腎疾患等の初期診断は「異常なし」としてなってしまう。こうした「偽陰性」のリスクは、決して許されることではない。

また、「尿検査用試験紙」の適正管理と適切な検査の実施は、最小限必要なことである。試験紙を尿中に浸漬後判定（dip and read）する基本から逸脱した検査であってはならない。受診者自身に放尿中の尿を試験紙にかけてもらいこれを検査判定する方法や、ガーゼや綿棒等に少量採取した尿を、試験紙に擦りつけるような検査をする方法も良くない。

また、項目ごとに異なる判定時間の厳守、照度等の検査環境確保等も大切である。特に、目視判定の場合は、検査台上の照度を 1,000 LUX 前後確保しなければ、「偽陰性」に誤判定することが考えられる。

試験紙を提供してくれている各社は、JCCLS の要請に応えてスクリーニングの判定基準になる「１＋」の基準をそろえてきた背景には使用する「試験紙」の種類によってフォローアップされる条件が異なることをなくすために努力を尽くしてくれたのである。その成果を遺憾なく発揮するためには、尿検査は、採尿後速やかに正しく検査する事こそ健診機関に課せられた対応である。

尿検体を検査室に持ち帰るときや、やむを得ず外部委託先に送付するときの温度管理は極めて重要である。尿は、時間経過とともに外気温等の影響を受けて細菌が繁殖し変性することを忘れてはならない。特に外気温の高い夏場の保冷搬送は、欠かせない。尿検査は、基本的な検査である。だからこそ大切にしたい検査でもある。

Ⅳ. 補助調査集計結果

調査の目的

健康診断施設及び登録衛生検査所の臨床検査精度管理状況を把握し、本調査参加施の精度に係る業務改善の参考に供することを目的とする。

調査実施時期

令和５年１０月～１１月

調査対象期間

臨床検査実施件数については令和４年度の実績、その他は調査日現在の状況。

調査対象施設

臨床検査精度管理調査に参加した健康診断施設及び衛生検査所を対象に調査した。

調査事項

健康診断施設等における臨床検査の実施状況および精度管理体制の現状調査。

調査票の回収率

調査対象は精度管理調査に参加した 338 施設。補助調査票を提出した施設数は 291 施設（回収率 86.1%）であった。

回答施設数の内訳を下記に示す。回答に際して、A または B 施設と指定した設問について AB 未回答施設でも、回答があった場合は記入された通りで集計を行った。

回答施設の内訳と施設数

A施設 249施設	健康診断施設または健康診断施設内に臨床検査室を併設している施設
B施設 24施設	登録衛生検査所
AB未回答 18施設	調査票のA又はBの（　）欄に○印が記入されてなかった

１．臨床検査実施件数及び実施状況

健康診断施設の臨床検査実施件数及び実施状況

令和５年度全衛連臨床検査精度管理調査に参加した機関の臨床検査実施件数を令和４年度実績で報告していただいた。表１はA：健康診断249施設の集計結果である。

表1　A：健康診断施設　臨床検査実施件数

区分	検査項目	検査実施件数		外部委託状況	
		自施設検査件数	外部委託検査件数	衛生検査所	ﾌﾞﾗﾝﾁﾗﾎﾞ
生化学検査	総コレステロール	3,467,999 件	6,578,206 件	140	22
	中性脂肪	6,374,784 件	11,855,362 件	141	21
	HDLコレステロール	6,408,040 件	11,907,344 件	141	22
	LDLコレステロール	6,363,371 件	11,867,322 件	141	22
	ＡＳＴ	6,480,463 件	11,977,198 件	141	22
	ＡＬＴ	6,496,634 件	11,978,932 件	141	22
	γ-ＧＴ	6,420,779 件	12,009,331 件	141	22
	尿酸	4,570,945 件	8,095,832 件	141	22
	クレアチニン	5,134,919 件	8,156,799 件	141	22
	血糖	5,885,802 件	11,548,251 件	140	22
	ＨｂＡ１ｃ	5,076,443 件	9,644,834 件	139	22
血液検査	赤血球数	6,229,580 件	11,842,809 件	141	21
	ヘモグロビン	6,232,109 件	11,851,212 件	141	21
	ヘマトクリット	5,639,994 件	9,966,538 件	140	21
	白血球数	5,052,100 件	9,007,165 件	140	21
	血小板数	3,513,596 件	5,588,182 件	140	21
	平均赤血球容積	3,481,063 件	4,534,792 件	133	21
	白血球百分率	710,693 件	526,344 件	138	19
尿検査	尿糖	17,311,278 件	4,546,013 件	58	13
	尿蛋白	17,332,401 件	4,541,899 件	58	13
	尿潜血	12,067,453 件	3,249,734 件	58	13

登録衛生検査所の臨床検査実施件数及び実施状況

表2はB：登録衛生検査所24施設の集計結果である。全衛連の精度管理調査参加施設以外からの検査受託件数が加算されている。

表2　B：登録衛生検査所　臨床検査実施件数

区分	検査項目	検査実施件数	
		自施設検査件数	外部委託検査件数
生化学検査	総コレステロール	24,656,438 件	3,069,008 件
	中性脂肪	43,180,267 件	5,788,737 件
	HDLコレステロール	39,912,187 件	5,463,078 件
	LDLコレステロール	38,535,151 件	5,583,072 件
	ＡＳＴ	47,189,649 件	6,135,747 件
	ＡＬＴ	47,311,663 件	6,156,647 件
	γ-ＧＴ	44,231,060 件	5,890,243 件
	尿酸	37,525,557 件	4,903,672 件
	クレアチニン	43,658,252 件	5,588,151 件
	血糖	37,365,636 件	5,129,178 件
	ＨｂＡ１ｃ	28,968,581 件	4,295,551 件
血液検査	赤血球数	45,278,188 件	5,858,061 件
	ヘモグロビン	45,293,936 件	5,861,263 件
	ヘマトクリット	43,411,775 件	5,452,527 件
	白血球数	42,581,067 件	5,465,922 件
	血小板数	39,455,357 件	4,607,298 件
	平均赤血球容積	35,784,277 件	10,293 件
	白血球百分率	12,589,334 件	956,263 件
尿検査	尿糖	11,399,983 件	1,617,089 件
	尿蛋白	11,446,735 件	1,670,151 件
	尿潜血	9,610,341 件	1,307,594 件

A/B施設分け不明の臨床検査実施件数及び実施状況

表3には、A：健康診断施設、B：登録衛生検査所の施設分けが未記入の18施設の集計結果を示した。

表3　A/B不明施設　臨床検査実施件数

区分	検査項目	検査実施件数		外部委託状況	
		自施設検査件数	外部委託検査件数	衛生検査所	ﾌﾞﾗﾝﾁﾗﾎﾞ
生化学検査	総コレステロール	112,006 件	497,757 件	9	1
	中性脂肪	181,063 件	874,395 件	9	1
	HDLコレステロール	161,378 件	873,183 件	9	1
	LDLコレステロール	143,135 件	872,764 件	9	1
	ＡＳＴ	181,619 件	880,432 件	9	1
	ＡＬＴ	175,514 件	881,193 件	9	1
	γ-ＧＴ	165,907 件	879,890 件	9	1
	尿酸	131,614 件	593,644 件	9	1
	クレアチニン	171,245 件	584,774 件	9	1
	血糖	124,030 件	818,899 件	9	1
	ＨｂＡ１ｃ	113,978 件	693,346 件	9	1
血液検査	赤血球数	153,459 件	872,348 件	9	1
	ヘモグロビン	153,454 件	872,105 件	9	1
	ヘマトクリット	143,033 件	674,155 件	9	1
	白血球数	118,213 件	641,727 件	9	1
	血小板数	121,785 件	299,852 件	9	1
	平均赤血球容積	92,393 件	400,667 件	9	1
	白血球百分率	50,104 件	34,372 件	10	1
尿検査	尿糖	781,514 件	346,140 件	2	0
	尿蛋白	784,795 件	349,038 件	2	0
	尿潜血	526,743 件	204,060 件	2	0

２．精度管理実施状況

調査票の３－１臨床検査精度管理体制

臨床検査における精度管理について調査した。「3-1臨床検査精度管理体制」では、管理組織に関する事項としてA:健康診断施設が医療法施行規則で求められている「精度の確保に係わる責任者」の選任の有無および職種・職位・職制について調査。B：登録衛生検査所に対しては臨床検査技師等に関する法律施行規則で求められている「精度管理責任者」の選任等について調査した。表4～表9に結果を示す。なお、表4から表24及び表31から表54に示すパーセンテージは、調査票を提出した291施設を分母とし、表25から表30では設問に該当する施設数を分母として算出した。

表4　A施設対象に精度の確保に係わる責任者選任の有無

対象	選任有	選任無	未記入
A施設	231	7	11
（249）	(92.8%)	(2.8%)	(4.4%)

表5　専任者の職種

対象	医師	臨床検査技師	その他	未記入
A施設	108	117	17	7
（249）	(43.4%)	(47.0%)	(6.8%)	(2.8%)

表6　専任者の職位・職制

対象	所長･局長クラス	部長･次長クラス	課長･補佐クラス	その他	未記入
A施設	97	34	68	40	10
（249）	(39.0%)	(3.7%)	(27.3%)	(6.1%)	(4.0%)

表7　B施設対象に精度管理責任者の選任の有無

対象	選任有	選任無	未記入
B施設 （24）	4	0	20
	(16.7%)	(0.0%)	(83.3%)

表8　専任者の職種

対象	医師	臨床検査技師	その他	未記入
B施設 （24）	1	4	0	19
	(4.2%)	(16.6%)	(0.0%)	(79.2%)

表9　専任者の職位・職制

対象	所長･局長クラス	部長･次長クラス	課長･補佐クラス	その他	未記入
B施設 （24）	1	1	3	0	19
	(4.2%)	(4.2%)	(12.5%)	(0.0%)	(79.2%)

調査票の３−２教育研修

「3-2 教育研修」では、検査業務の従事者のみならず検体の受領、搬送などに従事する者なども含め、国内の主要な5団体と自施設が主催する臨床検査の精度管理に係わる研修・講習会への過去３年間における職員の受講状況について調査した。実施状況について表10から表16に集計結果を示す。（複数回答あり）

表10　全国労働衛生団体連合会主催

対象	精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
A施設（249）	31	26	34	10	18
	(10.7%)	(8.9%)	(11.7%)	(3.4%)	(6.2%)
B施設（24）	0	0	0	0	0
	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明（18）	1	2	2	0	2
	(0.3%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.7%)

表11　日本医師会主催

対象	精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
A施設（249）	20	7	15	0	1
	(6.9%)	(2.4%)	(5.2%)	(0.0%)	(0.3%)
B施設（24）	13	5	5	0	0
	(4.5%)	(1.7%)	(1.7%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明（18）	1	0	0	0	0
	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表12　日本臨床衛生検査技師会主催

対象	精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
A施設（249）	31	27	39	2	1
	(10.7%)	(9.3%)	(13.4%)	(0.7%)	(0.3%)
B施設（24）	15	7	10	1	1
	(5.2%)	(2.4%)	(3.4%)	(0.3%)	(0.3%)
A/B不明（18）	4	3	3	0	0
	(1.4%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表13　日本衛生検査所協会主催

対象	精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
A施設（249）	21	14	18	5	4
	(7.2%)	(4.8%)	(6.2%)	(1.7%)	(1.4%)
B施設（24）	5	3	3	0	0
	(1.7%)	(1.0%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明（18）	14	9	13	5	4
	(4.8%)	(3.1%)	(4.5%)	(1.7%)	(1.4%)

表14　日本総合健診医学会主催

対象	精度管理 責任者	技術管理 責任者	測定･分析 担当者	検体搬送 担当者	渉外(営業) 担当者
A施設	42	28	24	3	6
(249)	(14.1%)	(9.6%)	(8.2%)	(1.0%)	(2.1%)
B施設	0	1	1	0	0
(24)	(0.0%)	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明	1	4	3	0	0
(18)	(0.3%)	(1.4%)	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表15　自施設内研修・講習会

対象	精度管理 責任者	技術管理 責任者	測定･分析 担当者	検体搬送 担当者	渉外(営業) 担当者
A施設	82	70	79	36	39
(249)	(28.2%)	(24.1%)	(27.1%)	(13.4%)	(13.4%)
B施設	21	21	22	18	17
(24)	(7.2%)	(7.2%)	(7.6%)	(6.2%)	(5.8%)
A/B不明	5	6	6	3	3
(18)	(1.7%)	(2.1%)	(2.1%)	(1.0%)	(1.0%)

表16　その他主催の研修会

対象	精度管理 責任者	技術管理 責任者	測定･ 分析担当者	検体搬送 担当者	渉外(営業) 担当者
A施設	38	27	43	5	7
(249)	(13.1%)	(9.3%)	(14.8%)	(1.7%)	(2.4%)
B施設	10	7	7	1	1
(24)	(3.4%)	(2.4%)	(2.4%)	(0.3%)	(0.3%)
A/B不明	2	0	0	0	0
(18)	(0.9%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)

調査票の３−３　内部精度管理に関する文書

「3-3 内部精度管理に関する文書」では、医療法施行規則および臨床検査技師等に関する法律施行規則において精度確保するために作成が義務化されている標準作業書及び日誌、台帳の作成状況を調査した集計結果を表17～表23に示す。

表17　検査機器保守管理標準作業

対象	作成	未作成
A施設	163	86
(249)	(56.0%)	(29.6%)
B施設	23	1
(24)	(7.9%)	(0.3%)
A/B不明	10	8
(18)	(3.4%)	(2.7%)

表18　測定標準作業書

対象	作成	未作成
A施設	182	67
(249)	(62.5%)	(23.0%)
B施設	24	0
(24)	(8.2%)	(0.0%)
A/B不明	13	5
(18)	(4.5%)	(1.7%)

表19　測定作業日誌

対象	作成	未作成
A施設	172	77
(249)	(59.1%)	(26.5%)
B施設	24	0
(24)	(8.2%)	(0.0%)
A/B不明	13	5
(18)	(4.5%)	(1.7%)

表20　検査機器保守管理作業書日

対象	作成	未作成
A施設	167	82
(249)	(57.4%)	(28.2%)
B施設	23	1
(24)	(7.9%)	(0.3%)
A/B不明	12	6
(18)	(4.1%)	(2.1%)

表21　統計学的精度管理台帳

対象	作成	未作成
A施設	140	109
(249)	(48.1%)	(37.5%)
B施設	24	0
(24)	(8.2%)	(0.0%)
A/B不明	9	9
(18)	(3.1%)	(3.1%)

表22　外部精度管理台帳

対象	作成	未作成
A施設	182	67
(249)	(62.5%)	(23.0%)
B施設	24	0
(24)	(8.2%)	(0.0%)
A/B不明	9	9
(18)	(3.1%)	(3.1%)

表23　試薬管理台帳

対象	作成	未作成
A施設	149	100
(249)	(51.2%)	(34.4%)
B施設	23	1
(24)	(7.9%)	(0.3%)
A/B不明	14	4
(18)	(4.8%)	(1.4%)

調査票の３−４　内部精度管理、コントロール（血清等）の使用

A：健康診断施設とB：登録衛生検査所及びA/B不明の施設に分けて、自施設で生化学検査、血液学検査、尿検査の実施状況を調査した。その集計結果を表24に示す。

表24　臨床検査を自施設で実施しているかについて

参加区分 / 項目	A施設 (249)		B施設 (24)		A/B未記入施設 (18)	
	実施	実施せず	実施	実施せず	実施	実施せず
生化学検査	91	158	21	3	6	12
	(36.5%)	(63.5%)	(87.5%)	(12.5%)	(33.3%)	(66.7%)
血液学検査	90	159	21	3	6	12
	(36.1%)	(63.9%)	(87.5%)	(12.5%)	(33.3%)	(66.7%)
尿検査	181	68	22	2	13	5
	(72.7%)	(27.3%)	(91.7%)	(8.3%)	(72.2%)	(27.8%)

表24で臨床検査を実施していると回答した施設に対してそれぞれ生化学検査、血液学検査、尿検査におけるコントロール（血清等）の投入頻度を調査した。その集計結果を表25から表27に示す。

表25　生化学検査コントロール試料投入頻度（実施118施設）

実施頻度		A（91）	B（21）	A/B未記入（6）
1回／月	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／週	回答	1	0	0
	該当施設%	(0.8%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／日	回答	18	0	0
	該当施設%	(15.3%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(6.2%)	(0.0%)	(0.0%)
2回以上／日	回答	54	9	3
	該当施設%	(45.8%)	(42.9%)	(50.0%)
	全施設%	(18.6%)	(3.1%)	(1.0%)
～100検体毎	回答	13	10	3
	該当施設%	(11.0%)	(47.7%)	(50.0%)
	全施設%	(4.5%)	(3.4%)	(1.0%)
～200検体毎	回答	6	2	0
	該当施設%	(5.1%)	(9.5%)	(0.0%)
	全施設%	(2.1%)	(0.7%)	(0.0%)
その他	回答	5	2	0
	該当施設%	(4.2%)	(9.5%)	(0.0%)
	全施設%	(1.7%)	(0.7%)	(0.0%)

＊調査票回収291施設と実施該当施設に対する割合（複数回答あり）

表26　血液検査コントロール試料実施頻度（実施117施設）

実施頻度		A（90）	B（21）	A/B（6）
1回／月	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／週	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／日	回答	51	4	3
	該当施設%	(43.6%)	(3.4%)	(2.6%)
	全施設%	(17.5%)	(1.4%)	(1.0%)
2回以上／日	回答	42	16	3
	該当施設%	(35.9%)	(13.7%)	(2.6%)
	全施設%	(14.4%)	(5.5%)	(1.0%)
～100検体毎	回答	1	1	0
	該当施設%	(0.9%)	(0.9%)	(0.0%)
	全施設%	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)
～200検体毎	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
その他	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表27　尿検査コントロール試料実施頻度（実施216施設）

実施頻度		A（181）	B（22）	A/B（13）
1回／月	回答	21	0	0
	該当施設%	(9.7%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(7.2%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／週	回答	12	0	0
	該当施設%	(5.6%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(4.1%)	(0.0%)	(0.0%)
1回／日	回答	94	7	6
	該当施設%	(43.5%)	(3.2%)	(2.8%)
	全施設%	(32.3%)	(2.4%)	(2.1%)
2回以上／日	回答	24	14	4
	該当施設%	(11.1%)	(6.5%)	(1.9%)
	全施設%	(8.2%)	(4.8%)	(1.4%)
～100検体毎	回答	1	1	0
	該当施設%	(0.5%)	(0.5%)	(0.0%)
	全施設%	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)
～200検体毎	回答	0	0	0
	該当施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
その他	回答	33	2	2
	該当施設%	(15.3%)	(0.9%)	(0.9%)
	全施設%	(11.3%)	(0.7%)	(0.7%)

表28～表30にコントロールの濃度数について調査した結果を示す。

表28　生化学検査コントロール試料濃度数（実施118施設）

実施頻度		A（91）	B（21）	A/B（6）
1 濃度	回答	3	0	0
	該当施設%	(2.5%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)
2 濃度	回答	73	18	5
	該当施設%	(61.9%)	(15.3%)	(4.2%)
	全施設%	(25.1%)	(6.2%)	(1.7%)
3 濃度以上	回答	11	3	0
	該当施設%	(9.3%)	(2.5%)	(0.0%)
	全施設%	(3.8%)	(1.0%)	(0.0%)

表29　血液学検査コントロール試料濃度数（実施117施設）

実施頻度		A（90）	B（21）	A/B（6）
1 濃度	回答	29	1	3
	該当施設%	(24.8%)	(0.9%)	(2.6%)
	全施設%	(10.0%)	(0.3%)	(1.0%)
2 濃度	回答	53	19	2
	該当施設%	(45.3%)	(16.2%)	(1.7%)
	全施設%	(18.2%)	(6.5%)	(0.9%)
3 濃度以上	回答	3	0	0
	該当施設%	(2.6%)	(0.0%)	(0.0%)
	全施設%	(1.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表30　尿検査コントロール試料濃度数（実施216施設）

実施頻度		A（181）	B（22）	A/B（13）
1 濃度	回答	26	0	2
	該当施設%	(12.0%)	(0.0%)	(0.9%)
	全施設%	(8.9%)	(0.0%)	(0.9%)
2 濃度	回答	116	21	6
	該当施設%	(53.7%)	(9.7%)	(2.8%)
	全施設%	(39.9%)	(7.2%)	(2.1%)
3 濃度以上	回答	11	0	1
	該当施設%	(5.1%)	(0.0%)	(0.5%)
	全施設%	(3.8%)	(0.0%)	(0.3%)

調査票の３−５　全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無

「3-5 全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無」では、今回全衛連の精度管理調査に参加した機関が、他の団体が主催する外部精度管理調査にどの程度参加しているかについて調査した結果を表31に示す。

表31　全衛連以外の外部精度管理調査参加または参加予定（複数回答あり）

施設 / 主催者名	A施設 249施設	B施設 24施設	A/B未記入施設 18施設
日本医師会	108	24	9
	(37.1%)	(8.2%)	(3.1%)
日本臨床衛生検査技師	87	24	8
	(29.9%)	(8.2%)	(2.7%)
日本衛生検査所協会	10	22	4
	(3.4%)	(7.6%)	(1.4%)
日本総合健診医学会	89	4	8
	(30.6%)	(1.4%)	(2.7%)
地方自治体	60	23	6
	(20.6%)	(7.9%)	(2.1%)
CAP	5	13	3
	(1.7%)	(4.5%)	(1.0%)
その他	63	14	2
	(21.6%)	(4.8%)	(0.9%)
未記入	68	0	3
	(23.4%)	(0.0%)	(1.0%)

「その他」の欄に記入があった主催者名では、人間ドック学会及び各試薬メーカー数社の名称の記入が見られた。

調査票の３−６　検査委託先の精度の監視

「3-6 検査委託先の精度の監視」では、生化学検査、血液検査、尿検査の検査委託を行っているかどうかについて。また、委託を行っている場合は委託先の精度の監視を行っているかどうかについて調査をした。その結果を表32に示す。　*監視実施数の割合(%)は委託施設数を分母とした。

表32　検査委託状況と精度の監視（回答実数）

対象	検査区分	委託	監視実施数
A施設	生化学検査	186	119
		(63.9%)	(64.0%)
	血液学検査	182	115
		(62.5%)	(63.2%)
	尿検査	89	43
		(30.6%)	(48.3%)
B施設	生化学検査	2	1
		(0.9%)	(50.0%)
	血液学検査	1	0
		(0.3%)	(0.0%)
	尿検査	1	0
		(0.3%)	(0.0%)
A/B 不明	生化学検査	14	9
		(4.8%)	(64.3%)
	血液学検査	14	9
		(4.8%)	(64.3%)
	尿検査	7	4
		(2.4%)	(57.1%)

調査票の３−７　精度の監視頻度

「3-7 精度の監視頻度」では、生化学検査、血液検査、尿検査ごとにどのような委託先の精度の監視を行っているかについて調査をした。その結果を表33に示す。同一検体ブラインド挿入または既知試料ブラインド挿入以外の監視方法を採用している場合は「その他」の欄に記入してもらった。その他で示された方法には、X-R管理の監視、現地調査、外部精度管理調査の評価結果確認などであった。　*割合(%)は、精度の監視を実施している施設を分母とした。

表33　精度の監視方法（回答実数）

対象	方法 / 検査区分	同一検体 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入	既知試料 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入	その他の方法
A施設	生化学検査 119施設	94	25	8
		(79.0%)	(21.0%)	(6.7%)
	血液学検査 115施設	90	20	13
		(78.3%)	(17.4%)	(11.3%)
	尿検査 43施設	25	8	6
		(58.1%)	(18.6%)	(14.0%)
B施設	生化学検査 1施設	0	0	1
		(0.0%)	(0.0%)	(100%)
	血液学検査 0施設	0	0	0
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
	尿検査 0施設	0	0	0
		(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B 不明	生化学検査 9施設	5	2	1
		(55.6%)	(22.2%)	(11.1%)
	血液学検査 9施設	5	2	1
		(55.6%)	(22.2%)	(11.1%)
	尿検査 4施設	1	0	1
		(25.0%)	(0.0%)	(25.0%)

精度監視の実施頻度についての回答結果を表34から表36に示す。

表34　A施設の精度監視頻度（回答実数）

検査区分	月1回	半年1回	年1回	その他
生化学検査 (119)	35	20	53	14
	(29.4%)	(16.8%)	(44.5%)	(11.8%)
血液学検査 (115)	34	21	50	12
	(29.6%)	(18.3%)	(43.5%)	(10.4%)
尿検査 (43)	13	10	18	2
	(30.2%)	(23.2%)	(41.9%)	(4.7%)

表35　B施設の精度監視頻度（回答実数）

検査区分	月1回	半年1回	年1回	その他
生化学検査	0	0	1	0
(1)	(0.0%)	(0.0%)	(100%)	(0.0%)
血液学検査	0	0	0	0
(0)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)
尿検査	0	0	0	0
(0)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.0%)

表36　A/B未記入施設の精度監視頻度（回答実数）

検査区分	月1回	半年1回	年1回	その他
生化学検査	2	2	4	1
(9)	(22.2%)	(22.2%)	(44.4%)	(11.1%)
血液学検査	2	2	4	1
(9)	(22.2%)	(22.2%)	(44.4%)	(11.1%)
尿検査	0	0	3	0
(4)	(0.0%)	(0.0%)	(75.0%)	(0.0%)

調査票の３−８　検査委託先との契約状況

検体検査を委託している施設を対象に「3-8 検査委託先との契約状況」として、外部委託先の検査所要日数、個人情報保護及び品質についての第三者認証/認定を把握しているか調査した。表37から表40に、それぞれの調査結果を示す。

表37　委託先との検査所要日数の取り決め（回答実数）

対象	３日以内	４〜７日	７〜１４日	その他	未記入
A施設	134	54	11	24	49
(249)	(46.0%)	(18.6%)	(3.8%)	(8.2%)	(16.8%)
B施設	3	2	0	0	19
(24)	(1.0%)	(0.7%)	(0.0%)	(0.0%)	(6.5%)
A/B不明	8	3	0	3	4
(18)	(2.7%)	(1.0%)	(0.0%)	(1.0%)	(1.4%)

表37の場合「その他」の欄に記入されたものを含めほとんどが1〜14日の期間内で検査結果が返却されている。

表38　委託先の個人情報保護（回答実数）

対象	Pﾏｰｸ	JIS Q 15001	ISO 27001	その他	未記入
A施設	175	2	81	12	52
(249)	(60.1%)	(0.7%)	(27.8%)	(4.1%)	(17.9%)
B施設	4	0	0	1	19
(24)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)	(0.3%)	(6.5%)
A/B不明	13	5	2	0	4
(18)	(4.5%)	(1.7%)	(0.7%)	(0.0%)	(1.4%)

表38の「その他」の欄には調査票に記載されなかったISO規格や医療サービスマークの回答があった。

表39　委託先の品質管理方法（回答実数）

対象	ISO 9001	ISO 15189	CAP	その他	未記入
A施設	79	159	96	25	57
(249)	(27.1%)	(54.6%)	(33.0%)	(8.6%)	(19.6%)
B施設	2	4	0	1	19
(24)	(0.7%)	(1.4%)	(0.0%)	(0.3%)	(6.5%)
A/B不明	6	9	5	2	5
(18)	(2.1%)	(3.1%)	(1.7%)	(0.7%)	(1.7%)

表39の「その他」の欄にも調査票に記載されなかったISO規格や医療サービスマークの回答があった。

表40　委託先の管理体制情報の入手方法　(回答実数)

対象	ホームページ等	パンフレット等	渉外（営業）から	その他	未記入
A施設	85	87	106	10	53
(249)	(29.2%)	(29.9%)	(36.4%)	(3.4%)	(18.2%)
B施設	3	2	2	1	19
(24)	(1.0%)	(0.7%)	(0.7%)	(0.3%)	(6.5%)
A/B不明	7	5	4	2	4
(18)	(2.4%)	(1.7%)	(1.4%)	(0.7%)	(1.4%)

表40から、検体検査受託機関は必要な情報をさまざまな形態で提供できる体制が整っていることがうかがえる。

調査票の３−９　検査委託先の精度管理の確認

調査票の「3-9 検査委託先の精度管理の確認」の質問事項に記載された帳票類の作成は、法律で義務づけられている。参加機関に確認を促す意味で調査した。表41から表43に集計結果を示す。

表41　測定標準作業書の有無の確認　(回答実数)

対象	確認している	確認していない	その他	未記入
A施設	158	34	48	52
(249)	(54.3%)	(11.7%)	(16.5%)	(17.9%)
B施設	4	0	5	19
(24)	(1.4%)	(0.0%)	(1.7%)	(6.5%)
A/B不明	12	2	1	4
(18)	(4.1%)	(0.7%)	(0.3%)	(1.4%)

表42　統計学的精度管理台帳の確認　(回答実数)

対象	確認している	確認していない	その他	未記入
A施設	162	29	49	52
(249)	(55.7%)	(10.0%)	(16.8%)	(17.9%)
B施設	4	0	5	19
(24)	(1.4%)	(0.0%)	(1.7%)	(6.5%)
A/B不明	12	2	1	4
(18)	(4.1%)	(0.7%)	(0.3%)	(1.4%)

表43　外部精度管理台帳の確認　(回答実数)

対象	確認している	確認していない	その他	未記入
A施設	168	23	50	52
(249)	(57.7%)	(7.9%)	(17.2%)	(17.9%)
B施設	4	0	5	19
(24)	(1.4%)	(0.0%)	(1.7%)	(6.5%)
A/B不明	11	3	1	4
(18)	(3.8%)	(1.0%)	(0.3%)	(1.4%)

３．検体搬送・保存時の温度管理

調査票の４－１　血液検体（生化学・血液検査）

検査結果の品質を担保するには、検査前のプロセスも重要である。巡回健診で複数の事業所を回る間の検体保存に関して調査を行った。表44から表47では「4-1 血液検体(生化学・血液検査)」の温度管理について調査した結果を示す。

表44　巡回健診時の温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	94	99	1
(249)	(32.3%)	(34.0%)	(0.3%)
B施設	1	0	0
(24)	(0.3%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明	2	8	0
(10)	(0.7%)	(2.7%)	(0.0%)

表45　施設内での保存時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	137	90	2
(249)	(47.1%)	(30.9%)	(0.7%)
B施設	4	0	0
(24)	(1.4%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明	7	7	0
(14)	(2.4%)	(2.4%)	(0.0%)

表46　登録衛生検査所までの搬送時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	90	36	1
(249)	(30.9%)	(12.4%)	(0.3%)
B施設	16	0	0
(24)	(5.5%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明	8	4	0
(14)	(2.7%)	(1.4%)	(0.0%)

表47　登録衛生検査所の保存時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	100	26	1
(249)	(34.4%)	(8.9%)	(0.3%)
B施設	19	0	0
(24)	(6.5%)	(0.0%)	(0.0%)
A/B不明	9	3	0
(12)	(3.1%)	(1.0%)	(0.0%)

調査票の４－２　尿検査

調査票の「4-2で、尿検査」についての調査を行った。表48で尿の採取方法についての集計結果と表49で尿検査の実施場所について調査した結果を示す。

全衛連では尿検査を自施設で行う事を推奨しているが、例年外部の検査機関に委託する施設が増えてきている。委託の際の検体保存から検体受け渡しまで検体の保存に対して施設の対応が重要である。

表48　尿検体の採尿方法　(回答実数)

対象	自宅	施設及び巡回健診現場	未記入
A施設	181	217	0
(249)	(62.2%)	(74.6%)	(0.0%)
B施設	2	8	16
(24)	(0.7%)	(2.7%)	(5.5%)
A/B不明	10	12	3
(18)	(3.4%)	(4.1%)	(1.0%)

表49　尿検査の実施場所　(回答実数)

対象	巡回健診現場	自施設検査室	外部委託先	未記入
A施設	170	168	71	1
(249)	(58.4%)	(57.7%)	(24.4%)	(0.3%)
B施設	2	12	0	11
(24)	(0.7%)	(4.1%)	(0.0%)	(3.8%)
A/B不明	8	11	4	3
(18)	(2.7%)	(3.8%)	(1.4%)	(1.0%)

調査票の４－３　尿検体

調査票の「4-3 尿検体」では健診時におけるそれぞれの状況での尿検体の温度管理について、調査した結果を表50から表54までに示す。

表50 巡回健診時の温度管理　（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	70	90	0
(160)	(24.1%)	(30.9%)	(0.0%)
B施設	1	1	0
(2)	(0.3%)	(0.3%)	(0.0%)
A/B不明	3	7	0
(10)	(1.0%)	(2.4%)	(0.0%)

表51　施設までの搬送時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	84	81	0
(165)	(28.9%)	(27.8%)	(0.0%)
B施設	3	1	0
(4)	(1.0%)	(0.3%)	(0.0%)
A/B不明	3	4	0
(12)	(1.0%)	(1.4%)	(0.0%)

表52　施設で翌日検査する場合の保存時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	50	26	1
(77)	(17.2%)	(8.9%)	(0.3%)
B施設	3	1	0
(4)	(1.0%)	(0.3%)	(0.0%)
A/B不明	3	4	0
(7)	(1.0%)	(1.4%)	(0.0%)

表53 登録衛生検査所までの搬送時温度管理（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	69	23	0
(92)	(23.7%)	(7.9%)	(0.0%)
B施設	16	1	0
(17)	(5.5%)	(03%)	(0.0%)
A/B不明	5	4	1
(10)	(1.7%)	(1.4%)	(0.3%)

表54 登録衛生検査所で翌日検査する場合の保存時温度管理
（該当施設の回答数）

対象	管理記録あり	管理記録なし	未記入
A施設	57	17	0
(74)	(19.6%)	(5.8%)	(0.0%)
B施設	16	1	0
(17)	(5.5%)	(0.3%)	(0.0%)
A/B不明	5	1	1
(7)	(1.7%)	(0.3%)	(0.3%)

Ⅴ．臨床検査の基準範囲に関する調査集計結果

基準範囲調査票集計結果について

初回調査を平成２３年（第 20 回）に実施し、以後継続して調査を実施してきた。今回令和５年度（第 32 回）に実施した基準範囲の調査集計結果を報告する。参加された 336 施設で 290 施設から調査票の提出をうけた。（回収率 86.6%。）

A 健康診断施設か B 登録衛生検査所かについて

A の健康診断施設として回答していただいた施設が 259 施設。B 登録衛生検査所として回答していただいた施設が 27 施設。施設の区分けに記入がなかった調査票が 4 件であった。

基準範囲の決め方について

自施設の基準範囲の決め方については、調査票に示した下記 8 項目から自施設に沿ったものを選択していただいた。

a　：使用試薬の添付説明書記載値
b　：自機関で算出
c　：日本人間ドック学会の基準範囲
d　：日本臨床検査医学会の学生用基準範囲
e　：日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の共用基準範囲
f　：日本検査血液学会の血球計数項目の基準範囲
g　：学術文献の値
h　：その他（単位表示など具体的に記述してください）

基準範囲の変更理由について

参加施設が令和４年度以降基準範囲について変更を行った場合、その変更理由について回答していただいた。

0　：変更なし
1　：検査方法の変更
2　：使用機器の変更
3　：試薬の変更
4　：基準値引用の変更
5　：その他（具体的に記述してください）

回収した 290 施設の集計結果について、「基準範囲の決め方」をそれぞれ表 1 に健康診断施設 259 施設について、表 2 には登録衛生検査所 27 施設について示した。

表 3 には全 290 施設の「基準範囲の変更理由」を。「基準範囲」については、全 290 施設の集計結果を表 4 以降コレステロールから表 29MCV（女性）まで示した。

表1　基準範囲の決め方　健康診断施設（回収259施設、複数回答含む）

変更理由	a 使用試薬の添付説明書記載値	b 自機関で算出	c 日本人間ドック学会の基準範囲	d 日本臨床検査医学会の学生用基準範囲	e 日本臨床検査標準協議会(JCCLS)の共用基準範囲	f 日本検査血液学会血球計数項目の基準範囲	g 学術・文献の値	h その他	Blank 未記入
調査項目	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）
総コレステロール	14 (5.4%)	44 (17%)	89 (34.4%)	1 (0.4%)	21 (8.1%)	0 (0%)	33 (12.7%)	54 (20.8%)	18 (6.9%)
中性脂肪	12 (4.6%)	32 (12.4%)	133 (51.4%)	1 (0.4%)	10 (3.9%)	0 (0%)	30 (11.6%)	39 (15.1%)	9 (3.5%)
HDLコレステロール	12 (4.6%)	39 (15.1%)	132 (51%)	1 (0.4%)	9 (3.5%)	0 (0%)	27 (10.4%)	38 (14.7%)	9 (3.5%)
LDLコレステロール	12 (4.6%)	34 (13.1%)	133 (51.4%)	1 (0.4%)	10 (3.9%)	0 (0%)	28 (10.8%)	40 (15.4%)	9 (3.5%)
AST	12 (4.6%)	40 (15.4%)	138 (53.3%)	1 (0.4%)	16 (6.2%)	0 (0%)	17 (6.6%)	33 (12.7%)	9 (3.5%)
ALT	12 (4.6%)	40 (15.4%)	138 (53.3%)	1 (0.4%)	16 (6.2%)	0 (0%)	17 (6.6%)	33 (12.7%)	9 (3.5%)
γ-GT	13 (5%)	38 (14.7%)	138 (53.3%)	1 (0.4%)	16 (6.2%)	0 (0%)	18 (6.9%)	33 (12.7%)	9 (3.5%)
尿酸	12 (4.6%)	34 (13.1%)	133 (51.4%)	1 (0.4%)	10 (3.9%)	0 (0%)	29 (11.2%)	40 (15.4%)	9 (3.5%)
クレアチニン	11 (4.2%)	41 (15.8%)	137 (52.9%)	1 (0.4%)	16 (6.2%)	0 (0%)	21 (8.1%)	30 (11.6%)	10 (3.9%)
血糖	13 (5%)	51 (19.7%)	119 (45.9%)	1 (0.4%)	10 (3.9%)	0 (0%)	30 (11.6%)	40 (15.4%)	9 (3.5%)
HbA1c	11 (4.2%)	38 (14.7%)	128 (49.4%)	1 (0.4%)	11 (4.2%)	0 (0%)	28 (10.8%)	38 (14.7%)	9 (3.5%)
赤血球数	11 (4.2%)	57 (22%)	89 (34.4%)	1 (0.4%)	26 (10%)	1 (0.4%)	32 (12.4%)	41 (15.8%)	10 (3.9%)
ヘモグロビン量	10 (3.9%)	44 (17%)	134 (51.7%)	1 (0.4%)	17 (6.6%)	0 (0%)	18 (6.9%)	30 (11.6%)	9 (3.5%)
ヘマトクリット値	11 (4.2%)	57 (22%)	87 (33.6%)	1 (0.4%)	26 (10%)	0 (0%)	31 (12%)	42 (16.2%)	12 (4.6%)
白血球数	9 (3.5%)	50 (19.3%)	128 (49.4%)	1 (0.4%)	17 (6.6%)	0 (0%)	22 (8.5%)	27 (10.4%)	10 (3.9%)
血小板数	10 (3.9%)	41 (15.8%)	134 (51.7%)	1 (0.4%)	17 (6.6%)	0 (0%)	24 (9.3%)	28 (10.8%)	10 (3.9%)
MCV	12 (4.6%)	66 (25.5%)	59 (22.8%)	1 (0.4%)	27 (10.4%)	1 (0.4%)	30 (11.6%)	39 (15.1%)	25 (9.7%)

表2　基準範囲の決め方　登録衛生検査所（回収27施設、複数回答含む）

変更理由	a 使用試薬の添付説明書記載値	b 自機関で算出	c 日本人間ドック学会の基準範囲	d 日本臨床検査医学会の学生用基準範囲	e 日本臨床検査標準協議会(JCCLS)の共用基準範囲	f 日本検査血液学会血球計数項目の基準範囲	g 学術・文献の値	h その他	Blank 未記入
調査項目	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）
総コレステロール	0 (0%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	15 (55.6%)	6 (22.2%)	1 (3.7%)
中性脂肪	0 (0%)	9 (33.3%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)
HDLコレステロール	0 (0%)	13 (48.1%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	10 (37%)	10 (37%)	1 (3.7%)
LDLコレステロール	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	14 (51.9%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)
AST	0 (0%)	19 (70.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)
ALT	0 (0%)	19 (70.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)
γ-GT	0 (0%)	18 (66.7%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	4 (14.8%)	1 (3.7%)	1 (3.7%)
尿酸	0 (0%)	16 (59.3%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	6 (22.2%)	10 (37%)	1 (3.7%)
クレアチニン	0 (0%)	14 (51.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	9 (33.3%)	0 (0%)	1 (3.7%)
血糖	0 (0%)	10 (37%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	11 (40.7%)	8 (29.6%)	1 (3.7%)
HbA1c	1 (3.7%)	2 (7.4%)	1 (3.7%)	0 (0%)	1 (3.7%)	0 (0%)	10 (37%)	11 (40.7%)	1 (3.7%)
赤血球数	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)
ヘモグロビン量	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)
ヘマトクリット値	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)
白血球数	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)
血小板数	0 (0%)	7 (25.9%)	1 (3.7%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	13 (48.1%)	3 (11.1%)	1 (3.7%)
MCV	0 (0%)	9 (33.3%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (7.4%)	0 (0%)	10 (37%)	4 (14.8%)	2 (7.4%)

表3　基準範囲の変更理由　（回収291施設、複数回答含む）

変更理由	0 変更なし	1 検査方法の変更	2 使用機器の変更	3 試薬の変更	4 基準値引用の変更	5 その他	Blank 未記入
調査項目	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）	施設数（%）
総コレステロール	268 (92.4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	9 (3.1%)	1 (0.3%)	12 (4.1%)
中性脂肪	270 (93.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (3.8%)	1 (0.3%)	8 (2.8%)
HDLコレステロール	269 (92.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (3.8%)	1 (0.3%)	8 (2.8%)
LDLコレステロール	270 (93.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	12 (4.1%)	0 (0%)	8 (2.8%)
AST	272 (93.8%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	9 (3.1%)	0 (0%)	8 (2.8%)
ALT	272 (93.8%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	9 (3.1%)	0 (0%)	8 (2.8%)
γ-GT	271 (93.4%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	10 (3.4%)	0 (0%)	8 (2.8%)
尿酸	270 (93.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (3.8%)	0 (0%)	9 (3.1%)
クレアチニン	269 (92.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (3.4%)	1 (0.3%)	10 (3.4%)
血糖	271 (93.4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (3.4%)	1 (0.3%)	8 (2.8%)
HbA1c	268 (92.4%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (0.3%)	12 (4.1%)	0 (0%)	9 (3.1%)
赤血球数	273 (94.1%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	7 (2.4%)	0 (0%)	10 (3.4%)
ヘモグロビン量	264 (91%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	17 (5.9%)	0 (0%)	9 (3.1%)
ヘマトクリット値	272 (93.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (2.8%)	0 (0%)	10 (3.4%)
白血球数	269 (92.8%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (3.4%)	1 (0.3%)	10 (3.4%)
血小板数	268 (92.4%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	10 (3.4%)	1 (0.3%)	11 (3.8%)
MCV	256 (88.3%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	11 (3.8%)	1 (0.3%)	22 (7.6%)

表４　　対象施設:　290

総コレステロール（無性差）　（mg/dL）対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	20（ 6.9% ）	130 ～ 199	1（ 0.3% ）
－ ～ 219	1（ 0.3% ）	130 ～ 219	42（ 14.5% ）
－ ～ 220	1（ 0.3% ）	130 ～ 220	8（ 2.8% ）
0 ～ 248	2（ 0.7% ）	140 ～ 190	1（ 0.3% ）
40 ～ 199	1（ 0.3% ）	140 ～ 199	97（ 33.4% ）
100 ～ 219	1（ 0.3% ）	140 ～ 219	21（ 7.2% ）
101 ～ 119	1（ 0.3% ）	140 ～ 220	1（ 0.3% ）
104 ～ 199	1（ 0.3% ）	142 ～ 199	1（ 0.3% ）
120 ～ 219	23（ 7.9% ）	142 ～ 219	4（ 1.4% ）
120 ～ 220	2（ 0.7% ）	142 ～ 248	19（ 6.6% ）
128 ～ 219	10（ 3.4% ）	145 ～ 219	1（ 0.3% ）
130 ～ 189	1（ 0.3% ）	150 ～ 219	30（ 10.3% ）

表５

中性脂肪 （無性差）　（mg/ dL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8（ 2.8% ）	35 ～ 149	16（ 5.5% ）
－ ～ 149	13（ 4.5% ）	35 ～ 150	1（ 0.3% ）
0 ～ 149	7（ 2.4% ）	36 ～ 149	1（ 0.3% ）
1 ～ 149	1（ 0.3% ）	40 ～ 149	14（ 4.8% ）
30 ～ 140	1（ 0.3% ）	40 ～ 150	3（ 1.0% ）
30 ～ 149	181（ 62.4% ）	40 ～ 234	8（ 2.8% ）
30 ～ 150	3（ 1.0% ）	45 ～ 149	2（ 0.7% ）
35 ～ 130	1（ 0.3% ）	50 ～ 149	30（ 10.3% ）

表６

尿酸(男性) (mg/dL) 対象289施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 (2.8%)	3.0 ～ 7.0	5 (1.7%)
－ ～ 6.9	3 (1.0%)	3.1 ～ 6.5	1 (0.3%)
－ ～ 7.0	14 (4.8%)	3.4 ～ 7.0	3 (1.0%)
0.0 ～ 6.9	1 (0.3%)	3.5 ～ 6.9	1 (0.3%)
0.0 ～ 7.0	8 (2.8%)	3.5 ～ 7.0	3 (1.0%)
1.5 ～ 7.0	1 (0.3%)	3.5 ～ 7.9	1 (0.3%)
2.0 ～ 6.9	2 (0.7%)	3.6 ～ 7.0	28 (9.7%)
2.0 ～ 7.0	9 (3.1%)	3.7 ～ 7.0	22 (7.6%)
2.1 ～ 6.9	3 (1.0%)	3.7 ～ 7.1	1 (0.3%)
2.1 ～ 7.0	133 (46.0%)	3.7 ～ 7.6	1 (0.3%)
2.5 ～ 6.9	1 (0.3%)	3.7 ～ 7.8	8 (2.8%)
2.5 ～ 7.0	13 (4.5%)	3.8 ～ 7.0	13 (4.5%)
2.5 ～ 7.5	1 (0.3%)	3.8 ～ 7.5	1 (0.3%)
2.9 ～ 6.5	1 (0.3%)	4.0 ～ 7.0	1 (0.3%)
3.0 ～ 6.9	2 (0.7%)		

表７

尿酸(女性) (mg/dL) 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	136 (46.9%)	2.3 ～ 7.0	11 (3.8%)
－ ～ 5.7	1 (0.3%)	2.4 ～ 5.8	1 (0.3%)
－ ～ 6.9	2 (0.7%)	2.4 ～ 6.0	1 (0.3%)
－ ～ 7.0	2 (0.7%)	2.4 ～ 7.0	5 (1.7%)
0 ～ 6.9	1 (0.3%)	2.5 ～ 5.4	1 (0.3%)
0 ～ 7.0	2 (0.7%)	2.5 ～ 7.0	28 (9.7%)
1.8 ～ 5.2	1 (0.3%)	2.5 ～ 7.1	1 (0.3%)
2.0 ～ 7.0	9 (3.1%)	2.6 ～ 5.5	9 (3.1%)
2.1 ～ 5.9	1 (0.3%)	2.6 ～ 6.0	3 (1.0%)
2.1 ～ 6.9	1 (0.3%)	2.6 ～ 7.0	8 (2.8%)
2.1 ～ 7.0	45 (15.5%)	2.7 ～ 7.0	16 (5.5%)
2.2 ～ 5.7	2 (0.7%)	2.8 ～ 7.0	1 (0.3%)
2.3 ～ 5.5	1 (0.3%)	3.0 ～ 5.5	1 (0.3%)

表８

クレアチニン(男性) (mg/dL) 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 (2.8%)	0.40 ～ 1.00	1 (0.3%)
－ ～ 0.70	2 (0.7%)	0.40 ～ 1.14	3 (1.0%)
－ ～ 1.00	93 (32.1%)	0.50 ～ 1.00	7 (2.4%)
－ ～ 1.04	3 (1.0%)	0.50 ～ 1.10	4 (1.4%)
－ ～ 1.07	1 (0.3%)	0.53 ～ 1.02	1 (0.3%)
－ ～ 1.09	8 (2.8%)	0.57 ～ 1.04	1 (0.3%)
－ ～ 1.10	4 (1.4%)	0.60 ～ 1.00	2 (0.7%)
－ ～ 1.19	4 (1.4%)	0.60 ～ 1.10	17 (5.9%)
0.00 ～ 1.00	37 (12.8%)	0.60 ～ 1.15	3 (1.0%)
0.00 ～ 1.04	1 (0.3%)	0.60 ～ 1.19	1 (0.3%)
0.00 ～ 1.09	5 (1.7%)	0.60 ～ 1.29	1 (0.3%)
0.00 ～ 1.19	1 (0.3%)	0.61 ～ 1.04	35 (12.1%)
0.01 ～ 1.10	1 (0.3%)	0.61 ～ 1.05	1 (0.3%)
0.04 ～ 1.00	1 (0.3%)	0.61 ～ 1.08	2 (0.7%)
0.10 ～ 1.00	1 (0.3%)	0.65 ～ 1.07	18 (6.2%)
0.10 ～ 1.10	1 (0.3%)	0.65 ～ 1.09	16 (5.5%)
0.20 ～ 0.50	1 (0.3%)	0.65 ～ 1.10	1 (0.3%)
0.35 ～ 1.14	2 (0.7%)	0.66 ～ 1.11	2 (0.7%)

表９

クレアチニン (女性) (mg/dL) 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	10 (3.4%)	0.35 ～ 0.84	2 (0.7%)
－ ～ 0.70	94 (32.4%)	0.40 ～ 0.70	11 (3.8%)
－ ～ 0.79	8 (2.8%)	0.40 ～ 0.79	1 (0.3%)
－ ～ 0.80	4 (1.4%)	0.40 ～ 0.80	10 (3.4%)
－ ～ 0.82	3 (1.0%)	0.40 ～ 0.90	5 (1.7%)
－ ～ 0.83	1 (0.3%)	0.43 ～ 0.72	1 (0.3%)
－ ～ 0.89	3 (1.0%)	0.45 ～ 0.80	3 (1.0%)
－ ～ 0.99	1 (0.3%)	0.45 ～ 0.82	1 (0.3%)
－ ～ 1.00	1 (0.3%)	0.45 ～ 0.85	3 (1.0%)
0.00 ～ 0.70	38 (13.1%)	0.46 ～ 0.79	18 (6.2%)
0.00 ～ 0.79	6 (2.1%)	0.46 ～ 0.80	2 (0.7%)
0.00 ～ 1.19	1 (0.3%)	0.46 ～ 0.82	16 (5.5%)
0.01 ～ 0.80	1 (0.3%)	0.47 ～ 0.79	35 (12.1%)
0.04 ～ 0.70	1 (0.3%)	0.47 ～ 0.80	1 (0.3%)
0.10 ～ 0.8	1 (0.3%)	0.50 ～ 0.80	1 (0.3%)
0.30 ～ 0.9	1 (0.3%)	0.50 ～ 0.86	2 (0.7%)
0.31 ～ 0.88	3 (1.0%)	0.50 ～ 1.09	1 (0.3%)

表１０

AST （無性差） （U/L） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	7 （ 2.4% ）	5 ～ 40	1 （ 0.3% ）
－ ～ 30	88 （ 30.3% ）	7 ～ 36	2 （ 0.7% ）
－ ～ 31	3 （ 1.0% ）	7 ～ 40	1 （ 0.3% ）
－ ～ 35	6 （ 2.1% ）	8 ～ 33	2 （ 0.7% ）
－ ～ 38	1 （ 0.3% ）	8 ～ 34	1 （ 0.3% ）
－ ～ 40	8 （ 2.8% ）	8 ～ 35	1 （ 0.3% ）
－ ～ 42	1 （ 0.3% ）	8 ～ 38	7 （ 2.4% ）
0 ～ 30	59 （ 20.3% ）	8 ～ 40	1 （ 0.3% ）
0 ～ 35	2 （ 0.7% ）	9 ～ 38	1 （ 0.3% ）
0 ～ 40	6 （ 2.1% ）	10 ～ 30	1 （ 0.3% ）
0 ～ 41	1 （ 0.3% ）	10 ～ 35	8 （ 2.8% ）
0 ～ 45	2 （ 0.7% ）	10 ～ 40	44 （ 15.2% ）
1 ～ 30	3 （ 1.0% ）	11 ～ 35	2 （ 0.7% ）
1 ～ 35	1 （ 0.3% ）	12 ～ 32	1 （ 0.3% ）
1 ～ 42	1 （ 0.3% ）	13 ～ 30	14 （ 4.8% ）
2 ～ 30	2 （ 0.7% ）	13 ～ 33	10 （ 3.4% ）
5 ～ 35	2 （ 0.7% ）		

表１１

ALT （無性差） （U/L） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 （ 2.8% ）	4 ～ 40	1 （ 0.3% ）
－ ～ 30	87 （ 30.0% ）	4 ～ 41	1 （ 0.3% ）
－ ～ 31	1 （ 0.3% ）	4 ～ 43	2 （ 0.7% ）
－ ～ 35	6 （ 2.1% ）	4 ～ 44	4 （ 1.4% ）
－ ～ 38	1 （ 0.3% ）	5 ～ 30	1 （ 0.3% ）
－ ～ 40	6 （ 2.1% ）	5 ～ 35	5 （ 1.7% ）
－ ～ 42	1 （ 0.3% ）	5 ～ 39	3 （ 1.0% ）
－ ～ 43	1 （ 0.3% ）	5 ～ 40	8 （ 2.8% ）
－ ～ 45	4 （ 1.4% ）	5 ～ 42	1 （ 0.3% ）
0 ～ 30	59 （ 20.3% ）	5 ～ 43	1 （ 0.3% ）
0 ～ 35	2 （ 0.7% ）	5 ～ 45	31 （ 10.7% ）
0 ～ 40	4 （ 1.4% ）	6 ～ 30	8 （ 2.8% ）
0 ～ 41	1 （ 0.3% ）	6 ～ 32	2 （ 0.7% ）
0 ～ 45	4 （ 1.4% ）	6 ～ 35	2 （ 0.7% ）
1 ～ 30	3 （ 1.0% ）	6 ～ 39	2 （ 0.7% ）
1 ～ 35	1 （ 0.3% ）	6 ～ 40	7 （ 2.4% ）
1 ～ 40	1 （ 0.3% ）	7 ～ 39	1 （ 0.3% ）
2 ～ 30	2 （ 0.7% ）	7 ～ 42	1 （ 0.3% ）
3 ～ 35	1 （ 0.3% ）	8 ～ 42	2 （ 0.7% ）
3 ～ 49	1 （ 0.3% ）	10 ～ 42	13 （ 4.5% ）

表１２

γ-GT（男性）（U/L） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	7 （ 2.4% ）	0 ～ 75	4 （ 1.4% ）
－ ～ 49	1 （ 0.3% ）	0 ～ 79	12 （ 4.1% ）
－ ～ 50	86 （ 29.7% ）	0 ～ 80	9 （ 3.1% ）
－ ～ 51	1 （ 0.3% ）	0 ～ 84	2 （ 0.7% ）
－ ～ 55	3 （ 1.0% ）	0 ～ 85	3 （ 1.0% ）
－ ～ 60	2 （ 0.7% ）	1 ～ 50	1 （ 0.3% ）
－ ～ 64	1 （ 0.3% ）	1 ～ 55	1 （ 0.3% ）
－ ～ 68	1 （ 0.3% ）	1 ～ 70	1 （ 0.3% ）
－ ～ 70	4 （ 1.4% ）	2 ～ 50	2 （ 0.7% ）
－ ～ 73	4 （ 1.4% ）	5 ～ 55	5 （ 1.7% ）
－ ～ 75	4 （ 1.4% ）	5 ～ 60	1 （ 0.3% ）
－ ～ 79	3 （ 1.0% ）	6 ～ 35	1 （ 0.3% ）
－ ～ 80	15 （ 5.2% ）	6 ～ 55	1 （ 0.3% ）
－ ～ 84	2 （ 0.7% ）	7 ～ 60	1 （ 0.3% ）
－ ～ 85	2 （ 0.7% ）	8 ～ 58	1 （ 0.3% ）
－ ～ 86	1 （ 0.3% ）	9 ～ 101	1 （ 0.3% ）
0 ～ 49	2 （ 0.7% ）	10 ～ 47	10 （ 3.4% ）
0 ～ 50	63 （ 21.7% ）	10 ～ 68	1 （ 0.3% ）
0 ～ 54	1 （ 0.3% ）	10 ～ 80	1 （ 0.3% ）
0 ～ 55	1 （ 0.3% ）	13 ～ 34	1 （ 0.3% ）
0 ～ 70	8 （ 2.8% ）	13 ～ 64	13 （ 4.5% ）
0 ～ 71	1 （ 0.3% ）	16 ～ 73	3 （ 1.0% ）
0 ～ 73	2 （ 0.7% ）		

表１３

γ-GT（女性）（U/L） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	136 （ 46.9% ）	0 ～ 48	14 （ 4.8% ）
－ ～ 30	11 （ 3.8% ）	0 ～ 50	28 （ 9.7% ）
－ ～ 32	1 （ 0.3% ）	0 ～ 55	1 （ 0.3% ）
－ ～ 33	2 （ 0.7% ）	0 ～ 65	1 （ 0.3% ）
－ ～ 40	2 （ 0.7% ）	0 ～ 73	1 （ 0.3% ）
－ ～ 45	5 （ 1.7% ）	1 ～ 50	1 （ 0.3% ）
－ ～ 48	10 （ 3.4% ）	1 ～ 55	1 （ 0.3% ）
－ ～ 49	2 （ 0.7% ）	4 ～ 40	1 （ 0.3% ）
－ ～ 50	27 （ 9.3% ）	5 ～ 40	6 （ 2.1% ）
－ ～ 55	1 （ 0.3% ）	7 ～ 38	1 （ 0.3% ）
0 ～ 30	11 （ 3.8% ）	8 ～ 65	1 （ 0.3% ）
0 ～ 31	1 （ 0.3% ）	9 ～ 32	14 （ 4.8% ）
0 ～ 35	2 （ 0.7% ）	10 ～ 40	1 （ 0.3% ）
0 ～ 40	1 （ 0.3% ）	10 ～ 47	2 （ 0.7% ）
0 ～ 45	4 （ 1.4% ）	16 ～ 73	1 （ 0.3% ）

表１４

血糖（無性差）（mg/dL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	7 （ 2.4% ）	65 ～ 99	10 （ 3.4% ）
－ ～ 99	37 （ 12.8% ）	67 ～ 99	3 （ 1.0% ）
－ ～ 109	7 （ 2.4% ）	69 ～ 109	1 （ 0.3% ）
0 ～ 99	18 （ 6.2% ）	70 ～ 90	1 （ 0.3% ）
0 ～ 109	1 （ 0.3% ）	70 ～ 99	51 （ 17.6% ）
40 ～ 99	2 （ 0.7% ）	70 ～ 100	1 （ 0.3% ）
41 ～ 99	1 （ 0.3% ）	70 ～ 109	54 （ 18.6% ）
50 ～ 99	6 （ 2.1% ）	70 ～ 110	8 （ 2.8% ）
50 ～ 109	1 （ 0.3% ）	71 ～ 99	2 （ 0.7% ）
51 ～ 99	7 （ 2.4% ）	73 ～ 99	1 （ 0.3% ）
51 ～ 109	3 （ 1.0% ）	73 ～ 99	13 （ 4.5% ）
55 ～ 109	2 （ 0.7% ）	75 ～ 99	1 （ 0.3% ）
60 ～ 99	35 （ 12.1% ）	75 ～ 109	1 （ 0.3% ）
60 ～ 100	1 （ 0.3% ）	77 ～ 110	1 （ 0.3% ）
60 ～ 109	10 （ 3.4% ）	78 ～ 99	2 （ 0.7% ）
60 ～ 110	2 （ 0.7% ）		

表１５

HDL （男性） （mg/dL） 対象286施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 （ 2.8% ）	40.0 ～ 96.0	5 （ 1.7% ）
－ ～ 40.0	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ 99.0	17 （ 5.9% ）
36.0 ～ 67.0	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ 100.0	3 （ 1.0% ）
38.0 ～ 90.0	9 （ 3.1% ）	40.0 ～ 119.0	28 （ 9.8% ）
38.0 ～ －	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ 119.9	3 （ 1.0% ）
40.0 ～ 70.0	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ 129.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 74.0	2 （ 0.7% ）	40.0 ～ 999.0	5 （ 1.7% ）
40.0 ～ 75.0	5 （ 1.7% ）	40.0 ～ －	127 （ 44.4% ）
40.0 ～ 77.0	1 （ 0.3% ）	41.0 ～ 67.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 79.0	5 （ 1.7% ）	41.0 ～ 80.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 80.0	16 （ 5.6% ）	41.0 ～ 85.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 85.0	12 （ 4.2% ）	41.0 ～ 96.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 86.0	13 （ 4.5% ）	41.0 ～ 99.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 89.0	3 （ 1.0% ）	41.0 ～ 102.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 90.0	13 （ 4.5% ）		

表１６

HDL （女性） （mg/dL） 対象287施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	150 （ 52.3% ）	40.0 ～ 119.0	9 （ 3.1% ）
40.0 ～ 71.0	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ 119.9	3 （ 1.0% ）
40.0 ～ 83.0	7 （ 2.4% ）	40.0 ～ 120.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 86.0	1 （ 0.3% ）	40.0 ～ －	37 （ 12.9% ）
40.0 ～ 89.0	4 （ 1.4% ）	41.0 ～ 90.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 90.0	17 （ 5.9% ）	41.0 ～ 100.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 95.0	11 （ 3.8% ）	45.0 ～ 75.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 96.0	14 （ 4.9% ）	45.0 ～ 99.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 98.0	1 （ 0.3% ）	48.0 ～ 103.0	9 （ 3.1% ）
40.0 ～ 99.0	3 （ 1.0% ）	48.0 ～ －	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 100.0	5 （ 1.7% ）	49.0 ～ 74.0	1 （ 0.3% ）
40.0 ～ 103.0	5 （ 1.7% ）	50.0 ～ 99.0	2 （ 0.7% ）
40.0 ～ 110.0	1 （ 0.3% ）		

表１７

LDL コレステロール （男性）（mg/dL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 （ 2.8% ）	60 ～ 129	1 （ 0.3% ）
－ ～ 119	7 （ 2.4% ）	60 ～ 139	9 （ 3.1% ）
－ ～ 139	6 （ 2.1% ）	60 ～ 140	1 （ 0.3% ）
－ ～ 159	1 （ 0.3% ）	60 ～ 199	1 （ 0.3% ）
0 ～ 119	4 （ 1.4% ）	65 ～ 139	18 （ 6.2% ）
0 ～ 139	2 （ 0.7% ）	65 163	9 （ 3.1% ）
1 ～ 119	1 （ 0.3% ）	70 ～ 119	7 （ 2.4% ）
50 ～ 120	1 （ 0.3% ）	70 ～ 129	2 （ 0.7% ）
50 ～ 139	2 （ 0.7% ）	70 ～ 139	60 （ 20.7% ）
58 ～ 139	2 （ 0.7% ）	70 ～ 139.9	1 （ 0.3% ）
60 ～ 119	145 （ 50.0% ）	70 ～ 140	1 （ 0.3% ）
60 ～ 120	1 （ 0.3% ）		

表１８

LDL コレステロール （女性）（mg/dL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	201 （ 69.3% ）	60 ～ 119	48 （ 16.6% ）
－ ～ 119	2 （ 0.7% ）	60 ～ 139	4 （ 1.4% ）
－ ～ 139	1 （ 0.3% ）	65 ～ 139	4 （ 1.4% ）
－ ～ 159	1 （ 0.3% ）	65 ～ 163	5 （ 1.7% ）
0 ～ 119	1 （ 0.3% ）	70 ～ 119	4 （ 1.4% ）
1 ～ 119	1 （ 0.3% ）	70 ～ 139	16 （ 5.5% ）
50 ～ 139	1 （ 0.3% ）	70 ～ 140	1 （ 0.3% ）

表１９

HbA1c（無性差）（%） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	7 （ 2.4% ）	4.3 ～ 5.8	1 （ 0.3% ）
－ ～ 5.1	1 （ 0.3% ）	4.3 ～ 5.9	2 （ 0.7% ）
－ ～ 5.5	89 （ 30.7% ）	4.4 ～ 5.5	1 （ 0.3% ）
－ ～ 5.6	3 （ 1.0% ）	4.6 ～ 5.4	1 （ 0.3% ）
－ ～ 5.9	4 （ 1.4% ）	4.6 ～ 5.5	42 （ 14.5% ）
－ ～ 6.2	2 （ 0.7% ）	4.6 ～ 5.6	1 （ 0.3% ）
－ ～ 6.3	1 （ 0.3% ）	4.6 ～ 5.8	1 （ 0.3% ）
0.0 ～ 5.5	35 （ 12.1% ）	4.6 ～ 5.9	3 （ 1.0% ）
0.0 ～ 5.9	2 （ 0.7% ）	4.6 ～ 6.2	66 （ 22.8% ）
0.0 ～ 6.2	2 （ 0.7% ）	4.7 ～ 5.5	2 （ 0.7% ）
0.1 ～ 5.5	1 （ 0.3% ）	4.9 ～ 5.5	2 （ 0.7% ）
4.3 ～ 5.5	8 （ 2.8% ）	4.9 ～ 6	12 （ 4.1% ）
4.3 ～ 5.6	1 （ 0.3% ）		

表２０

赤血球数 （男性）（10^4/μL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	12 （ 4.1% ）	420 ～ 550	1 （ 0.3% ）
360 ～ 489	1 （ 0.3% ）	420 ～ 555	1 （ 0.3% ）
360 ～ 550	1 （ 0.3% ）	420 ～ 559	1 （ 0.3% ）
400 ～ 539	111 （ 38.3% ）	420 ～ 560	1 （ 0.3% ）
400 ～ 540	1 （ 0.3% ）	420 ～ 570	18 （ 6.2% ）
400 ～ 550	9 （ 3.1% ）	420 ～ 580	1 （ 0.3% ）
400 ～ 560	2 （ 0.7% ）	420 ～ 600	1 （ 0.3% ）
400 ～ 570	4 （ 1.4% ）	425 ～ 577	1 （ 0.3% ）
400 ～ 599	1 （ 0.3% ）	426 ～ 570	1 （ 0.3% ）
405 ～ 543	1 （ 0.3% ）	427 ～ 570	28 （ 9.7% ）
410 ～ 530	2 （ 0.7% ）	427 ～ 571	1 （ 0.3% ）
410 ～ 540	3 （ 1.0% ）	427 ～ 606	1 （ 0.3% ）
410 ～ 550	2 （ 0.7% ）	430 ～ 530	2 （ 0.7% ）
410 ～ 556	1 （ 0.3% ）	430 ～ 560	1 （ 0.3% ）
410 ～ 560	2 （ 0.7% ）	430 ～ 570	19 （ 6.6% ）
410 ～ 570	1 （ 0.3% ）	435 ～ 555	28 （ 9.7% ）
410 ～ 580	1 （ 0.3% ）	438 ～ 577	22 （ 7.6% ）
415 ～ 550	1 （ 0.3% ）	440 ～ 560	4 （ 1.4% ）
418 ～ 555	1 （ 0.3% ）	440 ～ 590	1 （ 0.3% ）

表２１

赤血球数 （女性）（10^4/μL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	12 （ 4.1% ）	376 ～ 516	23 （ 7.9% ）
330 ～ 500	1 （ 0.3% ）	376 ～ 533	1 （ 0.3% ）
345 ～ 535	1 （ 0.3% ）	379 ～ 488	1 （ 0.3% ）
350 ～ 500	2 （ 0.7% ）	380 ～ 480	8 （ 2.8% ）
360 ～ 480	1 （ 0.3% ）	380 ～ 490	2 （ 0.7% ）
360 ～ 489	112 （ 38.6% ）	380 ～ 492	1 （ 0.3% ）
360 ～ 490	1 （ 0.3% ）	380 ～ 500	28 （ 9.7% ）
360 ～ 500	1 （ 0.3% ）	380 ～ 510	3 （ 1.0% ）
360 ～ 549	1 （ 0.3% ）	380 ～ 519	1 （ 0.3% ）
368 ～ 490	1 （ 0.3% ）	380 ～ 520	2 （ 0.7% ）
370 ～ 500	12 （ 4.1% ）	386 ～ 492	28 （ 9.7% ）
370 ～ 510	3 （ 1.0% ）	390 ～ 490	1 （ 0.3% ）
370 ～ 540	1 （ 0.3% ）	390 ～ 500	1 （ 0.3% ）
373 ～ 490	1 （ 0.3% ）	390 ～ 540	1 （ 0.3% ）
376 ～ 500	37 （ 12.8% ）	420 ～ 510	1 （ 0.3% ）
376 ～ 501	1 （ 0.3% ）		

表２２

ヘモグロビン（男性）　(g/dL)　対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 (2.8%)	13.2 ～ 17.6	6 (2.1%)
12.0 ～ 17.0	1 (0.3%)	13.5 ～ 17.0	2 (0.7%)
12.1 ～ 14.5	1 (0.3%)	13.5 ～ 17.5	13 (4.5%)
13.0 ～ 16.6	6 (2.1%)	13.5 ～ 17.6	24 (8.3%)
13.0 ～ 17.0	13 (4.5%)	13.5 ～ 17.7	2 (0.7%)
13.0 ～ 17.5	4 (1.4%)	13.5 ～ 18.0	2 (0.7%)
13.0 ～ 18.0	1 (0.3%)	13.5 ～ 18.7	1 (0.3%)
13.1 ～ 16.3	126 (43.4%)	13.5 ～ 18.9	1 (0.3%)
13.1 ～ 16.6	16 (5.5%)	13.5 ～ －	1 (0.3%)
13.1 ～ 16.8	2 (0.7%)	13.6 ～ 17.0	1 (0.3%)
13.1 ～ 16.9	1 (0.3%)	13.6 ～ 18.0	1 (0.3%)
13.1 ～ 17.6	2 (0.7%)	13.6 ～ 18.3	18 (6.2%)
13.1 ～ 17.9	4 (1.4%)	13.7 ～ 16.8	18 (6.2%)
13.1 ～ 18.0	4 (1.4%)	13.8 ～ 17.2	1 (0.3%)
13.1 ～ 18.3	1 (0.3%)	14.0 ～ 18.0	9 (3.1%)

表２３

ヘモグロビン（女性）　(g/dL)　対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	8 (2.8%)	11.6 ～ 15.6	1 (0.3%)
10.9 ～ 15.2	1 (0.3%)	11.6 ～ 16.0	1 (0.3%)
11.0 ～ 15.0	8 (2.8%)	12.0 ～ 15.0	6 (2.1%)
11.0 ～ 16.0	4 (1.4%)	12.0 ～ 15.2	1 (0.3%)
11.2 ～ 15.2	19 (6.6%)	12.0 ～ 15.5	1 (0.3%)
11.3 ～ 15.2	29 (10.0%)	12.0 ～ 15.9	1 (0.3%)
11.3 ～ 15.3	1 (0.3%)	12.0 ～ 16.0	10 (3.4%)
11.3 ～ 16.3	1 (0.3%)	12.1 ～ 14.5	126 (43.4%)
11.4 ～ 14.6	5 (1.7%)	12.1 ～ 14.6	15 (5.2%)
11.5 ～ 14.5	1 (0.3%)	12.1 ～ 14.8	1 (0.3%)
11.5 ～ 15.0	12 (4.1%)	12.1 ～ 14.9	3 (1.0%)
11.5 ～ 15.5	3 (1.0%)	12.1 ～ 15.2	2 (0.7%)
11.5 ～ 16.0	1 (0.3%)	12.1 ～ 15.9	4 (1.4%)
11.5 ～ 16.9	1 (0.3%)	12.1 ～ 16.0	2 (0.7%)
11.5 ～ －	1 (0.3%)	12.1 ～ 16.3	1 (0.3%)
11.6 ～ 14.6	1 (0.3%)	12.1 ～ 17.0	1 (0.3%)
11.6 ～ 14.8	18 (6.2%)		

表２４

ヘマトクリット（男性）（%） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	14 (4.8%)	39.0 ～ －	1 (0.3%)
35.5 ～ 43.9	1 (0.3%)	39.2 ～ 51.8	6 (2.1%)
36.0 ～ 53.0	1 (0.3%)	39.5 ～ 51.9	5 (1.7%)
37.0 ～ 52.0	3 (1.0%)	39.7 ～ 52.4	12 (4.1%)
37.0 ～ 52.9	1 (0.3%)	39.8 ～ 51.8	28 (9.7%)
38.0 ～ 48.9	14 (4.8%)	39.8 ～ 51.9	3 (1.0%)
38.0 ～ 50.0	1 (0.3%)	39.8 ～ 57.8	1 (0.3%)
38.0 ～ 51.9	1 (0.3%)	40.0 ～ 48.0	2 (0.7%)
38.0 ～ 52.0	6 (2.1%)	40.0 ～ 50.9	1 (0.3%)
38.1 ～ 55.0	1 (0.3%)	40.0 ～ 52.0	11 (3.8%)
38.2 ～ 49.2	1 (0.3%)	40.0 ～ 54.0	3 (1.0%)
38.5 ～ 48.5	1 (0.3%)	40.0 ～ 53.0	1 (0.3%)
38.5 ～ 48.9	91 (31.4%)	40.0 ～ 55.0	1 (0.3%)
38.5 ～ 50.9	1 (0.3%)	40.4 ～ 51.1	1 (0.3%)
38.5 ～ 51.8	1 (0.3%)	40.4 ～ 51.9	23 (7.9%)
38.7 ～ 49.0	1 (0.3%)	40.5 ～ 50.0	1 (0.3%)
39.0 ～ 48.9	1 (0.3%)	40.7 ～ 50.1	28 (9.7%)
39.0 ～ 50.0	2 (0.7%)	41.0 ～ 52.0	1 (0.3%)
39.0 ～ 50.1	1 (0.3%)	42.0 ～ 53.0	2 (0.7%)
39.0 ～ 51.0	4 (1.4%)	43.0 ～ 52.0	1 (0.3%)
39.0 ～ 52.0	11 (3.8%)		

表２５

ヘマトクリット（女性）（%） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	14 (4.8%)	34.3 ～ 45.2	24 (8.3%)
31.0 ～ 45.0	1 (0.3%)	34.8 ～ 45.0	12 (4.1%)
32.0 ～ －	1 (0.3%)	35.0 ～ 44.5	1 (0.3%)
32.1 ～ 43.6	1 (0.3%)	35.0 ～ 45.0	4 (1.4%)
33.0 ～ 45.0	12 (4.1%)	35.0 ～ 45.9	1 (0.3%)
33.1 ～ 50.0	1 (0.3%)	35.0 ～ 46.0	1 (0.3%)
33.2 ～ 46.7	1 (0.3%)	35.0 ～ 46.5	1 (0.3%)
33.4 ～ 44.9	34 (11.7%)	35.0 ～ 47.0	2 (0.7%)
33.4 ～ 45.0	1 (0.3%)	35.0 ～ 48.0	9 (3.1%)
33.4 ～ 47.8	1 (0.3%)	35.1 ～ 44.4	28 (9.7%)
33.4 ～ 47.9	1 (0.3%)	35.5 ～ 43.9	89 (30.7%)
33.5 ～ 43.9	2 (0.7%)	35.5 ～ 47.9	1 (0.3%)
34.0 ～ 42.0	2 (0.7%)	35.5 ～ 48.9	1 (0.3%)
34.0 ～ 43.9	14 (4.8%)	36.0 ～ 44.1	1 (0.3%)
34.0 ～ 45.0	7 (2.4%)	36.0 ～ 44.4	1 (0.3%)
34.0 ～ 45.9	1 (0.3%)	36.0 ～ 47.0	1 (0.3%)
34.0 ～ 46.0	3 (1.0%)	36.0 ～ 48.0	2 (0.7%)
34.0 ～ 46.5	5 (1.7%)	37.0 ～ 47.0	3 (1.0%)
34.0 ～ 48.0	1 (0.3%)	37.0 ～ 50.0	1 (0.3%)
34.0 ～ 48.5	1 (0.3%)	39.0 ～ 48.9	1 (0.3%)
34.3 ～ 45.0	2 (0.7%)		

表２６

白血球数（無性差）（10^2/μL） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	9 (3.1%)	33.00 ～ 86.40	1 (0.3%)
3.10 ～ 8.40	10 (3.4%)	33.00 ～ 89.00	4 (1.4%)
3.50 ～ 9.10	2 (0.7%)	33.00 ～ 89.99	1 (0.3%)
3.50 ～ 9.30	1 (0.3%)	33.00 ～ 90.00	12 (4.1%)
4.00 ～ 8.00	2 (0.7%)	33.00 ～ 95.00	1 (0.3%)
30.00 ～ 84.00	2 (0.7%)	35.00 ～ 81.00	1 (0.3%)
30.00 ～ 84.90	1 (0.3%)	35.00 ～ 85.00	3 (1.0%)
30.00 ～ 84.99	1 (0.3%)	35.00 ～ 89.90	1 (0.3%)
30.00 ～ 85.00	1 (0.3%)	35.00 ～ 90.00	8 (2.8%)
30.00 ～ 90.00	1 (0.3%)	35.00 ～ 93.00	1 (0.3%)
30.00 ～ 98.00	1 (0.3%)	35.00 ～ 97.00	18 (6.2%)
30.00 ～ 100.00	1 (0.3%)	35.00 ～ 98.00	2 (0.7%)
30.01 ～ 84.99	7 (2.4%)	35.00 ～ 99.00	1 (0.3%)
30.10 ～ 84.99	1 (0.3%)	35.00 ～ 100.00	1 (0.3%)
31.00 ～ 84.00	78 (26.9%)	37.00 ～ 85.00	1 (0.3%)
31.00 ～ 84.90	9 (3.1%)	38.00 ～ 90.00	1 (0.3%)
31.00 ～ 84.99	2 (0.7%)	38.00 ～ 98.00	10 (3.4%)
31.00 ～ 85.00	9 (3.1%)	39.00 ～ 97.00	2 (0.7%)
31.00 ～ 89.00	1 (0.3%)	39.00 ～ 98.00	20 (6.9%)
31.00 ～ 90.00	1 (0.3%)	39.00 ～ 99.00	1 (0.3%)
31.00 ～ 94.00	1 (0.3%)	39.00 ～ 100.00	1 (0.3%)
32.00 ～ 85.00	15 (5.2%)	40.00 ～ 80.00	1 (0.3%)
32.00 ～ 89.00	2 (0.7%)	40.00 ～ 85.00	3 (1.0%)
32.00 ～ 90.00	1 (0.3%)	40.00 ～ 90.00	12 (4.1%)
32.00 ～ 98.00	1 (0.3%)	40.00 ～ 95.00	2 (0.7%)
32.00 ～ 110.00	1 (0.3%)	40.00 ～ 99.90	1 (0.3%)
33.00 ～ 86.00	19 (6.6%)		

表２７

血小板数（無性差）（$10^4/\mu L$） 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	9 (3.1%)	13.1 ～ 36.2	13 (4.5%)
10.0 ～ 40.0	1 (0.3%)	13.1 ～ 36.3	1 (0.3%)
12.0 ～ 34.0	2 (0.7%)	13.1 ～ 36.5	1 (0.3%)
12.0 ～ 35.0	2 (0.7%)	13.1 ～ 36.6	1 (0.3%)
12.0 ～ 36.0	1 (0.3%)	13.1 ～ 36.9	1 (0.3%)
12.0 ～ 37.0	1 (0.3%)	13.5 ～ 39.9	1 (0.3%)
12.0 ～ 38.0	2 (0.7%)	14.0 ～ 34.0	11 (3.8%)
12.0 ～ 40.0	4 (1.4%)	14.0 ～ 35.9	4 (1.4%)
12.0 ～ 45.0	1 (0.3%)	14.0 ～ 36.0	6 (2.1%)
12.5 ～ 40.0	1 (0.3%)	14.0 ～ 37.9	22 (7.6%)
13.0 ～ 32.0	1 (0.3%)	14.0 ～ 38.0	1 (0.3%)
13.0 ～ 34.0	5 (1.7%)	14.5 ～ 32.9	120 (41.4%)
13.0 ～ 34.9	16 (5.5%)	14.5 ～ 37.0	1 (0.3%)
13.0 ～ 35.0	6 (2.1%)	15.0 ～ 35.1	1 (0.3%)
13.0 ～ 36.0	3 (1.0%)	15.0 ～ 37.0	1 (0.3%)
13.0 ～ 36.9	13 (4.5%)	15.0 ～ 40.0	1 (0.3%)
13.0 ～ 37.0	5 (1.7%)	15.3 ～ 33.7	1 (0.3%)
13.0 ～ 37.9	1 (0.3%)	15.8 ～ 34.8	20 (6.9%)
13.0 ～ 38.0	2 (0.7%)	16.0 ～ 35.9	1 (0.3%)
13.0 ～ 39.9	2 (0.7%)	35.0 ～ 91.0	1 (0.3%)
13.0 ～ 40.0	3 (1.0%)		

表２８

MCV （男性） (fL) 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	28 (9.7%)	83.0 ～ 102.0	13 (4.5%)
76.0 ～ 101.0	6 (2.1%)	83.0 ～ 102.9	4 (1.4%)
76.1 ～ 101.0	1 (0.3%)	83.0 ～ 103.0	3 (1.0%)
77.0 ～ 100.0	1 (0.3%)	83.5 ～ 100.7	1 (0.3%)
77.0 ～ 104.0	1 (0.3%)	83.6 ～ 98.2	22 (7.6%)
78.0 ～ 101.9	1 (0.3%)	84.0 ～ 98.0	2 (0.7%)
78.0 ～ 102.0	4 (1.4%)	84.0 ～ 99.0	2 (0.7%)
78.0 ～ 111.0	1 (0.3%)	84.0 ～ 100.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 94.0	1 (0.3%)	84.0 ～ 101.0	2 (0.7%)
80.0 ～ 96.0	1 (0.3%)	84.0 ～ 102.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 99.0	5 (1.7%)	84.0 ～ 104.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 100.0	14 (4.8%)	85.0 ～ 98.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 101.0	3 (1.0%)	85.0 ～ 99.0	3 (1.0%)
80.0 ～ 103.0	5 (1.7%)	85.0 ～ 100.0	2 (0.7%)
80.0 ～ 105.0	1 (0.3%)	85.0 ～ 100.9	2 (0.7%)
81.0 ～ 98.0	2 (0.7%)	85.0 ～ 104.0	16 (5.5%)
81.0 ～ 100.0	2 (0.7%)	85.0 ～ 102.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 92.0	1 (0.3%)	85.0 ～ 103.0	7 (2.4%)
82.0 ～ 100.0	1 (0.3%)	85.0 ～ 104.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 101.0	1 (0.3%)	85.0 ～ 105.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 102.0	2 (0.7%)	86.0 ～ 98.0	1 (0.3%)
82.7 ～ 101.6	35 (12.1%)	86.0 ～ 101.9	1 (0.3%)
82.7 ～ 101.7	1 (0.3%)	86.0 ～ 102.0	1 (0.3%)
82.9 ～ 101.2	1 (0.3%)	86.0 ～ 103.0	1 (0.3%)
83.0 ～ 93.0	2 (0.7%)	86.0 ～ 104.0	1 (0.3%)
83.0 ～ 93.9	1 (0.3%)	86.3 ～ 101.6	1 (0.3%)
83.0 ～ 97.0	1 (0.3%)	87.0 ～ 102.0	2 (0.7%)
83.0 ～ 98.0	1 (0.3%)	87.0 ～ 100.0	6 (2.1%)
83.0 ～ 99.0	2 (0.7%)	87.6 ～ 103.0	1 (0.3%)
83.0 ～ 99.9	4 (1.4%)	88.0 ～ 99.0	3 (1.0%)
83.0 ～ 100.0	3 (1.0%)	89.0 ～ 95.0	1 (0.3%)
83.0 ～ 101.0	40 (13.8%)	89.0 ～ 99.0	4 (1.4%)
83.0 ～ 101.5	7 (2.4%)	90.0 ～ 110.0	1 (0.3%)

表２９

MCV （女性） (fL) 対象290施設			
基準範囲	施設数	基準範囲	施設数
－ ～ －	126 (43.4%)	83.0 ～ 98.0	1 (0.3%)
77.0 ～ 100.0	1 (0.3%)	83.0 ～ 99.9	4 (1.4%)
78.0 ～ 96.0	1 (0.3%)	83.0 ～ 100.0	2 (0.7%)
78.0 ～ 102.0	3 (1.0%)	83.0 ～ 101.0	2 (0.7%)
79.0 ～ 98.0	1 (0.3%)	83.1 ～ 97.7	1 (0.3%)
79.0 ～ 99.0	3 (1.0%)	83.6 ～ 98.2	3 (1.0%)
79.0 ～ 99.2	1 (0.3%)	84.0 ～ 93.0	2 (0.7%)
79.0 ～ 100.0	51 (17.6%)	84.0 ～ 98.0	2 (0.7%)
79.0 ～ 100.1	1 (0.3%)	84.0 ～ 99.0	1 (0.3%)
79.0 ～ 100.9	1 (0.3%)	84.0 ～ 100.0	2 (0.7%)
79.0 ～ 101.0	6 (2.1%)	84.0 ～ 100.9	1 (0.3%)
80.0 ～ 99.0	1 (0.3%)	85.0 ～ 99.0	2 (0.7%)
80.0 ～ 100.0	5 (1.7%)	85.0 ～ 100.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 101.0	29 (10.0%)	85.0 ～ 101.0	1 (0.3%)
80.0 ～ 102.9	4 (1.4%)	85.0 ～ 102.0	7 (2.4%)
80.0 ～ 103.0	2 (0.7%)	85.0 ～ 105.0	1 (0.3%)
81.0 ～ 100.0	4 (1.4%)	87.0 ～ 91.0	1 (0.3%)
81.0 ～ 102.0	6 (2.1%)	87.0 ～ 100.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 100.0	1 (0.3%)	87.0 ～ 102.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 102.0	1 (0.3%)	88.0 ～ 99.0	1 (0.3%)
82.0 ～ 102.3	1 (0.3%)	89.0 ～ 99.0	3 (1.0%)
82.2 ～ 102.3	1 (0.3%)		

参考資料

１．（第32回）臨床検査精度管理調査実施要領

２．（第32回）全衛連臨床検査精度管理調査参加施設一覧

３．（第32回）全衛連臨床検査精度管理調査参加外部機関一覧

４．（第32回）全衛連臨床検査精度管理調査結果回答票

５．（第32回）臨床検査精度管理調査　補助調査票

６．（第32回）臨床検査の基準範囲に関する調査票

令和５年度（第 32 回）臨床検査精度管理調査実施要領

１　目的

本調査は、健康診断施設及び登録衛生検査所が実施する臨床検査の検査精度を確認するとともに、必要な指導を行うことにより、信頼性の高い健康診断施設及び登録衛生検査所を育成することを目的とする。

２　対象施設

健康診断施設及び登録衛生検査所。

３　調査対象検査項目（21 項目）

1. 総コレステロール　2. 中性脂肪　3. 尿酸　4. クレアチニン　5. AST　6. ALT
7. γ-GT　8. 血糖　9. HDL コレステロール　10. LDL コレステロール　11. HbA1c
12. 尿糖（半定量）13. 尿蛋白（半定量）14. 尿潜血（半定量）
15. 赤血球数　16. ヘモグロビン量　17. ヘマトクリット値　18. 白血球数
19. 血小板数　20. 平均赤血球容積　21. 白血球百分率

４　実施方法

調査試料を参加施設に送付し、参加施設から測定結果を報告してもらい、測定値の精度について評価する。また、臨床検査実績、検査精度確保の状況、臨床検査の基準範囲等について調査する。

（１）調査項目及び送付する調査試料

	調査項目	送付試料
①	総コレステロール・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・AST・ALT・γ-GT・血糖	５試料　凍結品
②	HDL コレステロール・LDL コレステロール	２試料　凍結乾燥品 １試料　冷蔵品（生血清）
③	HbA1c	２試料　凍結乾燥品 ２試料　冷蔵品（新鮮血液）
④	尿糖・尿蛋白・尿潜血（半定量）	５試料　凍結乾燥品
⑤	赤血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積	２試料　冷蔵品
⑥	赤血球数・ヘモグロビン量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積・白血球百分率	２試料　冷蔵品（新鮮血液）

（２）参考調査試料について（参考調査試料の測定結果は評価の対象とはしない）

(ア) ② の生血清試料はHDLコレステロール・LDLコレステロール項目の参考調査試料とする。

(イ) ⑥ の新鮮血液 2 試料は、ヘマトクリット値・白血球数・血小板数・平均赤血球容積・白血球百分率項目の参考調査試料とする。

(ウ) ⑥ の新鮮血液 2 試料の残余を③の HbA1c 項目の参考調査試料とする。

（３）調査試料の送付と測定について

参考調査試料を含む全調査試料を精度管理調査参加施設に送付する。

なお、生化学関係の項目の一部または全部について自施設では測定せず、外部の登録衛生検査所に委託している場合にあっては、送付された試料の数量、状態を確認し、自施設で測定する試料を分別した後、外部委託する項目の試料を通常測定委託している登録衛生検査所に送付して、試料の調製および測定を依頼するものとする。

（４）補助調査

臨床検査実績、内部精度管理、外部精度管理調査参加の状況、臨床検査の基準範囲等について、送付する調査票により調査するものとする。

5　実施時期（日程）

調査試料発送　：令和６年１月３０日（火）

回答票提出期限　：令和６年２月１３日（火）

評価結果報告　：令和６年３月予定

6　測定結果の報告

測定結果の報告は、所定の回答票用紙に記入し、原本を提出することとする。

自施設で測定を行っていない調査項目については、外部委託する項目の試料を通常測定委託している登録衛生検査所に送付して測定させ、当該登録衛生検査所からの測定結果報告を確認後、所定の回答票用紙に記入し原本を提出する。

7　評価

評価は、全衛連臨床検査専門委員会が定める下記（１）～（３）の評価方法に基づき行う。

（１）測定値の評価

送付する生化学試料、血液学試料の測定値が、全参加施設の各試料測定平均値から許容される範囲内に収まっているかを評価する。

（２）解析値による評価

5 試料を送付している生化学項目のみ以下の 5 種類を評価する。

a　方向係数　$Y = a + bX$　bX の b　　《回　収　率》

b　ばらつきの程度(再現性)　（$\sqrt{V_E}$）　　《再　現　性》

c　測定値を含む確率楕円の長軸の傾きの正切（tanθ）　　《測定バラツキ》

d　パフォーマンス ・ インデックス 1（PI-1）　　《 真　　度 》

e　パフォーマンス ・ インデックス 2（PI-2）　　《平均真度》

（３）尿比色判定の評価

尿糖・尿蛋白・尿潜血半定量測定用試料の判定結果と半定量値との一致度を３段階で評価する。

8　評価結果の公表等

参加施設の評価結果については、「７評価」で記載した（１）～（３）の評価結果をとりまとめ、総合評価としてＡ［優］・Ｂ［良］・Ｃ［可］・Ｄ［不可］ の４段階で施設を評価する。また、その評価結果を全衛連総合精度管理調査に参加した施設に配付する冊子「全衛連総合精度管理調査結果の概要」及び全衛連ホームページにその成績結果を公表する。

各調査項目の評価点で、２項目以上全衛連が定める評価基準に満たなかった施設については、施設における問題点の改善についての報告書の提出と全衛連が企画する研修会への参加を勧告する。

9　参加申込期限

令和５年１１月１０日（金）

１０　申込先

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

〒108-0014

東京都港区芝 4-11-5　田町ハラビル５階

TEL 03-5442-5934　FAX 03-5442-5937

１１　参加費（税込）

全衛連会員：55,000 円　　全衛連会員以外：80,300 円

第３２回　全衛連臨床検査精度管理調査参加施設一覧

都道府県名	施　設　名
北海道	(公財)北海道労働保健管理協会 (公財)北海道結核予防会 (公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　北海道支部札幌商工診療所 (医社)慶友会 吉田病院 第一岸本臨床検査センター　札幌 (一社)日本健康倶楽部北海道支部 (公財)北海道労働保健管理協会　札幌総合健診センター 札幌臨床検査センター㈱ (医)新産健会　スマイル健康クリニック (医社)明日佳 札幌健診センター (公財)北海道対がん協会 (一財)ハスカッププラザ　苫小牧市保健センター (株)札幌ミライラボラトリー
青森県	(一財)全日本労働福祉協会 青森県支部 (公財)八戸市総合健診センター (公財)ｼﾙﾊﾞｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会　八戸西健診プラザ
岩手県	(公財)岩手県予防医学協会 (社医)啓愛会 健診センター 盛岡臨床検査センター
宮城県	(一財)杜の都産業保健会 (一財)宮城県予防医学協会 (公財)宮城厚生協会 (一財)宮城県成人病予防協会　附属仙台循環器病センター (一財)宮城県成人病予防協会　中央診療所 (一財)杜の都産業保健会　一番町健診クリニック (医)仁泉会　みやぎ健診プラザ
山形県	(一財)全日本労働福祉協会 東北支部 (一財)日本健康管理協会　山形健康管理センター
福島県	(医)創仁会 東日本診療所
茨城県	(公財)日立メディカルセンター (一財)全日本労働福祉協会　茨城県支部 (一財)茨城県メディカルセンター (公財)茨城県総合健診協会 (株)江東微生物研究所　中央研究所つくば (公社)取手市医師会　取手北相馬　保健医療ｾﾝﾀｰ医師会病院 (一社)日本健康倶楽部 茨城支部
栃木県	(公財)栃木県保健衛生事業団 (医)北斗会　宇都宮東病院 (医社)福田会 福田記念病院

都道府県名	施　設　名
栃木県	(公財)宇都宮市医療保健事業団　健診センター (社医)中山会 宇都宮記念病院　総合健診センター (医)宇都宮健康クリニック (特非)ルネサンス　巡回健診クリニック さくら診療所 ㈱昭和メディカルサイエンス総合研究所 (医社)亮仁会 那須中央病院　総合健診センター (医社)健暉会　清原診療所 栄研化学(株)野木事業所
群馬県	(一財)日本健康管理協会　伊勢崎健診プラザ (一財)全日本労働福祉協会 群馬県支部 (一社)伊勢崎佐波医師会病院　成人病検診センター (株)エスアールエル　北関東検査センター
埼玉県	(公財)埼玉県健康づくり事業団 (医社)愛友会 上尾中央総合病院 (医社)東光会　戸田中央総合健康管理ｾﾝﾀｰ ㈱ビー・エム・エル BML総合研究所 (社医)刀仁会 坂戸中央病院 (株)保健科学 東日本 総合ラボラトリー (医)クレモナ会　ティーエムクリニック (医社)紘智会籠原病院 (医財)新生会　大宮共立病院 (一社)日本健康倶楽部 浦和支部 (医)天尽会　敬愛クリニック
千葉県	(一財)君津健康センター (公財)ちば県民保健予防財団 (医社)福生会 斎藤労災病院 (株)サンリツ (医社)廣生会　関東予防医学診療所 (一財)柏戸記念財団 (医社)青山会 (医社)圭春会 小張総合病院　健診ｾﾝﾀｰ (一社)日本健康倶楽部　千葉支部 (一社)千葉衛生福祉協会　千葉診療所 (社福)聖隷福祉事業団　聖隷佐倉市民病院 健診ｾﾝﾀｰ (医社)報徳会　報徳千葉診療所 (医)成春会 花輪クリニック
東京都	(一財)全日本労働福祉協会 (一財)健康医学協会 (公財)東京都予防医学協会 (一財)日本予防医学協会　東日本事業本部 (一社)労働保健協会

都道府県名	施　設　名
東京都	(一財)産業保健協会 (一財)日本健診財団 (一財)労働医学研究会 (医社)新町クリニック健康管理センター (医社)日健会 日健クリニック (医財)福音医療会 (医社)同友会 ㈱エスアールエル セントラルラボラトリー (株)LSIメディエンス　中央総合ラボラトリー (公財)愛世会 愛誠病院 (医社)俊秀会 エヌ・ケイ・クリニック (医社)松英会 (医財)立川中央病院　附属健康クリニック (医社)七星会　カスガメディカルクリニック (公財)河野臨床医学研究所　北品川クリニック・予防医学センター (一財)産業保健研究財団 (医社)朋翔会　弥生ファーストクリニック (一財)日本健康増進財団 (医社)幸楽会　幸楽メディカルクリニック (一財)近藤記念医学財団 富坂診療所 (一財)日本健康管理協会　新宿健診プラザ (医社)こころとからだの元氣プラザ (医社)康生会　シーエスケー・クリニック (医財)南葛勤医協　芝健診センター (一財)東京保健会 病体生理研究所 (公財)パブリックヘルスリサーチセンター　東京支部パブリック診療所 (株)昭和メディカルサイエンス (医財)三友会 深川ギャザリアクリニック (医財)京映会 エスアールエル　MUQSラボラトリー (一財)日本がん知識普及協会 (医社)多摩医療会 原町田診療所 医療法人社団　友好会　目黒メディカルクリニック (医財)東友会 (医財)綜友会 (一財)健康医学協会 霞が関ビル診療所 (医社)明芳会　IMS Me-Lifeクリニック板橋 (医社)予防会　新宿クリニック (医財)綜友会　第二臨海クリニック (医社)せいおう会　鶯谷健診センター (公財)パブリックヘルスリサーチセンター東京支部　リバーサイド読売ビル診療所 (医社)生光会　新宿追分クリニック

都道府県名	施　設　名
東京都	(医社)生光会　新宿追分クリニック　　板橋分院 (医社)友好会秋葉原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ (一社)オリエンタル労働衛生協会 東京支部　ｵﾘｴﾝﾀﾙ上野健診ｾﾝﾀｰ (一財)近畿健康管理センター　東京事業部　東京日本橋健診クリニック (一財)全日本労働福祉協会　　九段クリニック (医社)大聖病院 (医財)綜友会　　新宿ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰｸﾘﾆｯｸ (医社)友好会 秋葉原ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ　ｱﾈｯｸｽ
神奈川県	(公財)神奈川県予防医学協会 中央診療所 (一財)神奈川県労働衛生福祉協会 (一財)ヘルス・サイエンス・センター (医社)相和会 (一財)京浜保健衛生協会 (医)興生会 相模台健診クリニック (公財) 神奈川県結核予防会 (株)保健科学研究所 (社医)石心会　川崎健診クリニック (医社)成澤会　清水橋クリニック (一社)日本健康倶楽部 横浜支部 (一社)日本厚生団 長津田厚生総合病院 (医社)優和会　湘南健診クリニック　　湘南健康管理センター (医社)藤順会　　藤沢総合健診センター (公財)神奈川県予防医学協会　　集団検診センター (医・社)優和会 湘南健診クリニック　ココットさくら館 ㈱ファルコバイオシステムズ東京研究所
新潟県	(一社)新潟県労働衛生医学協会 (一社)新潟縣健康管理協会 (公財)新潟県保健衛生センター (一社)上越医師会　上越地域総合健康管理ｾﾝﾀｰ (一財)新潟県けんこう財団 (一財)新潟県けんこう財団　長岡健康管理センター (一社)新潟県労働衛生医学協会　附属ｱｸｱｰﾚ長岡健康増進ｾﾝﾀｰ (一社)新潟県労働衛生医学協会　附属佐渡検診センター
富山県	(一財)北陸予防医学協会 (公財)友愛健康医学センター (一社)日本健康倶楽部 北陸支部 (公財)富山県健康づくり財団　富山県健康増進センター (医社)若葉会　高重記念クリニック　　予防医療センター
石川県	(一財)石川県予防医学協会 (医社)洋和会　未病医学センター
福井県	(公財)福井県予防医学協会 (公財)福井県労働衛生センター

都道府県名	施　設　名
長野県	(一社)長野県労働基準協会連合会　松本健診所 (一財)全日本労働福祉協会 長野県支部 (公財)長野県健康づくり事業団 (一財)中部公衆医学研究所
岐阜県	(一財)ききょうの丘健診プラザ (一社)ぎふ綜合健診センター (一財)岐阜健康管理センター (株)メディック 岐阜ラボ (一財)総合保健センター (医)岐陽会 サンライズクリニック
静岡県	(一財)東海検診センター (社福)聖隷福祉事業団　聖隷健康診断センター (公財)静岡県予防医学協会 (公財)静岡県産業労働福祉協会 (一財)芙蓉協会聖隷沼津第一ｸﾘﾆｯｸ 聖隷沼津健康診断センター (一社)静岡市静岡医師会健診センター (社福)聖隷福祉事業団　聖隷予防検診センター (株)メディック 静岡ラボ (医社)駿栄会 御殿場石川病院 (社福)聖隷福祉事業団 聖隷健康 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰShizuoka (医)豊岡会 浜松とよおか病院 (公財)静岡県予防医学協会　浜松健診センター (社福)聖隷福祉事業団 保健事業部　聖隷健康診断ｾﾝﾀｰ 東伊場ｸﾘﾆｯｸ
愛知県	(一社)瀬戸健康管理センター (一財)公衆保健協会 (一財)愛知健康増進財団 (一財)全日本労働福祉協会 東海支部 (医)豊昌会 豊田健康管理クリニック (一財)名古屋公衆医学研究所 (一社)オリエンタル労働衛生協会 (医社)卓和会 しらゆりクリニック (社医)宏潤会 だいどうクリニック　健診センター (医)東海予防医学クリニック (医)光生会 光生会病院 (一社)半田市医師会 健康管理センター (一社)碧南市医師会 臨床検査センター (医)あいち健康クリニック (公財)豊田地域医療センター (医)豊岡会 豊橋元町病院 健康管理センター ㈱エスアールエル エスアールエル　愛知ラボラトリー (医)名翔会　名古屋セントラルクリニック (公財)愛知県健康づくり振興事業団

都道府県名	施　設　名
愛知県	(医)松柏会 国際セントラルクリニック (医)九愛会 中京サテライトクリニック (医)名翔会　和合セントラルクリニック 三河安城クリニック (一財)全日本労働福祉協会　東海診療所 (一財)日本予防医学協会　東日本事業本部 東海課 (一財)近畿健康管理センター　名古屋事業部 (医)松柏会 大名古屋ビル　セントラルクリニック (医)順秀会　メディカルパーク今池 (株)ファルコバイオシステムズ　東海中央研究所
三重県	(一財)三重県産業衛生協会 (一財)近畿健康管理センター　三重事業部 (医)九愛会　中京ｻﾃﾗｲﾄｸﾘﾆｯｸ 三重
滋賀県	(一財)滋賀保健研究センター (株)メディック(滋賀) (一財)近畿健康管理センター　滋賀事業部KKCウエルネス栗東健診クリ (株)近畿エコサイエンス
京都府	(一財)京都工場保健会 (一財)大和松寿会 中央診療所 (一財)京都労働災害被災者援護財団　京都城南診療所 (一財)京都予防医学センター ファルコバイオシステムズ総合研究所 (医社)洛和会　洛和会音羽病院　健診センター (一財)京都工場保健会宇治支所 (一社)京都微生物研究所 付属診療所
大阪府	(医)崇孝会 北摂クリニック (一財)日本予防医学協会　西日本事業本部 大阪健康倶楽部 小谷診療所 (医)いながきレディースクリニック　集検部 (株)大阪血清微生物研究所 (医)緑地会　赤尾クリニック (株)メディック　メディック堺 (医)恵生会 (医)あけぼの会 (公財)パブリックヘルス　リサーチセンター 関西支部 (医)健人会 那須クリニック (医)厚生会　厚生会クリニック (医)樫本会 樫本病院 (特医)渡辺医学会　桜橋渡辺病院　附属駅前第三ビル診療所 (社医)愛仁会　愛仁会総合健康センター (医)一翠会　一翠会千里中央健診ｾﾝﾀｰ (一社)オリエンタル労働衛生協会　大阪支部ｵﾘｴﾝﾀﾙ大阪健診ｾﾝﾀｰ

都道府県名	施　設　名
大阪府	(一財)近畿健康管理センター　大阪事業部
兵庫県	(一財)順天厚生事業団 (公財)兵庫県予防医学協会 (一社)姫路市医師会 川西市医師会メディカルセンター (医社)泰志会　島田クリニック (一社)西宮市医師会 (医社)尚仁会 平島病院 (社医)神鋼記念会　　総合健康管理センター (公財)兵庫県健康財団 (公財)加古川総合保健センター (一社)日本健康倶楽部 兵庫支部診療所 (医社)河合医院 (一社)神戸市医師会　医療センター診療所 (一社)日本健康倶楽部　和田山診療所 (一財)京都工場保健会　神戸健診クリニック (社医)愛仁会　　カーム尼崎健診プラザ (株)LSIメディエンス　神戸市医師会ラボラトリー (一財)京都工場保健会 姫路健診クリニック
和歌山県	(社医)黎明会 健診センター・キタデ (一財)NSメディカル　・ヘルスケアサービス (医)南労会　紀和病院
鳥取県	(公財)中国労働衛生協会 鳥取検診所 (公財)中国労働衛生協会 米子検診所 (公財)鳥取県保健事業団
島根県	(公財)島根県環境保健公社 (医社)創健会 松江記念病院
岡山県	(一財)淳風会 淳風会健康管理センター (一社)岡山県労働基準協会　労働衛生センター (公財)中国労働衛生協会 津山検診所 (一財)倉敷成人病センター　　倉敷成人病健診センター (公財)岡山県健康づくり財団 大ケ池診療所
広島県	(一財)広島県集団検診協会 (公財)中国労働衛生協会 (公財)中国労働衛生協会 尾道検診所 (一財)広島県環境保健協会 (公財)広島県地域保健医療推進機構 (社医)里仁会 興生総合病院 (医)健康倶楽部　　健康倶楽部健診クリニック (医)広島健康会 アルパーク　検診クリニック (医)あかね会 中島土谷クリニック　　健診センター

都道府県名	施　設　名
広島県	(医社)仁恵会　福山検診所 (株)福山臨床検査センター
山口県	(公財)山口県予防保健協会 (一社)日本健康倶楽部　山口支部
徳島県	(一社)徳島県労働基準協会連合会　健診部
香川県	(一社)香川労働基準協会 (一社)瀬戸健康管理研究所 (公財)香川県総合健診協会
愛媛県	(医)菅井内科 (一社)エヒメ健診協会
高知県	(公財)高知県総合保健協会 (医)健会　高知検診クリニック 独立行政法人 地域医療機能推進機構　高知西病院 高知県厚生農業協同組合連合会　JA高知病院 JA高知健診ｾﾝﾀｰ
福岡県	(一財)西日本産業衛生会　　北九州産業衛生診療所 (一財)西日本産業衛生会　　北九州健診診療所 (公財)ふくおか公衆衛生推進機構　ガーデンシティ健診プラザ (公財)福岡労働衛生研究所 (一財)日本予防医学協会　九州事業本部 (一社)北九州市小倉医師会　　小倉医師会健診センター (一財)九州健康総合センター (医)心愛 小倉中央放射線科 (一財)医療情報健康財団 (一社)日本健康倶楽部 福岡支部 (公財)ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾍﾙｽﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ　西日本支部 ㈱シー・アール・シー総合研究所 (一社)日本健康倶楽部　北九州支部診療所 (医社)生光会 ヘルスポートクリニック (公社)北九州市門司区医師会　　門司区医師会診療所 (一財)西日本産業衛生会　　福岡健診診療所 (公財)ふくおか公衆衛生推進機構　久留米総合健診センター
佐賀県	(一財)佐賀県産業医学協会
長崎県	(公財)長崎県健康事業団 (医)西九州健康診断本部診療所
熊本県	(公財)熊本県総合保健センター 日本赤十字社 熊本健康管理センター (医)室原会 菊南病院 熊本県厚生農業協同組合連合会
大分県	(一財)西日本産業衛生会　　大分労働衛生管理センター
宮崎県	(公財)宮崎県健康づくり協会
鹿児島県	(公社)鹿児島県労働基準協会 (公財)鹿児島県民総合保健センター

都道府県名	施　設　名
沖縄県	(一財)沖縄県健康づくり財団 (一社)日本健康倶楽部 沖縄支部 (一社)中部地区医師会　検診センター (一財)琉球生命済生会琉生病院 (一社)那覇市医師会　　生活習慣病検診センター

第３２回精度管理外部機関一覧

外部機関ｺｰﾄﾞ	外部機関名
002	株式会社LSIメディエンス中央総合ラボラトリー
006	株式会社　保健科学研究所
008	株式会社ビー・エム・エル　BML総合研究所
012	一般財団法人東京保健会　病体生理研究所
024	(一社)京都微生物研究所
029	株式会社　大阪血清微生物研究所
041	エスアールエル　MUQSラボラトリー
052	(株)第一岸本臨床検査センター
057	株式会社　エスアールエル愛知ラボラトリー
058	(株)四国中検
060	(株)中央微生物検査所
062	株式会社昭和メディカルサイエンス総合研究所
065	(株)岡山医学検査センター
073	(有)久留米臨床検査センター
075	株式会社サンリツ
081	(株)北信臨床
083	(株)ナゴヤ医学学術センター
085	(株)日本医学臨床検査研究所
088	一般社団法人半田市医師会健康管理センター
089	(株)ビー・エム・エル　BML北陸
090	ファルコバイオシステムズ　総合研究所
094	株式会社メディック　メディック堺
095	(株)CIS熊本中央研究所
100	保健科学 東日本総合ラボラトリー
102	日本医学(株)
109	株式会社シー・アール・シー総合研究所
110	八戸市医師会臨床検査センター
111	株式会社江東微生物研究所　中央研究所つくば
112	株式会社福山臨床検査センター
122	(株)近畿予防医学研究所
126	株式会社メディック(滋賀)
127	(株)メディック　岐阜ラボ
129	株式会社メディック静岡
136	(株)ビー・エム・エル BML 山形
137	(株)京浜予防医学研究所
144	(株)エスアールエル静岡ラボラトリー
146	熊本市医師会検査センター
151	(株)北九州小倉医師会北九州中央臨床検査センター
154	板橋中央臨床検査研究所
160	上尾中央臨床検査研究所

161	(株)ファルコバイオシステムズ岡山研究所
162	(株)近畿エコサイエンス
165	SRL Advanced Lab. FMA
167	札幌臨床検査センター(株)
169	(株)ファルコバイオシステムズ東海中央研究所
171	(株)日研医学
172	(株)メディック愛知ラボ
175	(株)戸田中央臨床検査研究所
176	(株)武蔵臨床検査所
185	(公益社団法人)宮城県医師会健康センター
190	(株)アルプ
193	(株)QOLセントラルラボラトリーズ
198	(株)LSIメディエンス神戸
200	(株)保健科学西日本総合ラボラトリー
206	音羽病院SRL検査室
208	(株)日本医学臨床検査研究所宇治ラボ
209	(株)ビー・エム・エル上越
210	(社福)聖隷三方原病院
211	(株)兵庫県臨床検査研究所

令和5年度 第32回全衛連臨床検査精度管理調査検査結果回答票

施設コード		施設名	所在地	TEL: ー ー	記入責任者 氏名	

Ⅰ.測定装置コード等記入表

項目番号	調査項目	測定装置コード	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名	試薬キットの正式名称	検量用試料(キャリブレータ)の種類	トレーサビリティの確認(メーカーコード)
1	総コレステロール						
2	中性脂肪						
3	尿　酸						
4	クレアチニン						
5	ＡＳＴ						
6	ＡＬＴ						
7	γ－ＧＴ						
8	血　糖						
9	HDLコレステロール						
10	LDLコレステロール						
11	ＨｂＡ１ｃ						

項目番号	調査項目	測定装置コード 目視判定の場合AAZ999と記入	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名
12	尿糖半定量			
13	尿蛋白半定量			
14	尿潜血定性			
項目番号	調査項目	測定装置コード	その他の場合のみ記入 使用装置名	その他の場合のみ記入 メーカー名
15	赤血球数			
16	ヘモグロビン量			
17	ヘマトクリット値			
18	白血球数			
19	血小板数			
20	平均赤血球容積			
21	白血球百分率			

Ⅱ.測定結果等記入欄

調査項目	測定法・単位等	測定値	測定	外部施設コード	委託先外部施設名
1. 総コレステロール	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1〜5	単位 mg/dL	自・外	
2. 中性脂肪	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1〜5	単位 mg/dL	自・外	
3. 尿　酸	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1〜5	単位 mg/dL	自・外	
4. クレアチニン	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1〜5	単位 mg/dL	自・外	
5. ＡＳＴ	測定法 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1〜5	単位	自・外	
6. ＡＬＴ	測定法 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1〜5	単位	自・外	
7. γ－ＧＴ	測定法 / 試薬キットの製造元 / 検量法 / その他の製造販売元・検量法	試料1〜5	単位	自・外	
8. 血　糖	測定法 / 試薬キットの製造元 / その他	試料1〜5	単位 mg/dL	自・外	
9. HDLコレステロール	測定法 / その他	試料6〜8	単位 mg/dL	自・外	
10. LDLコレステロール	試薬キットNo. / その他	試料6〜8	単位 mg/dL	自・外	
11. ＨｂＡ１ｃ	分析装置の製造販売元・試薬キット・試料18・19が測定できなかった理由・その他	NGSP値 試料9〜19	単位 %	自・外	

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会

Ⅱ.測定結果等記入欄

施設コード

調査項目	測定法・単位等	測定値	測定	外部施設コード	委託先外部施設名
12. 尿糖半定量	測定法 / 試験紙の製造元 / その他	試料11〜15	自・外		
13. 尿蛋白半定量	測定法 / 試験紙の製造元 / その他	試料11〜15	自・外		
14. 尿潜血定性	測定法 / 試験紙の製造元 / その他	試料11〜15	自・外		
15. 赤血球数		試料16〜19	単位 $\times10^4/\mu L$	自・外	
16. ヘモグロビン量	測定法 / その他	試料16〜19	単位 g/dL	自・外	
17. ヘマトクリット値		試料16〜19	単位 %	自・外	
18. 白血球数		試料16〜19	単位 $\times10^3/\mu L$	自・外	
19. 血小板数		試料16〜19	単位 $\times10^4/\mu L$	自・外	
20. 平均赤血球容積		試料16〜19	単位 fL	自・外	
21. 白血球百分率		好中球 試料18〜19	単位 %	自・外	
		リンパ球 試料18〜19	単位 %	自・外	
		単球 試料18〜19	単位 %	自・外	
		好酸球 試料18〜19	単位 %	自・外	
		好塩基球 試料18〜19	単位 %	自・外	

Ⅲ.血液試料受領時保存状態

試料16〜19の溶血程度	□ 内に各試料の溶血程度について1〜4 の数字を記入。 ※ 試料再送を希望した場合は、溶血・凝血等の状態写真を事務局に送付。(新鮮血液試料は保存期間の関係で再送対象外です)	試料16 □ 試料17 □ 試料18 □ 試料19 □ 溶血認められず…1　軽度の溶血あり…2　中等度の溶血あり…3　強度の溶血あり…4	コメント欄

Ⅳ.試料の受領日・測定日時

試料 8 (生血清試料)	試料受領日：令和6年2月 □□ 日	測定日時：令和6年2月 □□ 日　午前 • 午後 □□ 時 ～ □□ 時の間に測定
試料 16～19 (新鮮血液試料)	試料受領日：令和6年2月 □□ 日	測定日時：令和6年2月 □□ 日　午前 • 午後 □□ 時 ～ □□ 時の間に測定

臨床検査精度管理調査 補助調査票　［提出用］

令和5年度(第32回)

個人情報に関する以下の取扱いについて同意のうえ提出してください。　□ 同意する

(1) 個人情報の利用目的
本精度管理調査の参加に際し取得した皆様の氏名、職種、連絡先等の個人情報の利用目的は、精度管理の運営するうえでの問い合わせのみ使用いたします。

(2) 個人情報の開示等の求めについて
個人情報の開示等を請求する権利を有します。下記の窓口で受け付け、遅滞なく回答いたします。
〈個人情報に関わる苦情・相談窓口：全衛連総務部　電話03-5442-5934〉

参加施設コード					
施　設　名			記入者氏名		

A / B のどちらかに○をしてください。

(　　) A 健康診断施設（健康診断施設で登録衛生検査所を併設している施設を含む）

(　　) B 登録衛生検査所

1．臨床検査実施件数及び実施状況　（ A:健康診断施設対象 ）

◆ 令和４年度の実績を記入してください。
◆ 測定の実態では該当する項目の（　）に○をしてください。

検　査　項　目		自施設検査	外部委託検査	外部委託検査の方式	
		検査件数	検査件数	検査所	ブランチラボ
生化学項目	総コレステロール	件	件	(　　)	(　　)
	中　性　脂　肪	件	件	(　　)	(　　)
	HDL コレステロール	件	件	(　　)	(　　)
	LDL コレステロール	件	件	(　　)	(　　)
	A S T	件	件	(　　)	(　　)
	A L T	件	件	(　　)	(　　)
	γ-G T	件	件	(　　)	(　　)
	尿　　酸	件	件	(　　)	(　　)
	クレアチニン	件	件	(　　)	(　　)
	血　　糖	件	件	(　　)	(　　)
	HbA1c	件	件	(　　)	(　　)
血液項目	赤　血　球　数	件	件	(　　)	(　　)
	ヘモグロビン量	件	件	(　　)	(　　)
	ヘマトクリット値	件	件	(　　)	(　　)
	白　血　球　数	件	件	(　　)	(　　)
	血　小　板　数	件	件	(　　)	(　　)
	平均赤血球容積	件	件	(　　)	(　　)
	白血球百分率	件	件	(　　)	(　　)
尿項目	尿　　糖	件	件	(　　)	(　　)
	尿　蛋　白	件	件	(　　)	(　　)
	尿　潜　血	件	件	(　　)	(　　)

2．臨床検査実施件数及び実施状況　（ B:登録衛生検査所対象 ）

◆ 令和４年度の実績を記入してください。

検　査　項　目		自施設検査 検査件数	外部委託検査 検査件数
生化学項目	総コレステロール	件	件
	中　性　脂　肪	件	件
	HDL コレステロール	件	件
	LDL コレステロール	件	件
	A S T	件	件
	A L T	件	件
	γ-G T	件	件
	尿　　酸	件	件
	クレアチニン	件	件
	血　　糖	件	件
	HbA1c	件	件
血液項目	赤　血　球　数	件	件
	ヘモグロビン量	件	件
	ヘマトクリット値	件	件
	白　血　球　数	件	件
	血　小　板　数	件	件
	平均赤血球容積	件	件
	白血球百分率	件	件
尿項目	尿　　糖	件	件
	尿　蛋　白	件	件
	尿　潜　血	件	件

3．精度管理実施状況

3-1 臨床検査精度管理体制

◆ 選任の有・無に○を付けて下さい。
◆ 職位・職制は、**a**：所長・局長クラス、**b**：部長・次長クラス、**c**：課長・補佐クラス**d**：その他とします。
該当する **a**～**d** のいずれかに○をして下さい。

3-1-1 臨床検査精度管理体制　（ A施設が回答してください ）

担　当	選　任	職　　種	職位・職制（注）◆
精度の確保に係る責任者	有 ・ 無	a. 医師　b. 臨床検査技師　c. その他	a.　b.　c.　d.

3-1-2 臨床検査精度管理体制　（B施設が回答してください ）

担　当	選　任	職　　種	職位・職制（注）◆
精度管理責任者	有 ・ 無	a. 医師　b. 臨床検査技師　c. その他	a.　b.　c.　d.

3-2 教育研修（ A･B施設対象 ）

◆ それぞれ主催された研修・講習会を受講した受講者の（ ）に○を記入して下さい。 複数回答可。

◆ 過去３年間検体検査に係わる研修・講習会受講の実績。

全国労働衛生団体連合会主催				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
日本医師会主催				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
日本臨床衛生検査技師会主催				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
日本衛生検査所協会主催				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
日本総合健診医学会主催				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
自施設内研修・講習会				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )
その他主催の研修会　主催者名称（ ）				
精度の確保に係わる責任者／精度管理責任者	技術管理責任者	測定･分析担当者	検体搬送担当者	渉外(営業)担当者
( )	( )	( )	( )	( )

3-3 内部精度管理に関する文書 （ A･B施設対象 ）

◆ 作成している文書及び記録に○をして下さい。

検査機器保守管理標準作業書	測定標準作業書	測定作業日誌	検査機器保守管理作業日誌
( )	( )	( )	( )
統計学的精度管理台帳	外部精度管理台帳	試薬管理台帳	
( )	( )	( )	

3-4 内部精度管理、コントロール（血清等）の使用 （ A･B施設対象 ）

◆実施状況について、検査を自施設で実施している場合は該当の有無の（ ）内に○印を記入し回答してください。
◆実施状況について、検査を委託している場合は該当の有無の（ ）内に×印を記入してこの項は終了です。
◆ その他ありましたら記入してください。

項目	該当の有無	実施頻度							使用濃度数		
		1回／月	1回／週	1回／日	2回以上／日	～100検体毎	～200検体毎	その他	1濃度	2濃度	3濃度以上
生化学検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
血液学検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
尿検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

3-5 全衛連以外の外部精度管理調査参加の有無 （ A･B施設対象 ）

◆ 全衛連以外の外部精度管理調査に参加または参加予定の精度管理調査の主催者名に○を記入してください。（複数選択可）

日本医師会	日本臨床衛生検査技師会	日本衛生検査所協会	日本総合健診医学会	地方自治体	ＣＡＰ	その他
( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

3-6 検査委託先の精度の監視 （ A･B施設対象 ）

◆ 項目が検査委託に該当する場合、○を記入して以下の設問を回答して下さい。未委託は確認のため×を記入。

項目	検査委託	監視を実施
生化学検査	( )	( )
血液学検査	( )	( )
尿検査	( )	( )

3-7 精度の監視頻度 （設問3-6で「監視を実施」に○を記入した施設対象 ）

◆ 該当項目に○を、「その他方法」、「その他」があれば（ ）に具体的な記述をしてください。
◆ 「同一検体ブラインド挿入」とは、同じ検体を2分割し、2人分の検体として検査を依頼することをいいます。

項目	同一検体ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入	既知試料ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ挿入	その他の方法	実施頻度			
				月１回	半年1回	年1回	その他
生化学検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
血液学検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
尿検査	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

3-8 検査委託先との契約状況 （検査委託を行っていない施設は記入の必要ありません ）

◆ **d.**（ ）欄にはその他について具体的に記述して下さい。 複数回答可。

委託先との検査所要日数取り決めについて該当する a.～d.に○をして下さい。			
a. 3日以内	b. 4～7日	c. 7～14日	d. ( )
委託先の個人情報保護管理について主に確認する事項について該当する a.～d .に○をして下さい。			
a. Pﾏｰｸ認定	b. JIS Q 15001認証	c. ISO 27001認証	d. ( )
委託先の品質管理について主に確認する事項について該当する a.～c. に○をして下さい。			
a. ISO 9001認証	b. ISO 15189認定	c. CAP認定	d. ( )
委託先の管理体制情報の入手方法について該当する a.～c. に○をして下さい。			
a. ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等電子媒体	b. ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等紙媒体	c. 渉外（営業）からの説明	d. ( )

3-9 検査委託先の精度管理の確認 （検査委託を行っていない施設は回答の必要ありません ）

◆ a. に○の場合、 c. の（ ）欄に具体的に記述して下さい。例えば、ISO 15189等。

測定標準作業書の確認	a. 確認している　b. 確認していない	c. ( ) の品質保証認証で確認
統計学的精度管理台帳の確認	a. 確認している　b. 確認していない	c. ( ) の品質保証認証で確認
外部精度管理台帳の確認	a. 確認している　b. 確認していない	c. ( ) の品質保証認証で確認

４．検体搬送・保存時の温度管理

4-1 血液検体（生化学･血液検査）

◆ 貴施設の日常業務で行う作業に該当しているか、該当の有無に○をし、回答して下さい。複数回答可。
◆ 該当しない場合は必ず×を記入してください。

巡回健診時の温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
施設内での保存時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
登録衛生検査所までの搬送時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
登録衛生検査所の保存時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし

4-2 尿検査

◆ 複数回答可。

尿検体の採尿方法	a. 自宅採尿	b. 施設及び巡回健診現場での採尿	
尿検査の実施場所	a. 巡回健診現場	b. 自施設検査室	c. 外部委託検査機関

4-3 尿検体

◆ 該当する場合は○印を記入し回答してください。該当しない場合は×印のみ記入してください。

巡回健診時の温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
施設までの搬送時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
施設で翌日検査する場合の保存時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
登録衛生検査所までの搬送時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし
登録衛生検査所で翌日検査する場合の保存時温度管理	該当の有無	(　　)	a. 管理記録あり	b. 管理記録なし

臨床検査の基準範囲に関する調査票（令和５年度）

［提出用］

参加施設コード								
施設名						記入者氏名		

個人情報に関する以下の取扱いについて同意のうえ提出してください。　□　同意する

(1)個人情報の利用目的
本精度管理調査の参加に際し取得した皆様の氏名、職種、連絡先等の個人情報の利用目的は、精度管理調査を運営するうえでの問い合わせのみ使用いたします。

(2) 個人情報の開示等の求めについて
個人情報の開示等を請求する権利を有します。下記の窓口で受け付け、遅滞なく回答いたします。
〈個人情報に関わる苦情・相談窓口：全衛連総務部　電話03-5442-5934〉

◆ A ・ B のどちらか（　）に ○ 印を記入してください。

（　）A 健康診断施設

（　）B 登録衛生検査所

◆ 下記事項をお読みの上、検査基準範囲に関してご回答ください。

1. 「基準範囲」とは、貴施設のデータを判定する尺度として設定している基準範囲であり、特定学会の診断基準や特定健康診査の判定値ではありません。
「基準範囲」欄には、貴施設としてデータを判定する尺度として現況使用している基準範囲を記入してください。（健診依頼先の要請による基準範囲等は除外）
2. 男女別に基準範囲を設定していない場合は、項目欄の「男」を抹消してその欄に基準範囲を記入してください。また、男女別に基準範囲を設定している場合であって、記入欄が男女に区分されていない場合は、備考欄に女性の基準範囲を記入してください。
3. 「基準範囲の決め方」と、「基準範囲の変更」欄は、該当するアルファベット若しくは数字を○で囲んでください。
4. HbA1cについては、NGSP値で記入してください。
5. 血液学項目で、**赤血球数と白血球数については、極力標記単位での記入をお願いします。**
標記単位と異なる場合は、単位を抹消し、新たに備考欄に使用単位を記入してください。
6. 「その他」を選択した場合は、出来るだけ具体的に備考欄に記入してください。

◆ 令和４年度以降の変更について記入してください。

［基準範囲の決め方］

a ：使用試薬の添付説明書記載値
b ：自機関で算出
c ：日本人間ドック学会の基準範囲
d ：日本臨床検査医学会の学生用基準範囲
e ：日本臨床検査標準協議会（JCCLS）の共用基準範囲
f ：日本検査血液学会の血球計数項目の基準範囲
g ：学術文献の値
h ：その他

［基準範囲の変更］

0 ：変更なし
1 ：検査方法の変更
2 ：使用機器の変更
3 ：試薬の変更
4 ：基準範囲引用の変更
5 ：その他

臨床検査の基準範囲に関する調査票

項　目（単位）			基準範囲（下限～上限）	基準範囲の決め方	基準範囲の変更	備　考
総コレステロール	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
中性脂肪	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
尿酸	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
クレアチニン	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ＡＳＴ	(U/L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ＡＬＴ	(U/L)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
γ－ＧＴ	(U/L)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
血糖	(mg/dL)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
ＨＤＬコレステロール	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ＬＤＬコレステロール	(mg/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ＨｂＡ１ｃ	(％)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
赤血球数 ＊単位に注意	($10^4/\mu L$)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ヘモグロビン量	(g/dL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
ヘマトクリット値	(％)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			
白血球数 ＊単位に注意	($10^2/\mu L$)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
血小板数	($10^4/\mu L$)		～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
平均赤血球容積	(fL)	男	～	a b c d e f g h	0 1 2 3 4 5	
		女	～			

公益社団法人 全国労働衛生団体連合会